


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
3M	Aura 9322+	S020	2020-04-23 14:34:12.410000

Anzahl Regenerationszyklen	3.0
Differenzdruck Maske	25.5 mbar
Differenzdruck ohne Maske	25.3 mbar
Volumenstrom	95.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.46
Aerosolkonzentration	22.41 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.2 mbar

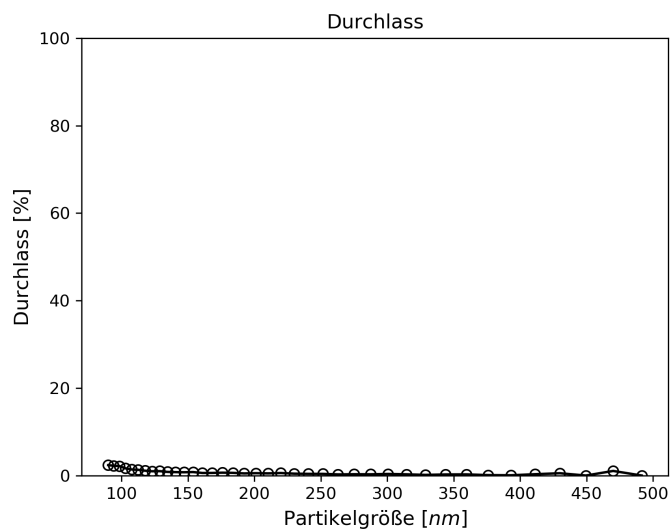

Optische Mängel:

Anmerkungen: