

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Filtech

F861

K39\_03

2021-02-17 10:33:37.310000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.1 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.77
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec

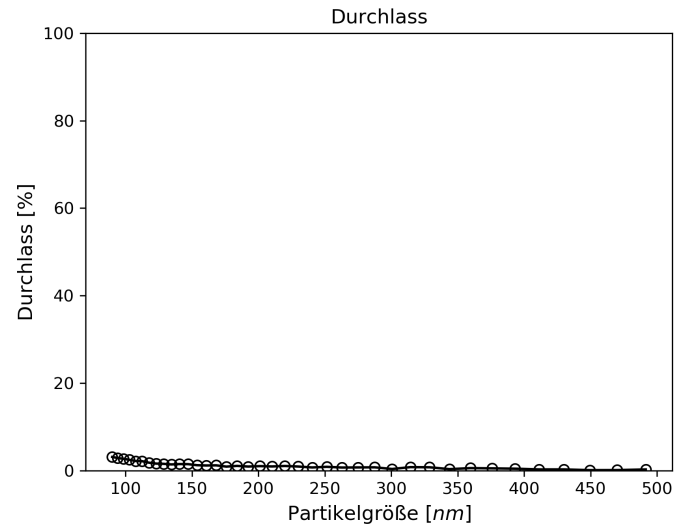

Optische Mängel:

Anmerkungen: