

# Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Missadola Technology

2626-2

UKA02-1

2020-06-08 05:47:30.430000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	0.0 mbar
Volumenstrom	14.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	23.1
Aerosolkonzentration	128.95 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec

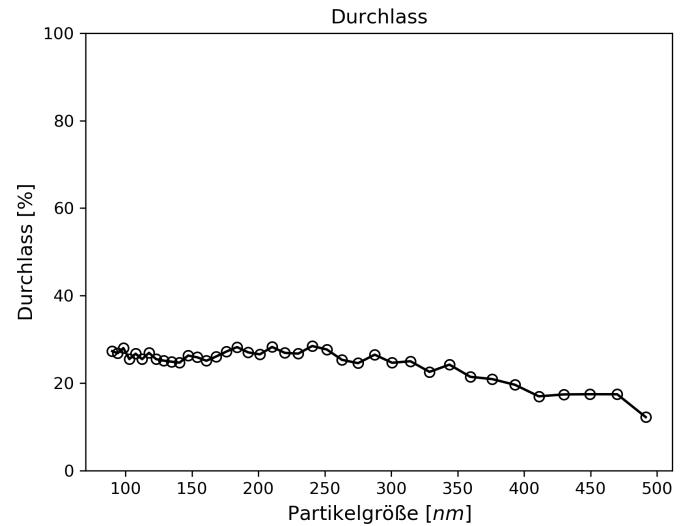

Optische Mängel:

Anmerkungen: