

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S011

2020-04-15 09:29:37.380000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	33.8 mbar
Differenzdruck ohne Maske	31.2 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	65.72
Aerosolkonzentration	22.65 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.6 mbar

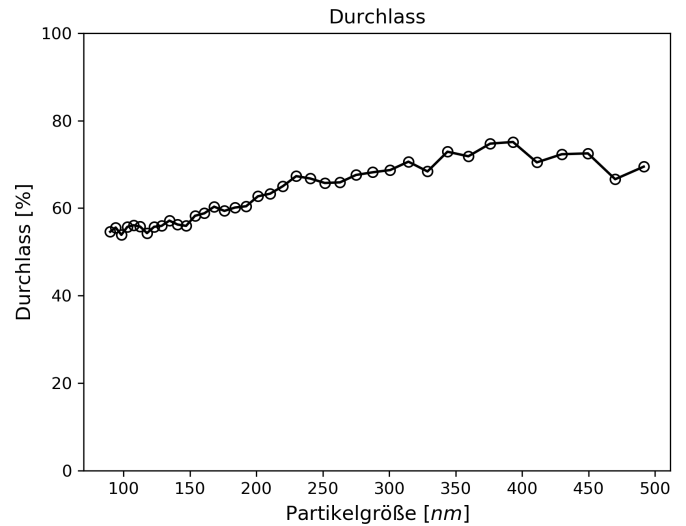

Optische Mängel:

Nasenteil verschiebbar

Anmerkungen:

Modell Dönertüte; Sitz jedoch optisch gut