

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

Berner

K15_2

2020-07-31 03:18:39.060000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	1.5 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	5.1
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec

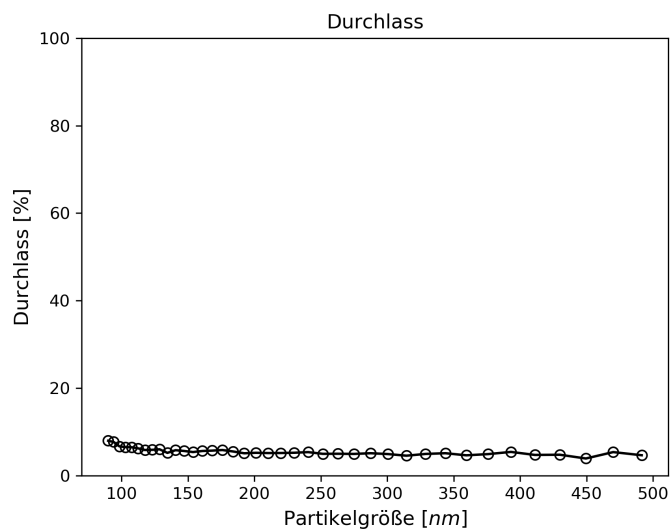

Optische Mängel:

Anmerkungen: