


## Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Foshan	Esmoo	A312	2020-05-11 17:32:09.750000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	2.0 mbar
Volumenstrom	94.8 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.61
Aerosolkonzentration	22.62 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec

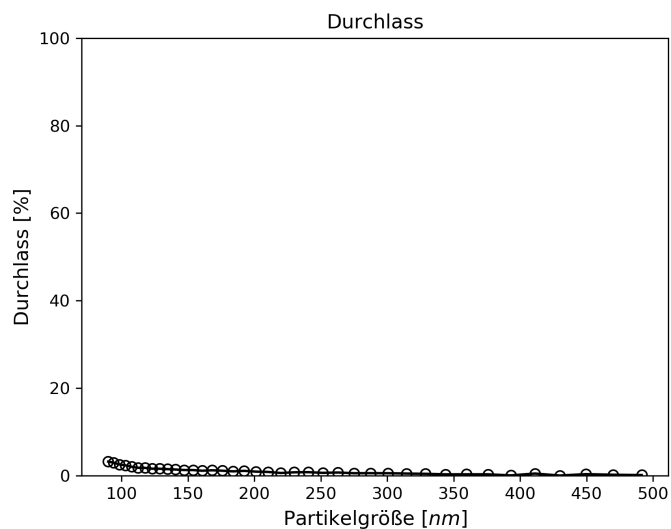

Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample Flow runter auf 30