

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S005

2020-04-23 13:27:46.890000

Anzahl Regenerationszyklen	2.0
Differenzdruck Maske	25.9 mbar
Differenzdruck ohne Maske	25.0 mbar
Volumenstrom	94.9 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.52
Aerosolkonzentration	22.6 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.9 mbar

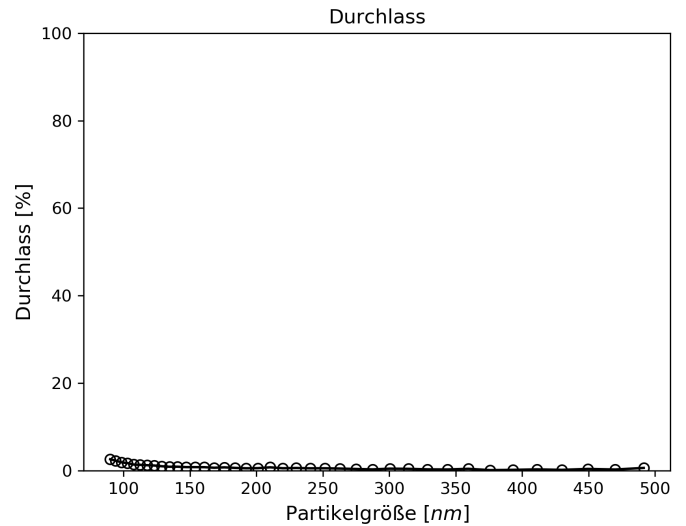

Optische Mängel:

Anmerkungen: