

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Makrite

Sekura-321

H3\_1\_2

2020-04-21 10:49:16.420000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	28.5 mbar
Differenzdruck ohne Maske	28.5 mbar
Volumenstrom	14.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	5.83
Aerosolkonzentration	128.95 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.0 mbar

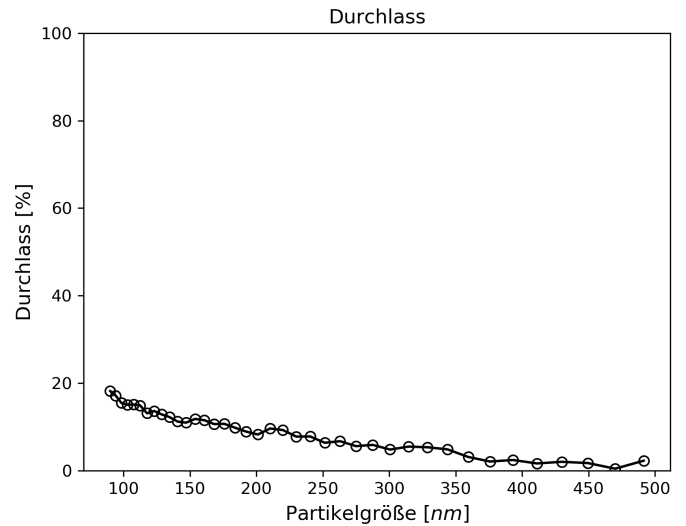

Optische Mängel:

Anmerkungen: