


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
3M	Aura 9322+	S006	2020-04-17 08:53:00.230000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	8.6 mbar
Differenzdruck ohne Maske	8.1 mbar
Volumenstrom	9.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.66
Aerosolkonzentration	192.41 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.5 mbar

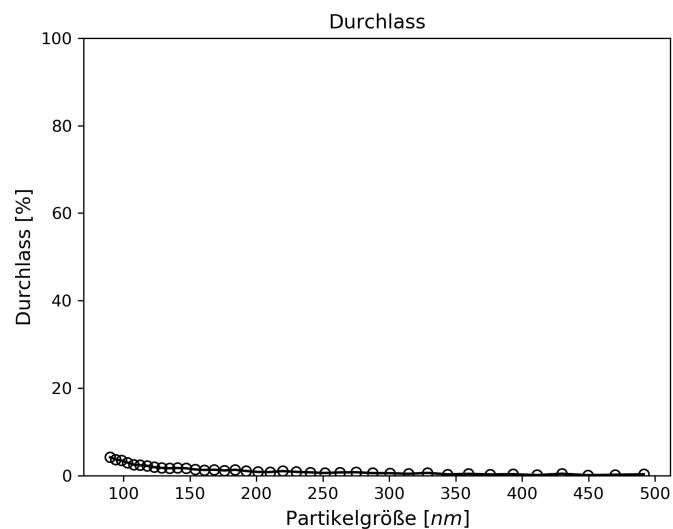

Optische Mängel:

Anmerkungen: