


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Makrite	Sekura-321	H5_1_2	2020-04-21 10:37:49.310000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	28.9 mbar
Differenzdruck ohne Maske	28.5 mbar
Volumenstrom	14.1 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	7.08
Aerosolkonzentration	129.81 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.4 mbar

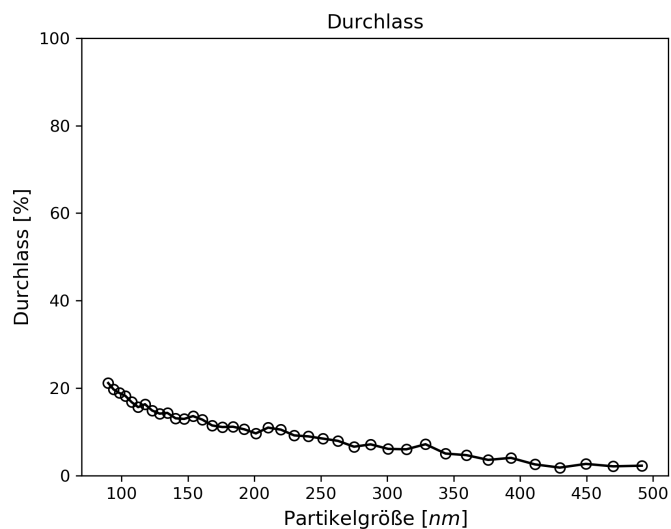

Optische Mängel:

Anmerkungen: