

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S006

2020-04-15 09:02:05.170000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	33.6 mbar
Differenzdruck ohne Maske	31.2 mbar
Volumenstrom	94.8 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.51
Aerosolkonzentration	22.62 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.4 mbar

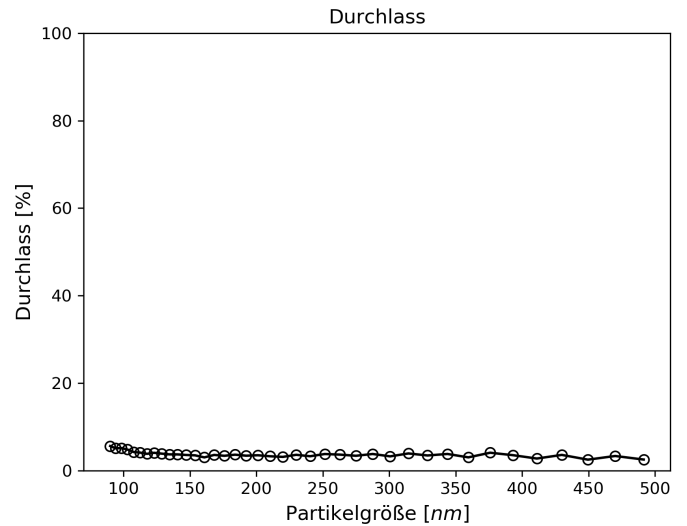

Optische Mängel:

Anmerkungen: