

# Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S012

2020-04-15 09:38:04.780000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	33.2 mbar
Differenzdruck ohne Maske	31.2 mbar
Volumenstrom	94.6 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	81.52
Aerosolkonzentration	22.67 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.0 mbar

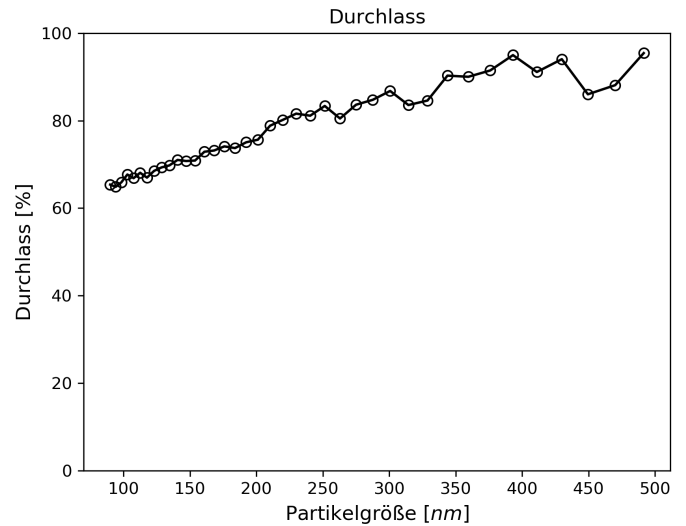

## Optische Mängel:

Nastenteil "festgeschweißt"; keine Ahnung, ob dies gewollt ist

## Anmerkungen:

Modell Dönertüte; Sitz jedoch optisch gut