


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Makrite	Sekura-321	H5_1_1	2020-04-21 09:02:06.780000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	24.0 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.0 mbar
Volumenstrom	94.8 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	4.03
Aerosolkonzentration	20.42 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.0 mbar

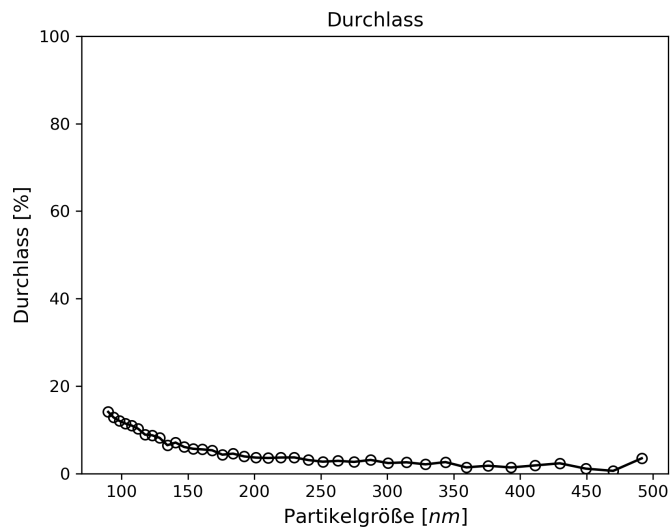

Optische Mängel:

Anmerkungen: