

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S013

2020-04-23 13:54:39.990000

Anzahl Regenerationszyklen	3.0
Differenzdruck Maske	24.7 mbar
Differenzdruck ohne Maske	25.3 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	68.31
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	-0.6 mbar

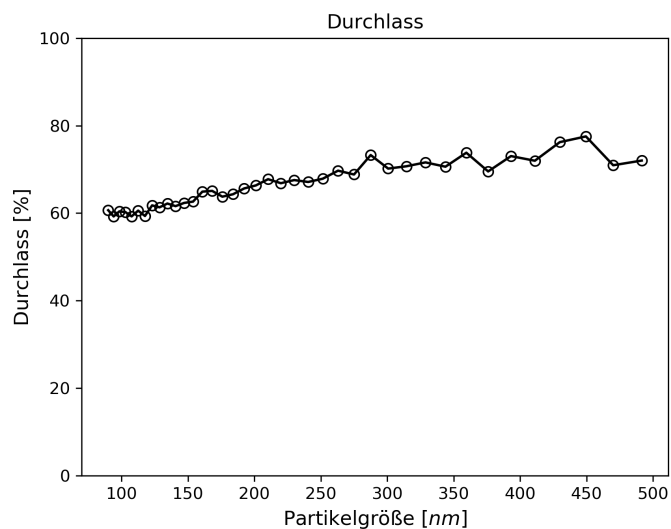

Optische Mängel:

Anmerkungen: