

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S012

2020-04-17 08:40:31.720000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	8.4 mbar
Differenzdruck ohne Maske	8.1 mbar
Volumenstrom	9.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	71.83
Aerosolkonzentration	192.41 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.3 mbar

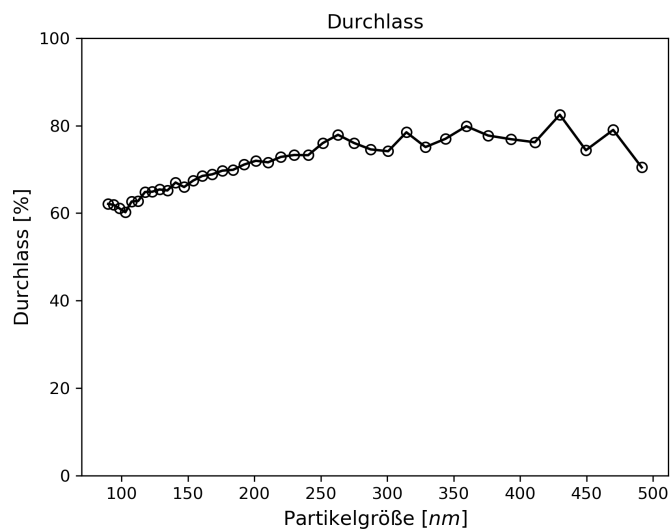

Optische Mängel:

Anmerkungen: