

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S006

2020-04-16 10:15:19.620000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	32.0 mbar
Differenzdruck ohne Maske	31.4 mbar
Volumenstrom	3.0 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.62
Aerosolkonzentration	493.56 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.6 mbar

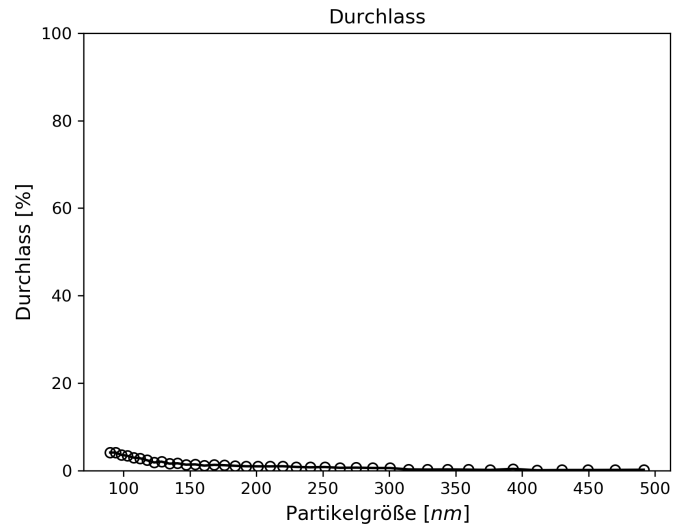

Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample flow rate 10 sccm