

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S011

2020-04-17 10:25:25.660000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	24.3 mbar
Differenzdruck ohne Maske	24.7 mbar
Volumenstrom	95.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	72.6
Aerosolkonzentration	22.41 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	-0.4 mbar

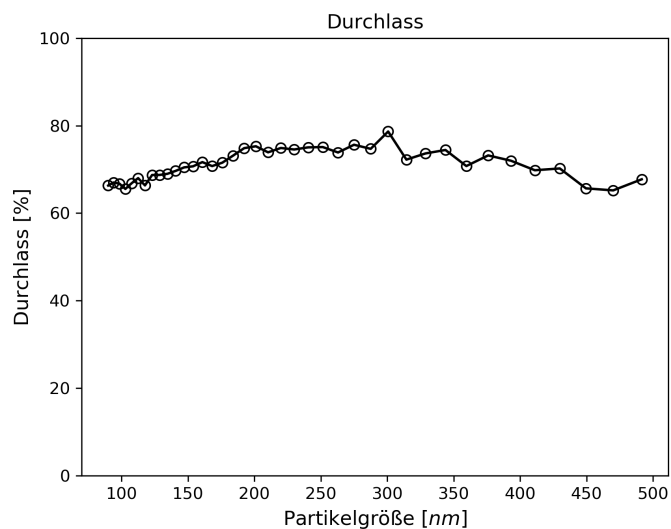

Optische Mängel:

Anmerkungen: