

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S014

2020-04-23 14:01:13.400000

Anzahl Regenerationszyklen	3.0
Differenzdruck Maske	25.9 mbar
Differenzdruck ohne Maske	25.3 mbar
Volumenstrom	95.0 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	69.92
Aerosolkonzentration	22.57 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.6 mbar

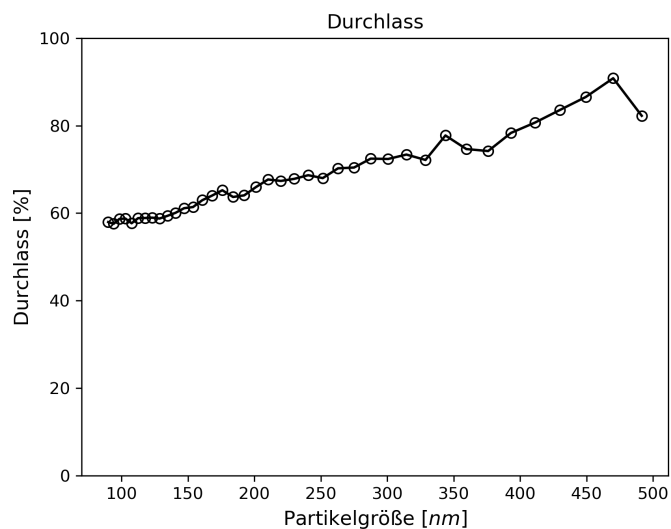

Optische Mängel:

Anmerkungen: