

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Makrite

Sekura-321

H3_1_1

2020-04-21 08:36:02.370000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	23.5 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.0 mbar
Volumenstrom	94.8 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	4.79
Aerosolkonzentration	20.42 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	1.5 mbar

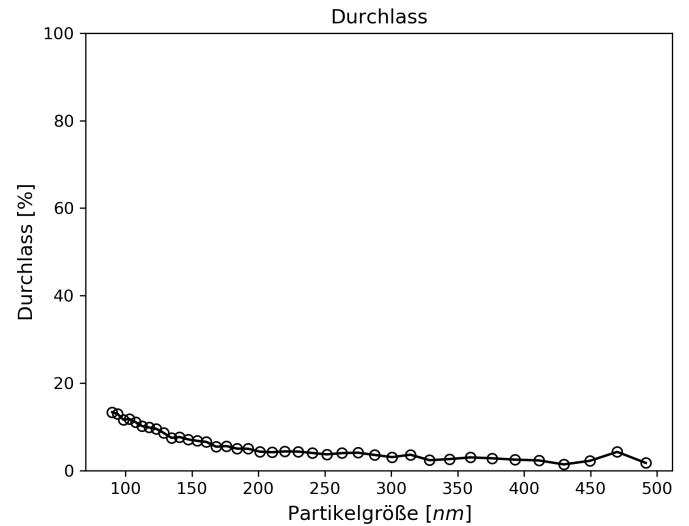

Optische Mängel:

Anmerkungen: