


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
Makrite	Sekura-321	H4_1_2	2020-04-21 09:26:53.190000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	23.3 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.0 mbar
Volumenstrom	95.2 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	4.79
Aerosolkonzentration	20.33 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	1.3 mbar

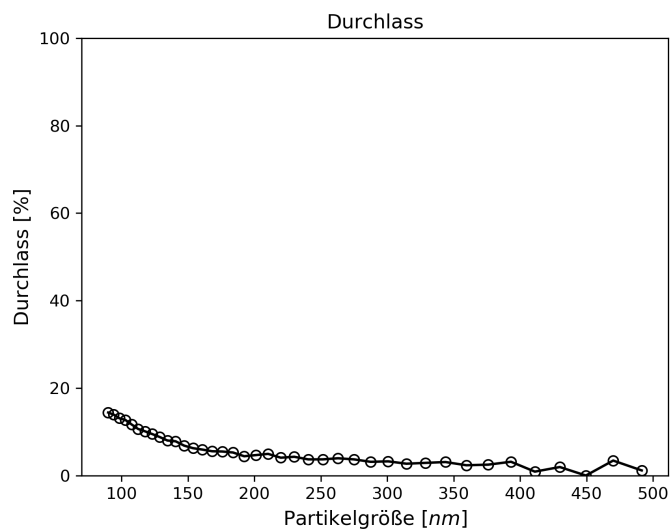

Optische Mängel:

Anmerkungen: