

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S012

2020-04-16 10:03:50.820000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	31.6 mbar
Differenzdruck ohne Maske	31.1 mbar
Volumenstrom	3.0 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	76.89
Aerosolkonzentration	493.56 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	0.5 mbar

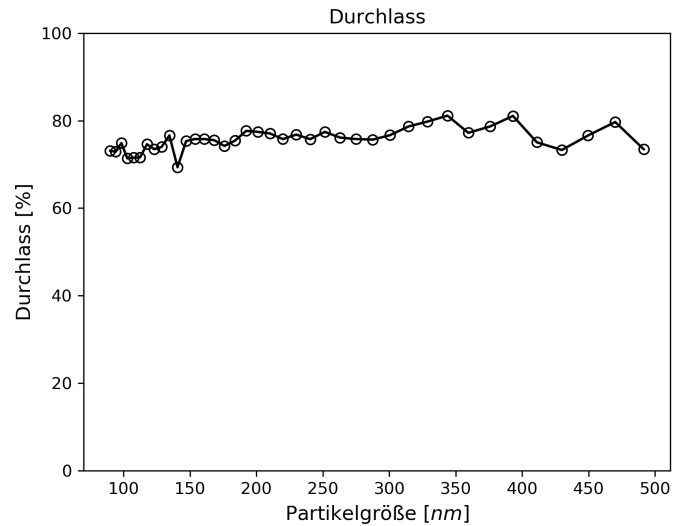

Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sample flow rate 10 sccm

S012\_F nach neuer Referenz nochmal vermessen