

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname


Datum

VIP Mask

S014_2

2020-05-22 14:01:23.520000

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Regenerationszyklen | 1.0 |
| Differenzdruck Maske | 0.43 mbar |
| Volumenstrom | 94.5 L/min |
| Nozzle Pressure | 200.0 mbar |
| NaCl Konzentration | 3.0 w% |
| Setup | Maskenteststand v1.0 |
| Charge | - |
| Durchlass | 78.33 |
| Aerosolkonzentration | 22.69 mg/m ³ |
| Messzeit | 180 sec |

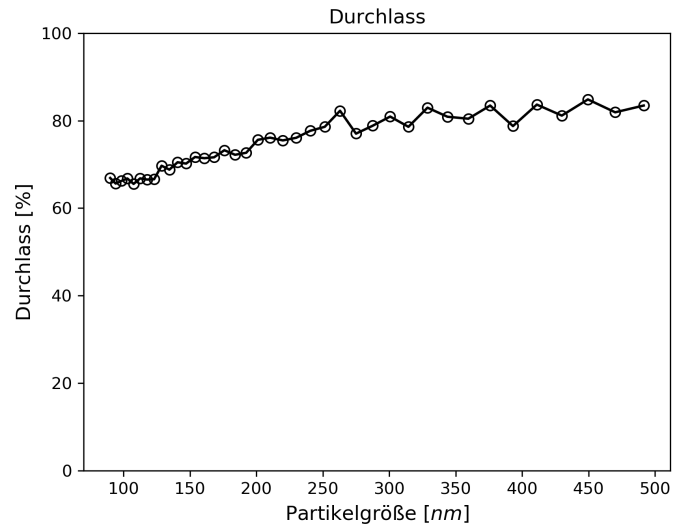

Optische Mängel:

Anmerkungen: