

Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


3M

Aura 9322+

S005

2020-04-15 09:11:36.770000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	33.7 mbar
Differenzdruck ohne Maske	31.2 mbar
Volumenstrom	94.7 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	3.62
Aerosolkonzentration	22.65 mg/m ³
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.5 mbar

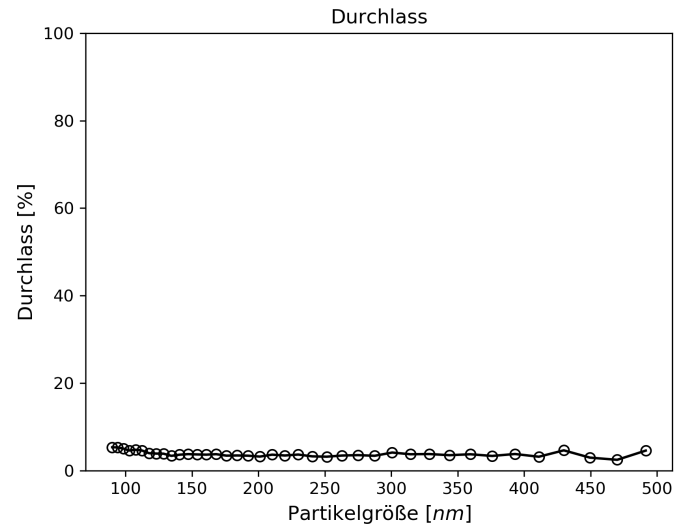

Optische Mängel:

Anmerkungen:

Sitz nochmals überprüft und angepasst