


Durchlasstest

Hersteller	Produktname	Probenname	Datum
3M	Aura 9322+	S020_2	2020-05-22 15:05:53.140000

Anzahl Regenerationszyklen	1.0
Differenzdruck Maske	1.465 mbar
Volumenstrom	94.8 L/min
Nozzle Pressure	200.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	0.3
Aerosolkonzentration	22.62 mg/m ³
Messzeit	180 sec

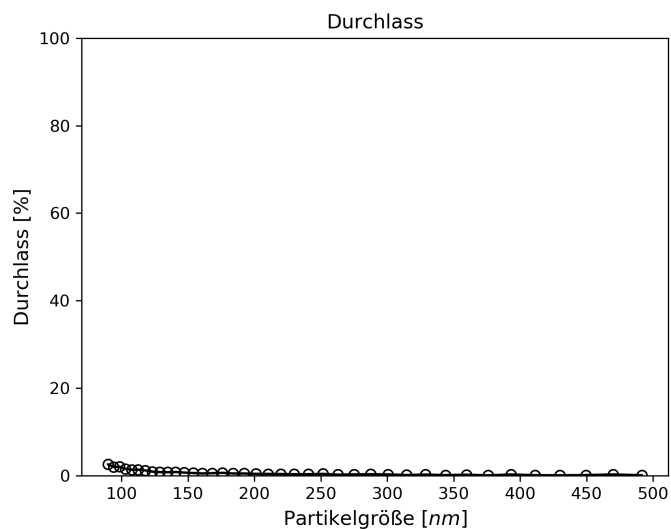

Optische Mängel:

Anmerkungen: