

## Durchlasstest

Hersteller

Produktname

Probenname

Datum


Makrite

Sekura-321

H1\_1\_2

2020-04-21 09:08:14.580000

Anzahl Regenerationszyklen	0.0
Differenzdruck Maske	24.1 mbar
Differenzdruck ohne Maske	22.0 mbar
Volumenstrom	94.6 L/min
Nozzle Pressure	150.0 mbar
NaCl Konzentration	3.0 w%
Setup	Maskenteststand v1.0
Charge	-
Durchlass	2.51
Aerosolkonzentration	20.46 mg/m <sup>3</sup>
Messzeit	180 sec
Druckverlust	2.1 mbar

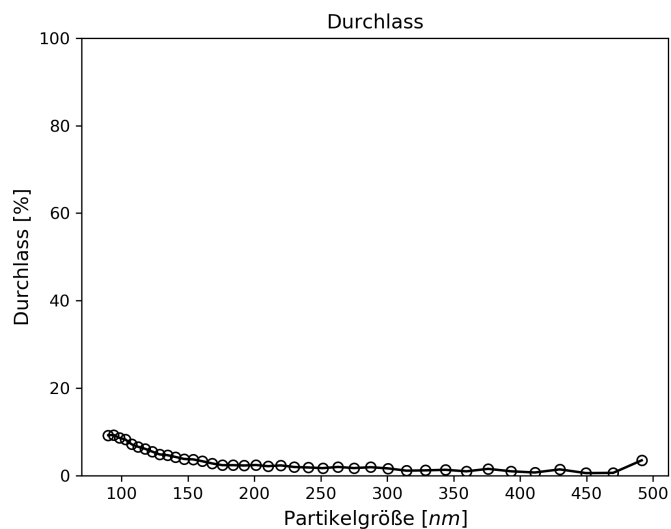

Optische Mängel:

Anmerkungen: