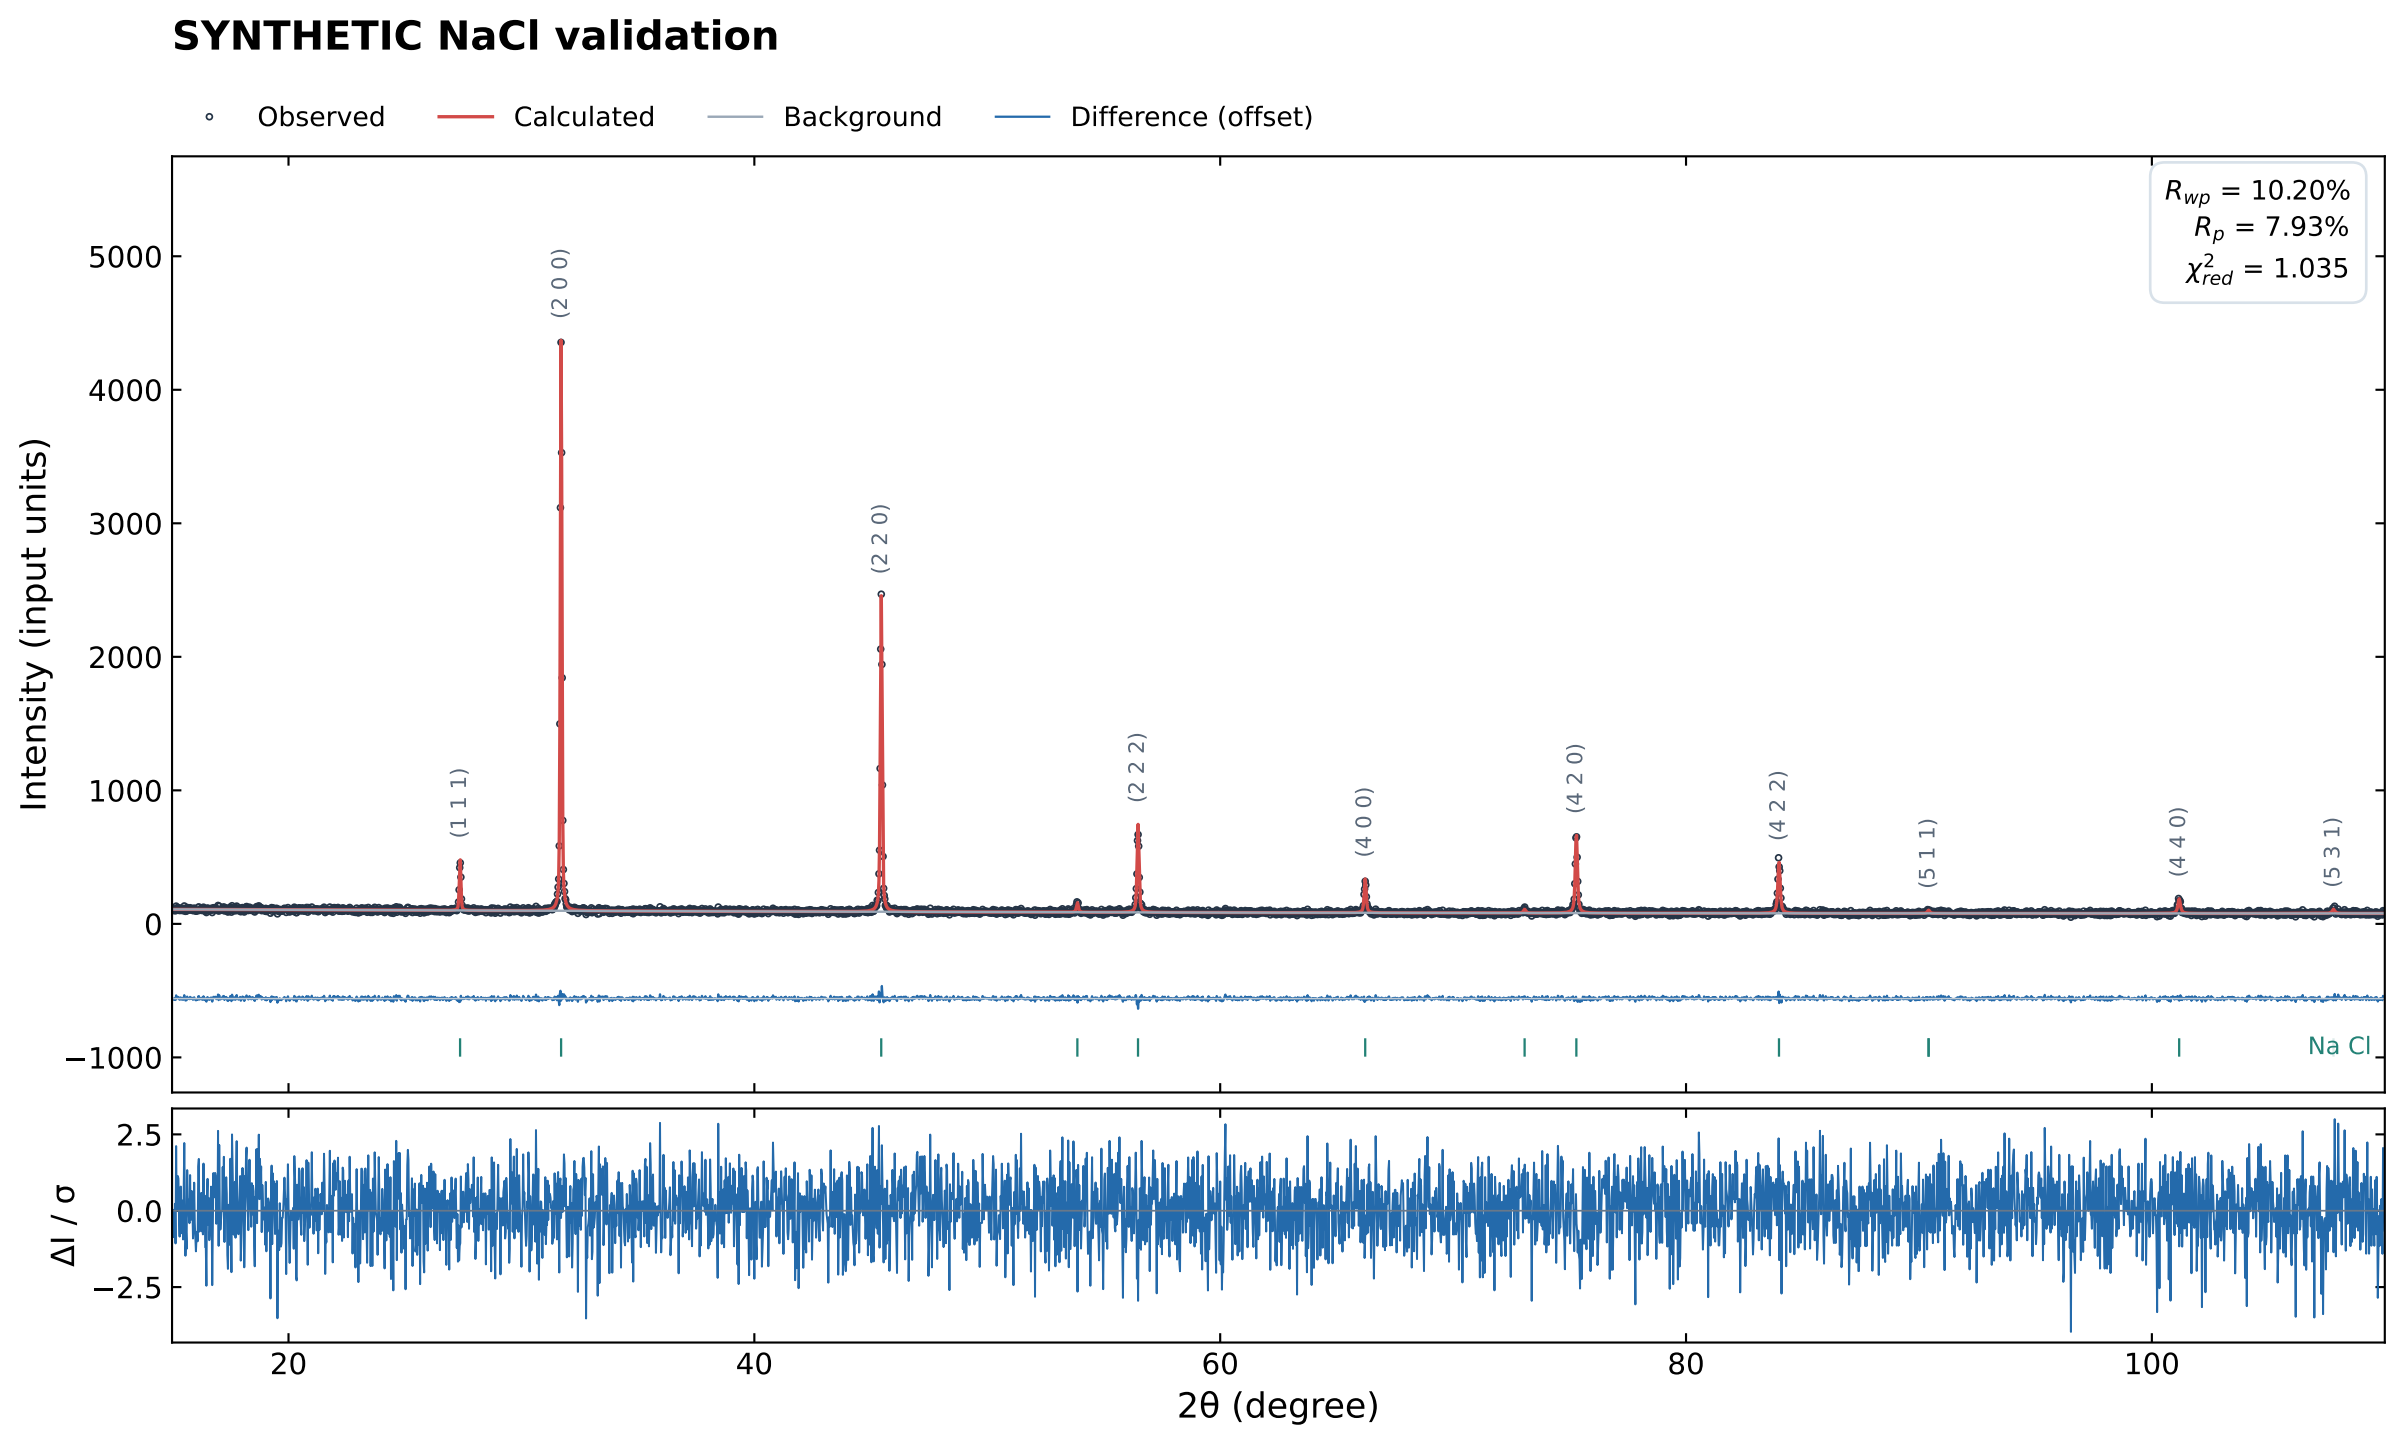

SYNTHETIC NaCl validation
Observed
Calculated
Background
Difference (offset)
R_{wp} = 10.20%
R_p = 7.93%
χ^2_{red} = 1.035
(1 1 1)
(2 0 0)
(2 2 0)
(2 2 2)
(4 0 0)
(4 2 0)
(4 2 2)
(5 1 1)
(4 4 0)
(5 3 1)
Na Cl
Intensity (input units)
5000
4000
3000
2000
1000
0
−1000
ΔI / σ
2.5
0.0
−2.5
20
40
60
80
100
2θ (degree)