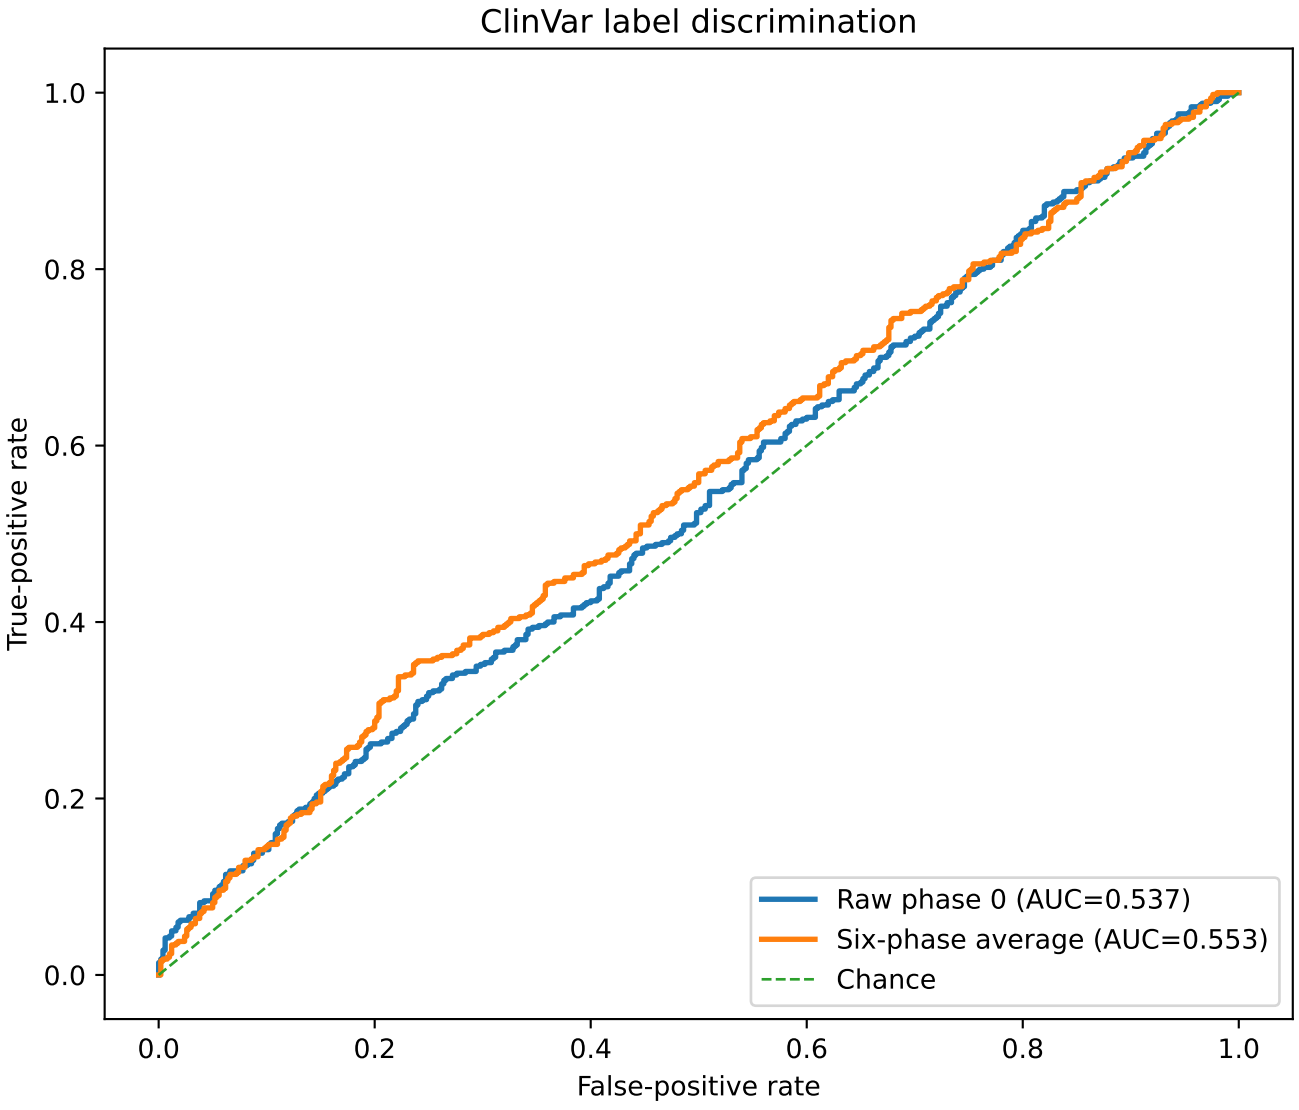
ClinVar label discrimination
True-positive rate
False-positive rate
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Raw phase 0 (AUC=0.537)
Six-phase average (AUC=0.553)
Chance