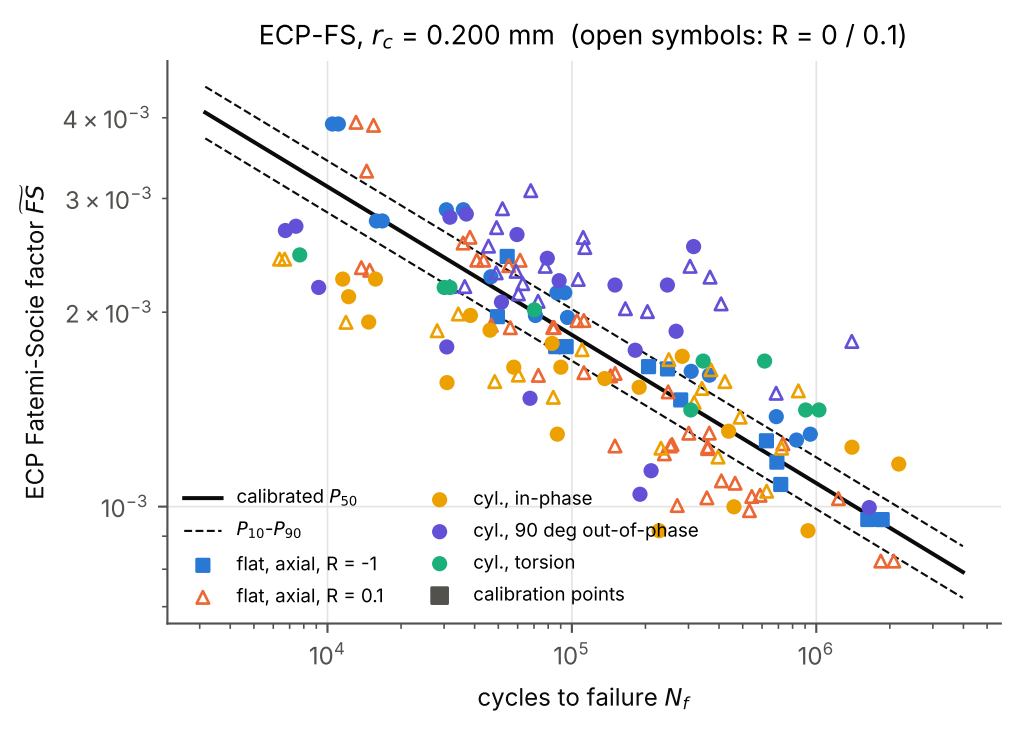
ECP-FS, r_c = 0.200 mm (open symbols: R = 0 / 0.1)
ECP Fatemi-Socie factor $\widetilde{FS}$
4×10^{-3}
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
10^4
10^5
10^6
cycles to failure N_f
calibrated P_{50}
P_{10}-P_{90}
flat, axial, R = -1
flat, axial, R = 0.1
cyl., in-phase
cyl., 90 deg out-of-phase
cyl., torsion
calibration points