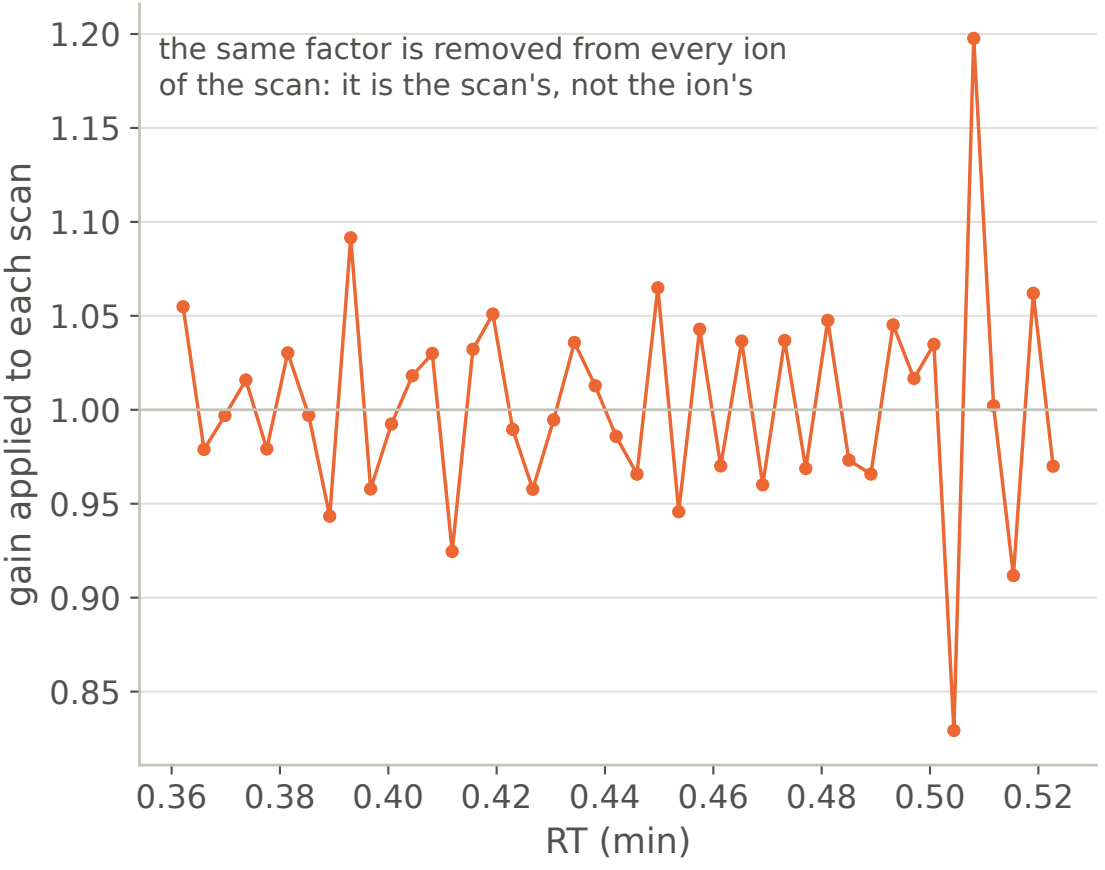
the same factor is removed from every ion
of the scan: it is the scan's, not the ion's
gain applied to each scan
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
RT (min)