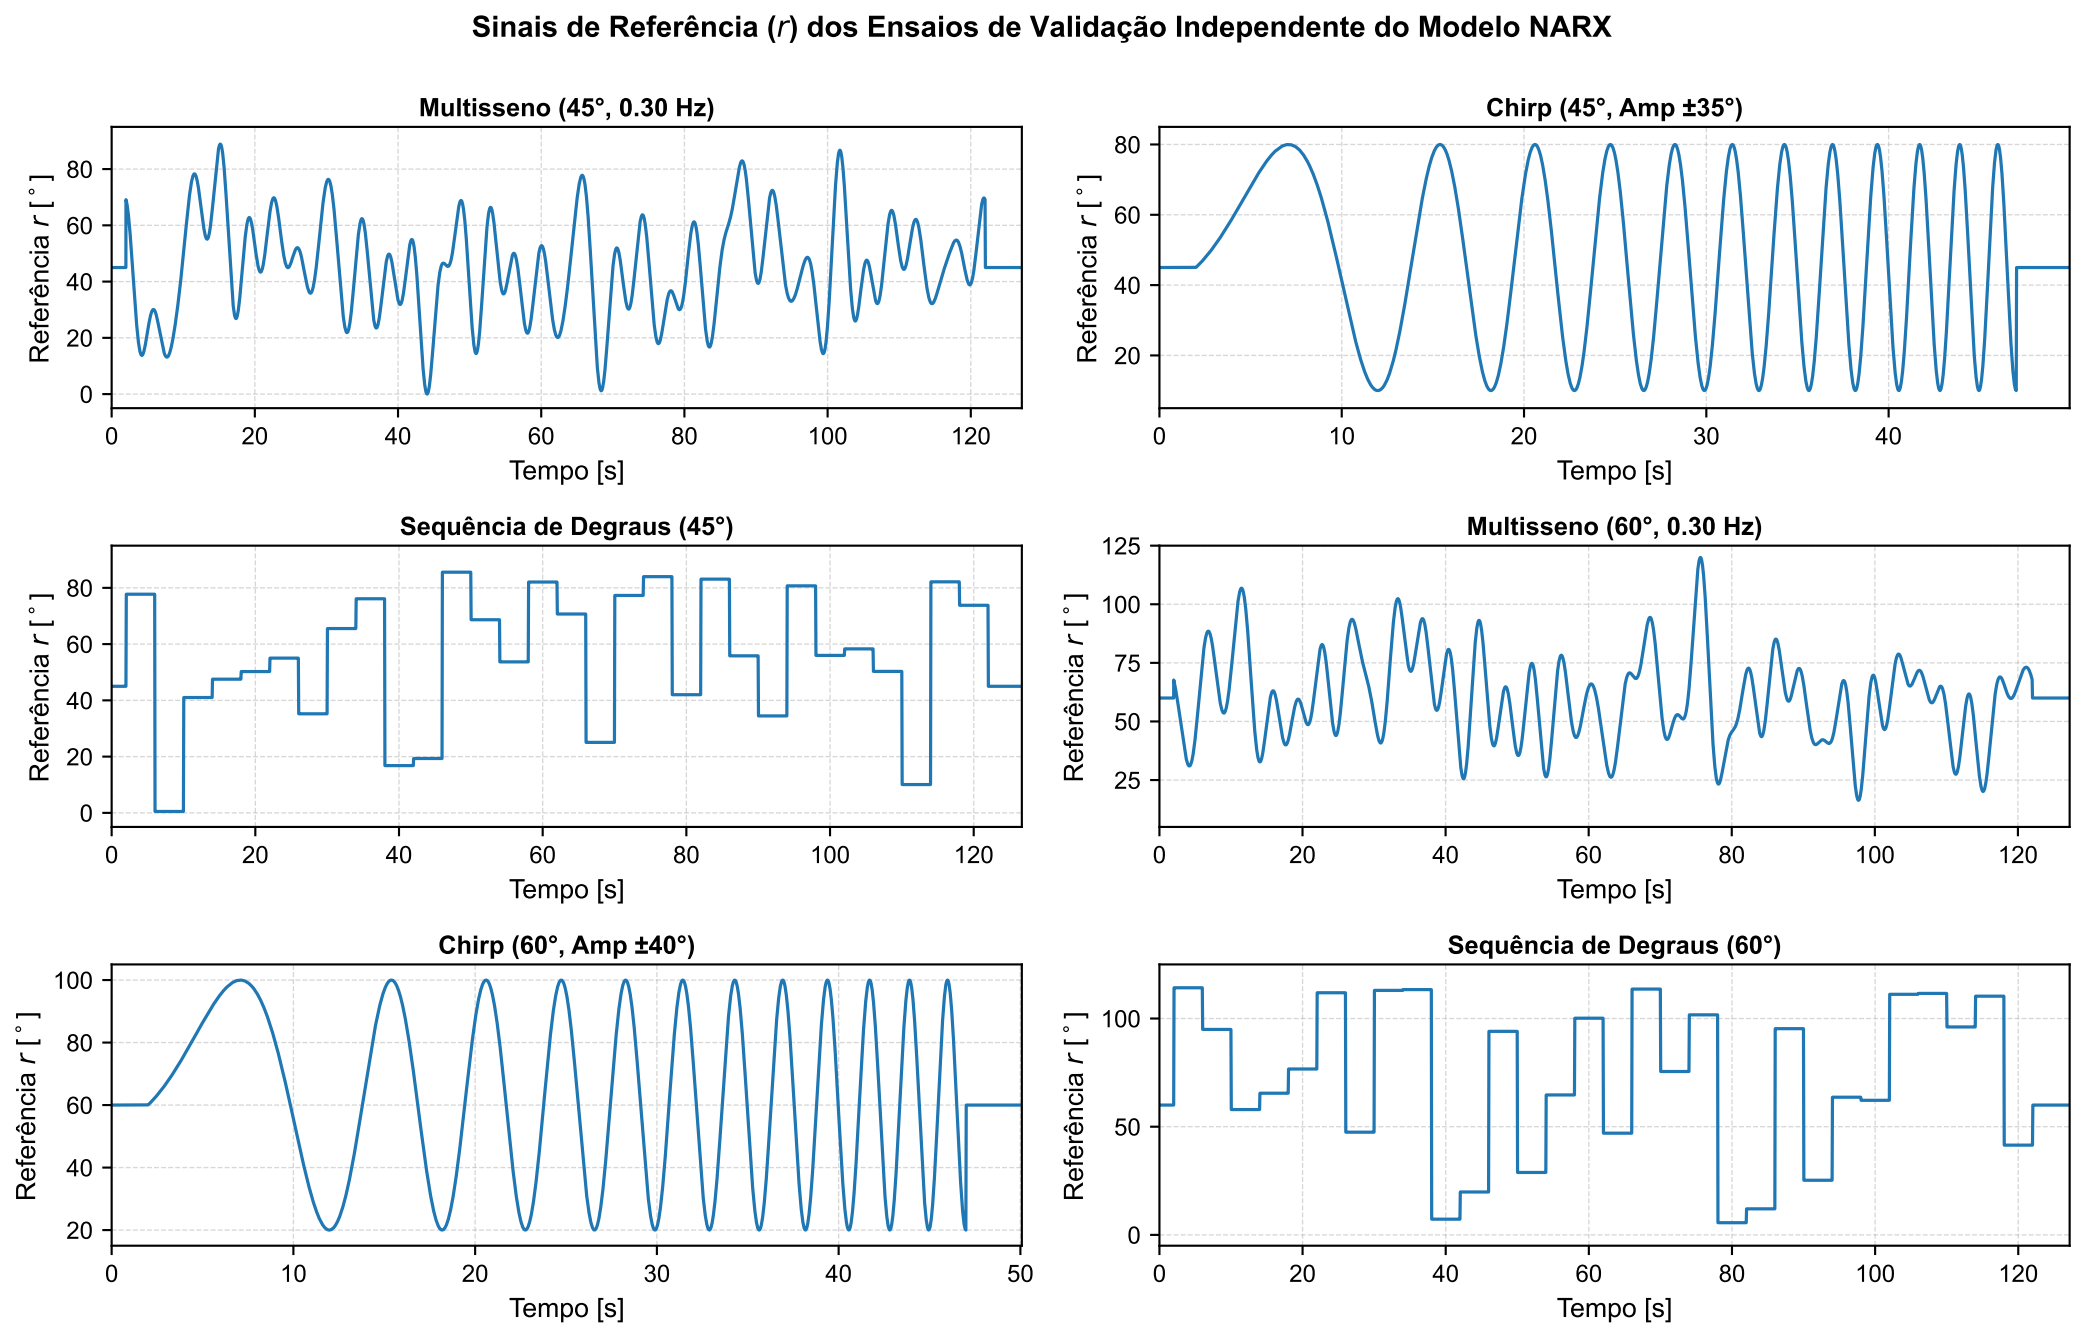
Sinais de Referência (r) dos Ensaios de Validação Independente do Modelo NARX
Multisseno (45°, 0.30 Hz)
Chirp (45°, Amp ±35°)
Sequência de Degraus (45°)
Multisseno (60°, 0.30 Hz)
Chirp (60°, Amp ±40°)
Sequência de Degraus (60°)
Referência r [°]
Tempo [s]