

DISPOSITIVO PARA LA CORRECCIÓN DEL CAMPO BIOFÍSICO HUMANO


Inventor: Kaznacheev, V. P. y Shatarnin, A. Ju.

Fecha de publicación: 20.11.1999

Resumen:

El dispositivo para la corrección de campo biofísico del ser humano se relaciona con la ciencia y la práctica de la medicina y se puede utilizar para la corrección de los trastornos funcionales y enfermedades de los cambios relacionados con humanos en los campos biofísicos del hombre, así como para la investigación científica.

El aparato incluye un cilindro hueco hecho de una aleación de aluminio espesor superficie interna pulida de 1.5-2 mm, una anchura mínima de 110 cm y una longitud de 200 cm, montada en una posición horizontal sobre un soporte. A el espacio interior del cilindro unidad ubicada helio-neón un láser conectado a la camisa del cilindro en su extremo de cabeza en un soporte móvil, de modo que el rayo láser fue dirigido en el eje longitudinal central del cilindro durante el cuerpo del paciente, una plataforma para colocar al paciente, que tuvo lugar en una posición horizontal en la pared del cilindro en su parte inferior, hecha de material no metálico y la longitud correspondiente y dimensiones de anchura de un cilindro en el lugar de su fijación. La invención puede mejorar la eliminación de las distorsiones de los campos biofísicos de material no metálico, y su longitud y width corresponden a szles cilindro en el punto de su fijación. EFECTO: la eliminación eficaz de las distorsiones de campo biofísicos. 2 el 8 de dwg.

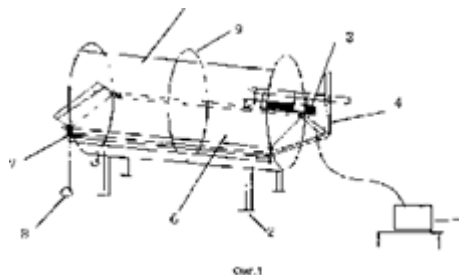

La invención se refiere a la ciencia y la práctica de la medicina y se puede utilizar para la corrección de los trastornos funcionales y enfermedades en los seres humanos, asociado con los cambios en los campos biofísicos del hombre, así como para la investigación científica.

Debido a la condición relación establecida campos biofísicos del hombre con su estado funcional, con el paso de una serie de enfermedades (1) son intentos de desarrollar dispositivos para la corrección de los campos biofísicos del hombre, basado en la exposición a una energía cósmica "concentrado" "acumulativo" sabe (2) bien aislamiento de la paciente de los efectos campos heliogeofísica (3).

La calidad del metal usado en el acero y el hierro - Un dispositivo para la corrección de campo biofísico humana (cámara de Reich) (2) formada como una cámara cerrada con paredes hechas de material multicapa alterna rectangular plana (metal material aislante). Se supone que el principio de que el dispositivo se basa en los efectos sobre el campo humano biofísico "acumulada" energía cósmica. A pesar de las indicaciones fragmentarias de la posibilidad de aplicación del dispositivo todavía no se recibe información fiable sobre el cambio de campo humana biofísico cuando se somete a un dispositivo dado y los posteriores cambios significativos en el estado funcional de la persona o efecto terapéutico de la utilización del dispositivo. En este sentido, no puede ser adoptado como un análogo.

También es conocido dispositivo (cámara hypomagnetic) para la corrección de campo humana biofísico formado en una habitación aislada o una cámara cerrada con paredes hechas de placas de acero rectangulares planas que proporcionan el aislamiento del paciente de los campos

electromagnéticos naturaleza física externa, en particular los campos heliogeofísica (3). La desventaja de este dispositivo es que proporciona una corrección de campo biofísico indirecta por el aislamiento temporal de la paciente en desventaja mediante el establecimiento de los días de acción en su campo biofísico de campos físicos externos, lo que conduce a una mejora del estado funcional de las personas con un alto grado de sensibilidad a un cambio drástico campos heliogeofísica.

El más cercano al dispositivo reivindicado es para corregir el campo humano biofísico (4) que comprende un cilindro de metal hueco montado verticalmente de aleación de aluminio con un espesor de 1.5-2 mm de diámetro superficie interior pulido de al menos 110 cm, en cuyo interior hay un lugar para colocar al paciente en una posición sentada. Se supone que el efecto de la corrección se logra centrándose una determinada región del espacio interno del cilindro y expedición (por las leyes de la óptica) en la región reguladora del cuerpo para campos biofísicos propios después de la amplificación en el área de interacción, que surja durante su vida debido a la exposición a los campos electromagnéticos externos y otros. Esto conduce a un efecto insuficiente de la corrección del campo sobre el estado funcional o la naturaleza de la enfermedad, causada por una violación de la estructura normal de los campos biofísicos del hombre.

La tarea a resolver por la invención reivindicada es eliminar la distorsión de los campos biofísicos del hombre.

Este objeto se consigue por el hecho de que el dispositivo propuesto, el cilindro está montado en el soporte en una posición horizontal en el espacio interior de su extremo "cabeza" del aparato de conjunto láser de helio-neón se fija al cilindro de la carcasa sobre un soporte móvil de modo que el rayo láser se dirige a la central de el eje longitudinal del espacio cilindro interior por encima del cuerpo del paciente; ubicación para el paciente está formado de material no metálico en forma de una plataforma horizontal coincidente en la ubicación a lo largo de la longitud y dimensiones de anchura correspondientes con el cilindro. Cuando el cilindro está configurado en dos partes divide horizontalmente de forma móvil fija uno respecto al otro, y el área del paciente está unido a la porción inferior (fija) del cilindro.

Aparato para corregir biofísico persona campo (Fig. 1) incluye un cilindro hueco 1 hecha de una aleación de aluminio y una longitud de de 200-220 cm, un diámetro de no menos de 110 cm, un espesor de 1.5-2.0 mm y pulido (espejo) del interior superficie montada en

una posición horizontal sobre soportes 2. El final "cabeza" de la interna (de trabajo) del espacio de la carcasa del cilindro es un dispositivo láser de helio-neón 3 (el aparato estándar que se utiliza en la práctica médica, como la marca A T-111, con una longitud de onda de 700 a 760 nm) montado en un soporte móvil 4 con la posibilidad de reposicionamiento de la carcasa del láser sobre los ejes vertical y horizontal, de modo que el rayo láser se dirige en el eje longitudinal central del espacio cilindro interior por encima del cuerpo del paciente. La carcasa del dispositivo láser está conectado a la fuente de alimentación 5. En la parte inferior del cilindro es la plataforma horizontal 6 para colocar al paciente correspondiente al punto de fijación a lo largo de la longitud y dimensiones de anchura del cilindro y está hecho de material no metálico (para evitar campo biofísico distorsión) espesor de 4-6 cm.

La parte superior del cilindro está reforzada con un lado a la estructura metálica 7 que tiene dos soportes móviles en forma de ruedas 8 y por otra parte - cojinete de giro situado en las superficies laterales de la plataforma para el paciente. Para una mayor rigidez de la parte superior

Se reforzó parte del cilindro entre marcos 9 con lados cortos; la parte inferior del cilindro, como se indicó anteriormente, montada sobre cuatro soportes verticales y rígidamente acoplado con una plataforma para dar cabida a un paciente. A través de esta estructura, la parte superior del cilindro se mueve libremente sobre toda la longitud con respecto a la parte inferior (Fig. 2), permitiendo que el paciente permanezca en una superficie horizontal en la posición supina, con lo cual la parte superior del cilindro es empujado hacia atrás, cerrando el espacio del cilindro.

Los requisitos previos para espacio de trabajo activa dentro de la estructura y, por lo tanto, lograr un efecto correctivo son:

- La colocación del diseño de la habitación es las anomalías magnéticas locales y biolocation; la ocupación en la construcción Habitación insonorizada con utilizando tubos fluorescentes para la iluminación; la realización de procedimientos en situación heliogeofísica vista, ya que el efecto de la corrección es la situación heliogeofísica determinada, que es más sensible para el paciente.

El funcionamiento se basa en la concentración de efecto de los campos biofísicos reflejadas de hombre (trabajo de Kozyrev), y su interacción con el sistema láser. Se espera que, como resultado de esta interacción se logra como resultado de la restauración de las diversas influencias patógenas homeostasis de la energía (campo biofísico de la estructura).

El dispositivo funciona como sigue.

El paciente se coloca en el espacio de trabajo del cilindro en la posición supina. Fijar el dispositivo de láser de modo que el haz de láser pasa por el eje longitudinal central del espacio cilindro interior por encima del cuerpo del paciente. Se les pide a los pacientes para llevar a cabo un procedimiento para la relajación de 5 minutos, a continuación, durante 15 min, el láser.

Registro de efecto de corrección campo biofísico humano se realiza mediante el registro fotográfico dedos de radiación biofísico de ambas manos Kirlian (5- 7), antes y después de una sesión de la corrección para toda la corrección del rumbo, y después de 1-3 meses después de la finalización de la corrección del rumbo. Al mismo tiempo evaluar el estado funcional del paciente usando los métodos de estudios clínicos y electrofisiológicos: una encuesta, inspección, medición de frecuencia cardíaca, la presión arterial, los parámetros eléctricos de los puntos de acupuntura. La evaluación del estado psico-emocional del paciente en una escala de Taylor y Eysenck.

El número total de sesiones por curso de tratamiento - del 7 al 10.

Los resultados de la aplicación del dispositivo para la corrección de los campos biofísicos del hombre.

Ejemplo 1.

Paciente K., de 38 años de edad, se quejó de fatiga, falta de sueño, dolores de cabeza frecuentes, dolor en el epigastrio después de comer, estreñimiento frecuente. Diagnóstico: distonía vascular del tipo mixto, gastroduodenitis crónica en fase de exacerbación lento, el síndrome del intestino irritable, bajo el dolor de cuello espalda y el pecho sin exacerbación.

A partir de la encuesta se encontró que la naturaleza del trabajo asociado con la sobrecarga neural del paciente, y la situación en casa se asocia con una serie de problemas familiares. La dieta no es respetado.

OBJETIVO: palpación - vientre

moderadamente epigástrica dolorosa, ruidos cardíacos rítmicos, sin ruido, frecuencia cardíaca (FC) - 72 latidos por minuto, presión arterial (PA) - 140/85 mm Hg. st., en los pulmones respiración vesicular, sin sibilancias. Durante las pruebas psico-fisiológica en la escala de Eysenck y Taylor encontró un alto grado de neuroticismo, aumento de la ansiedad.

Análisis de fotografías dedos de ambas manos, hechos por el método Kirlian mostró la presencia de defectos en la corona expresada en forma de pérdida de segmentos individuales de alrededor de 25% de esa evidencia de violaciones campo biofísico del paciente (Fig. 3a). Después de la primera sesión el paciente reportó mejoría en el bienestar general, la elevación del estado de ánimo. La presión arterial - 120/80 mm Hg. Arte, ritmo cardíaco -. 64 latidos por minuto. Mostrando campos biofísicos mejora de rendimiento: la restauración de la estructura de la luz, ausencia de pérdida de defectos.

Durante los próximos cinco sesiones detuvieron casi por completo los dolores de cabeza, mejorar el sueño, el apetito regresó a la función normal tracto gastrointestinal. De acuerdo con la psico nivel de neuroticismo disminuido. Durante 1,5 meses. después de la corrección de las quejas sobre el estado de salud no muestra. Después de una situación estresante apareció sensación de tensión interna, un cierto malestar. En las imágenes Kirlian (Figura 3.6.) - Contorno irregular resplandor serpentinas corona se superponen, no hay segmentos de precipitación, en comparación con los datos originales - violaciones no expresadas de campo biofísico del paciente. A tres sesiones de corrección, después de lo cual la notable mejora de la salud, la reducción de los niveles de neuroticismo y la ansiedad. Restablecer plenamente los contornos normales del resplandor del método Kirlian. En los próximos 6 meses, no hay quejas. Para la evaluación objetiva - deterioro allí.

Ejemplo 2. El paciente D., de 44 años, fue ingresado en el síndrome de hipertensión. Después del examen, con diagnóstico de la etapa 2 de la hipertensión. Denuncias presentadas sobre los dolores de cabeza, dolor en el corazón, fatiga, depresión, meteoavisimost. BP dentro 150/100 - 220 a 110 mm Hg Aumento meteoavisimost. Durante mucho tiempo, el paciente recibió fármacos antihipertensivos y sedantes, pero no se logró el efecto del tratamiento.

Análisis del método de luminiscencia Kirlian

Se demostró la presencia de defectos, aproximadamente el 30% de la superficie de la corona (4, a). Antes del primer tratamiento de la presión arterial - 170/100 mm Hg, la frecuencia cardíaca - 78 latidos por minuto. Después del procedimiento, el paciente manifestó la mejora del bienestar general. La presión arterial - 150/90 mm Hg. Arte, ritmo cardíaco -. 66 latidos por minuto.

Las imágenes de los defectos Kirlian en el resplandor, suaves contornos de la corona.

Después de las 5 sesiones de corrección se detuvieron por completo los dolores de cabeza, mejoran el sueño, informó el paciente ligereza especial del Estado, vivacidad. BP se ha estabilizado en el rango de -150 / 90 130/80 mm Hg. Art. Marcado efecto de los fármacos antihipertensivos (anteriormente no dar efecto) a una dosis de 6 veces menos que antes de la admisión (0.5 comprimidos por la mañana y por la noche). El curso del tratamiento se completa después de 10 sesiones. Quejas subjetivas estaban ausentes. BP se mantuvo en el primer rango (130/80 -.. 150/90 mm Hg Arte). En el análisis del resplandor de descarga de gas observado la ausencia de defectos, suaves contornos de la corona (Fig. 4.6). Durante los próximos 3,5 meses en los pacientes tratados con fármacos antihipertensivos 0.5 tabletas deterioro diario de la salud no lo era.

Ejemplo 3. Paciente G., de 25 años, fue ingresado en el diagnóstico de la psiconeurosis. Presentado denuncias pesadillas, aparecen como durante la noche, ya la luz latente durante el día de descanso. Su apariencia era periódica y fue independiente de las palabras cambios de pacientes desde el estado psicológico previo, en relación con cualquier sobrecarga psicoemocional. En palabras del marido de la paciente, durmiendo su condición puede descrito como extremadamente ansioso: WinCE, llora, habla en sueños.

El estatuto de limitaciones problemas - 3 años. Durante este tiempo ha habido un llamamiento a los intentos del terapeuta en auto al meditar, por sedantes que reciben, pero fue alcanzado el efecto de C.

Según psicofisiológica

Prueba en la escala de Eysenck y Taylor ICHZ alto nivel de ansiedad definido.

Se han identificado datos sobre el estado físico del cambio de material.

El análisis por el método de resplandor de descarga de gas

Kirlian mostró la presencia de defectos en la forma de segmentos individuales ^ gota 30%

Plaza de la Corona, la ramificación de serpentinas, D) se solapan el uno del otro; contorno óvalo interior delineó claramente (Fig. 5a).

Después de la tercera sesión

El paciente tomó nota de la terminación de la naturaleza aterradora de los sueños durante el día cerca de recreación. Las pesadillas durante la noche se mantuvo, pero no eran el mismo brillo que resulta imágenes. Después de 11 sesiones de sueños terroríficos cesaron contenido completamente, de acuerdo con la prueba disminución de la ansiedad, neuroticismo.

Según los datos obtenidos por el método de Kirlian, aparecido suaves contornos de la corona, no hay segmentos de precipitación (Fig. 5.6). Un mes después de la finalización del tratamiento marcada remisión. Por el método de Kirlian - resplandor lisa brillante y sin grandes lagunas y defectos, que puede ser considerado como el efecto positivo de corregir definitivamente.

Lista de referencias:

1. Mandel R. diagnóstico terminal de punto Energética. Kosmo-Medizin, Bd 1. - 1986.

2. Bernd Senf. Wilhelm Reich.

Energía acupuntura Descubridor. Biophysical Journal of Medicine, -1992, 1, p. 35-46.

3. magnetoreception magnetita biogénica.

Nuevo en Biomagnetismo / Bajo. Ed. Dzh.Kirshvinka, D.Dzhonsa, B.Mak-Thaddeus / - M.:

Mir, 1989, versión 1, p. 287.


4. La aplicación de RF N 96113190/14.



5. VG Adamenko, SD Kirlian, Kirlian VH En el estudio de los objetos biológicos en los campos eléctricos de alta frecuencia. Sáb: Preguntas bioenergía -Alma-Ata,


1969, p. 19-26.

6. SD Kirlian, Kirlian VH El mundo * s ""lugares maravillosos. MM: 3nane 1964.


7. Korotkov KP efecto Kirlian.- San Petersburgo; 1995.

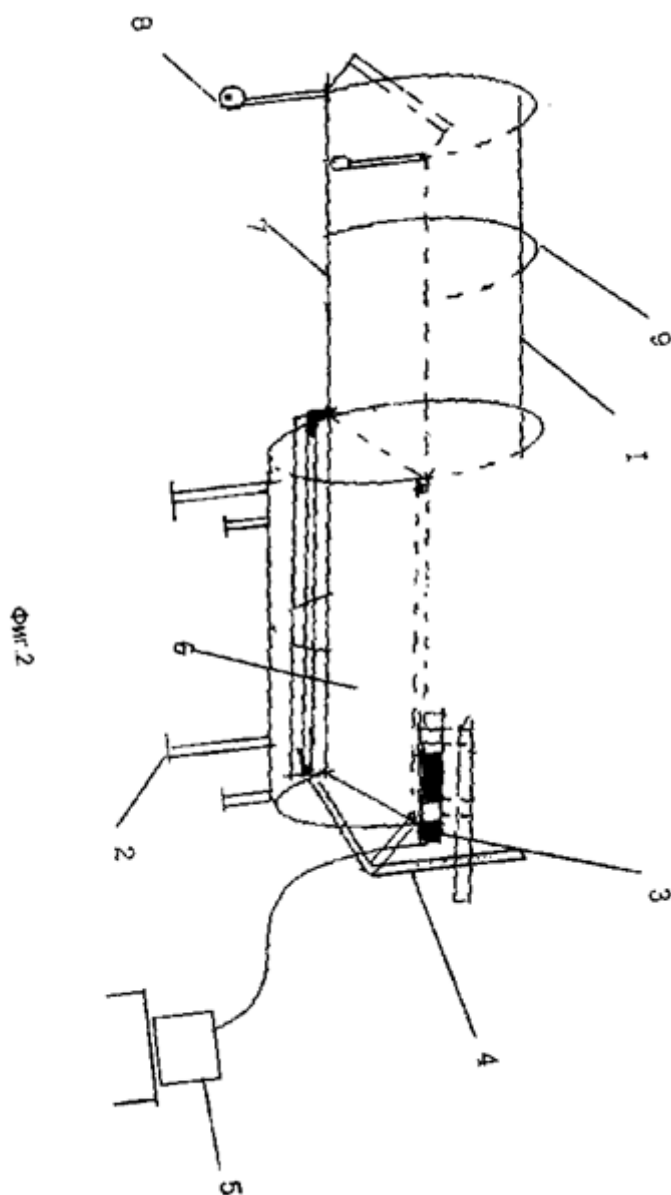

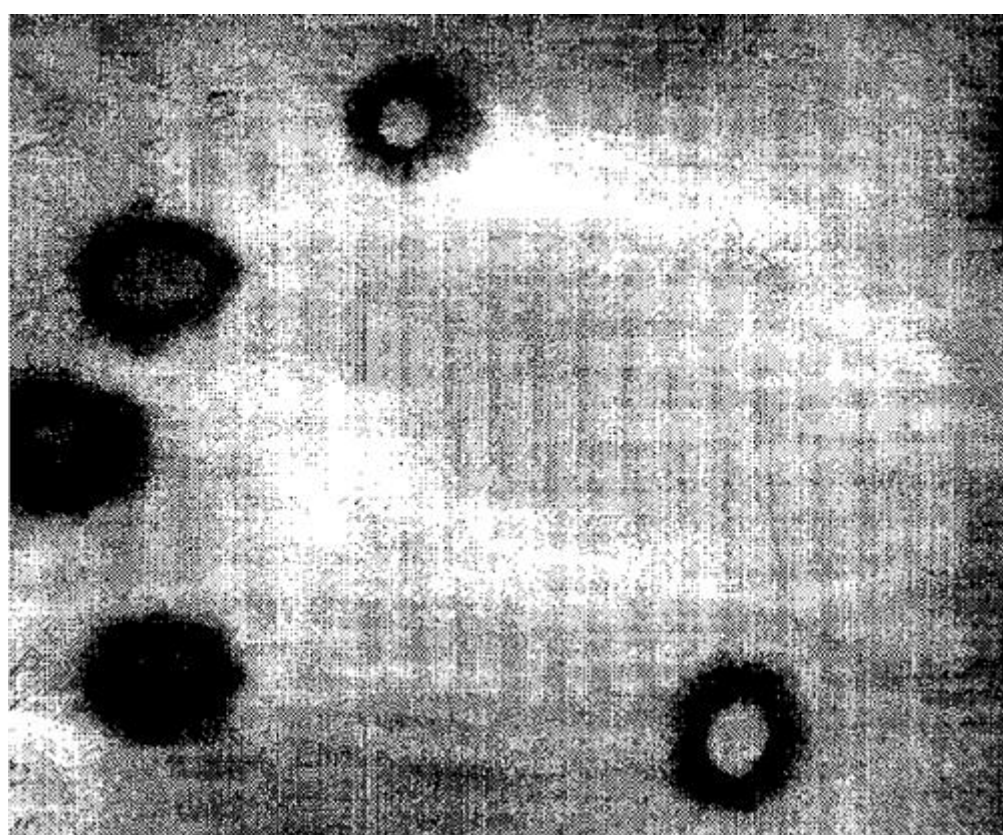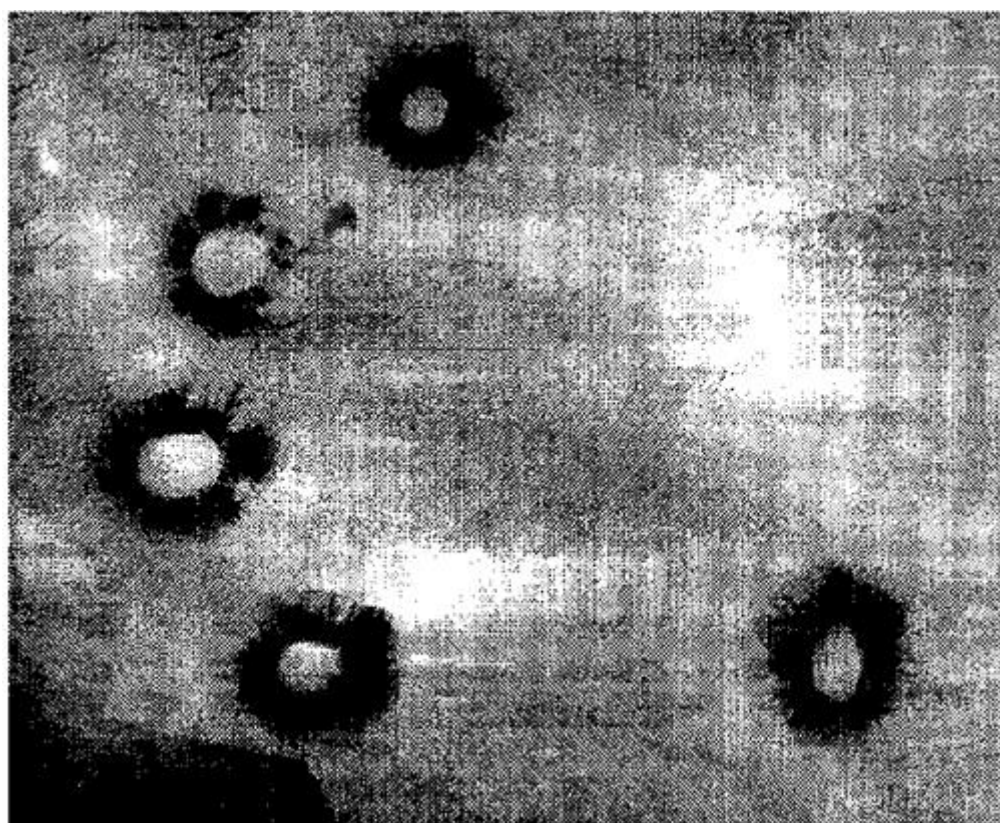

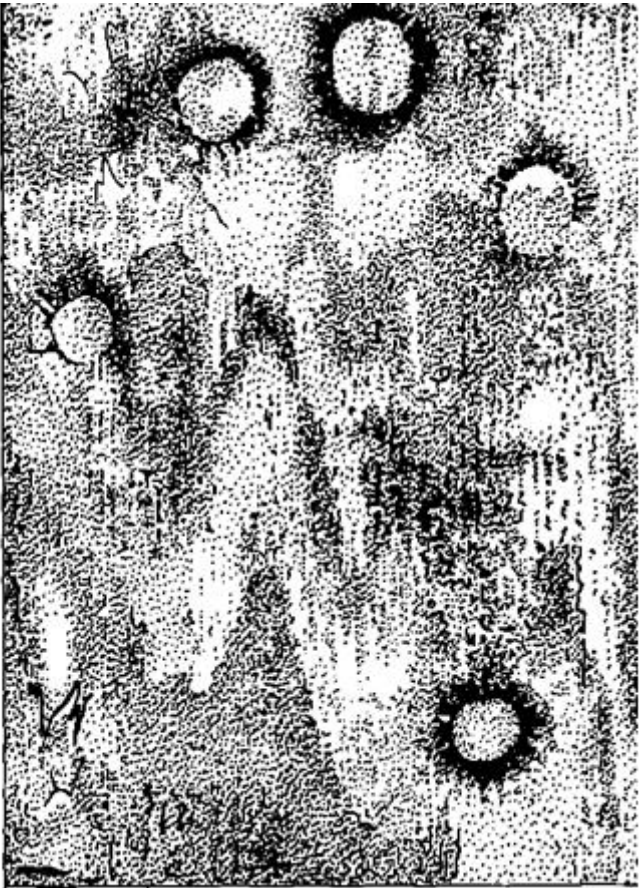

pu24

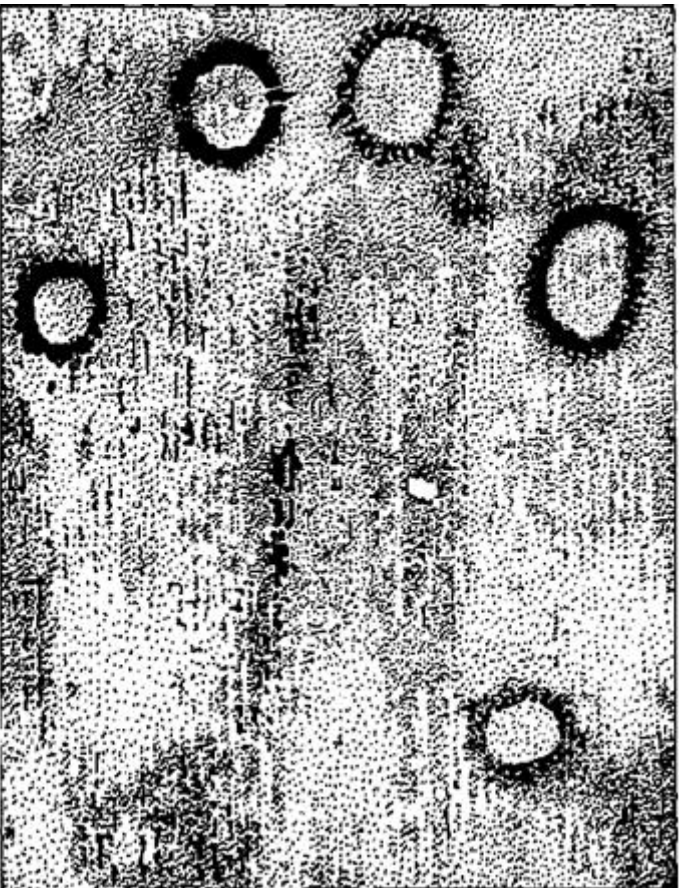

5