Hottinger Brüel & Kjaer GmbH
Im Tiefen See 45 · DE - 64293 Darmstadt
Tel. +49 / (0)6151 / 803-436 · E-Mail: DAkkScal@hbkworld.com

Akkreditiertes Kalibrierlaboratorium nach
Accredited calibration laboratory according to

DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Mitglied im
Member of

Deutschen Kalibrierdienst

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-K-12029-01-00

113511
D-K-12029-01-00
2023-05

Kalibrierzeichen
Calibration mark

Kalibrierschein
Calibration certificate

Gegenstand *Object*	**Messverstärker** *Measuring amplifier*
Hersteller *Manufacturer*	**Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, DE - Darmstadt**
Typ *Type*	**MX1615**
Serien-Nr. (Prüfmittel-Nr.) *Serial number* *(Test equiment no.)*	**0009E500405B**
Eigentümer *Owner*	**Tandm Technologies (Pty) Ltd.; ZA - 0081 Lynwood Pretoria**
Auftragsnummer *Order No.*	**440060392**
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines *Number of pages of the certificate*	**75**
Datum der Kalibrierung *Date of calibration*	**2023-05-08**

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).
Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the metrological traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).
The DAkkS is signatory to the mutual agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the multilateral recognition of calibration certificates.
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.

Stempel *Seal*	Datum *Date*	Stellv. Leiter des Kalibrierlaboratoriums *Deputy Head of the calibration laboratory*	Bearbeiter *Person in charge*
ISO 17025 D-K-12029-01-00 DKD	**2023-05-10**	**Wallner**	**Burma**

HBK classification: Confidential - External
Rev. 2.1.43

Kalibriernormale und Hilfsgeräte

calibration standards and accessory apparatus

Hersteller / Modell *manufacturer / model*	Seriennummer *serial number*	Kalibrierschein-Nr. *calibration certificate no.*	Kalibrierlabor *calibration lab*	Kal.datum *date of cal.*	Gültig bis *valid until*
HBM K148S31	0296	109874;110186;110059	D-K-12029-01-00	2022-12	2023-12
Burster 4462	268419	30534	D-K-15141-01-00	2022-12	2023-12
Keithley 2750	1008392	53820	D-K-15115-01-00	2022-12	2023-12
Burster 4530	470421	30535	D-K-15141-01-00	2022-11	2023-12

Messunsicherheit

measurement uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Diese wurde gemäß EA-4/02 M:2022 bestimmt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Werteintervall.


The uncertainties shown are the expanded uncertainties (k=2), which are calculated according to EA-4/02 M:2022. The results of the calibration are within a confidence level of 95%.

Konformitätsaussage

declaration of conformity

Die auf den nachfolgenden Seiten abgedruckten Ergebnisse bestätigen, dass der auf Seite 1 benannte Kalibriergegenstand die vom Hersteller veröffentlichten bzw. vertraglich vereinbarten Spezifikationen, welche im Rahmen der Kalibrierung geprüft wurden, einhält. Messwerte, für die diese Aussage gemäß DIN EN ISO 14253-1 eingeschränkt ist, sind nach VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 wie folgt gekennzeichnet:

The results on the following pages confirm that the instrument named on page 1 meets the specifications published by the manufacturer and/or agreed by contract that were tested within the scope of the calibration. Measured values with limitations according to DIN EN ISO 14253-1 are marked according to VDI/VDEDGQ/DKD 2622 as stated below:

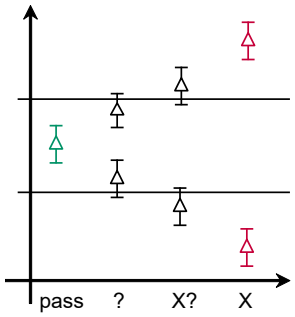

? Messwert liegt unter Berücksichtigung der Messunsicherheit mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% bis 95% innerhalb der Spezifikation. / *Taking into account the measurement uncertainty, the measured value is within the specification limits, with a probability between 50% and 95%.*

X? Messwert liegt unter Berücksichtigung der Messunsicherheit mit einer Wahrscheinlichkeit kleiner 50% innerhalb der Spezifikation. / *Taking into account the measurement uncertainty, the measured value is within specification limits, with a probability of less than 50%.*

X Messwert liegt außerhalb der Spezifikation. Darstellung der abs. Abweichung in Abschnitt Kalibrierergebnis ohne Angabe des Messunsicherheitsbalkens. / *The measured value is outside of the specification limits. Representation of the abs. deviation in section calibration result without specifying the measurement uncertainty bar.*

Eine ausführliche Erläuterung zum Thema Konformität finden Sie unter www.hbm.com/konformitaet.

For a detailed explanation of conformity, please visit www.hbm.com/conformity.

2016 von 2016 bewerteten Messpunkten erfüllen eindeutig die Konformitätsanforderungen

2016 out of 2016 rated measuring points clearly meet the declaration of conformity

Kalibrierverfahren
calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich der durch die eingesetzten Kalibriernormale und Hilfsgeräte dargestellten Werte mit dem jeweiligen Wert des Kalibriergegenstandes. Bezug ist die Realisierung der Einheit in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB). Die Kalibrierung erfolgt entsprechend der Arbeitsanweisung AA6550.28.
Die Kalibrierung erfolgt im Anlieferzustand (as found), relevante Informationen oder davon abweichende Bedingungen sind auf Seite 3 unter Sonstiges, bzw. Anzeigeranpassung dokumentiert.

The calibration is performed by comparing the known values of the calibration standards used with the respective value of the unit under test. Reference is the realization of units at the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). The unit was calibrated according to the operating procedure AA6550.28.
The calibration is carried out as found, relevant information or conditions deviating from this are documented on page 3 under Other data or Indicator adaption.

Gültigkeitsbereich
scope of application

Dieser Kalibrierschein ist nur für die angegebene Trägerfrequenz und Brückenspeisespannung gültig. Sollte das Gerät bei davon abweichender Trägerfrequenz oder Brückenspeisespannung eingesetzt werden, müssen die zugehörigen Kalibrierwerte durch eine gesonderte Kalibrierung bestimmt werden. Eine Aussage zur Langzeitstabilität des Kalibrierobjektes wird nicht getroffen.
This calibration certificate is only valid for both the carrier frequency and the bridge excitation voltage mentioned on the next page. If you intend to use the device at a different frequency or bridge excitation voltage, the appropriate calibration values have to be determined in a separate calibration. A statement about long-term stability of the calibration object is not made.

Ort der Kalibrierung
Location of calibration

Kalibrierbedingungen
calibration conditions

Umgebungstemperatur: Anfang / *Begin*: **(21,0 ± 1)** °C Ende / *End*: **(21,0 ± 1)** °C
ambient temperature

Umgebungsfeuchte: **(50 ± 2)** % rel.
environmental humidity

Kalibriergegenstand
calibration object

Kanal *channel*	Typ *type*	Anschlussart *type of conn.*	Seriennummer *serial number*	Hardw. Rev. *hardware rev.*	Firmware *firmware*	Kunden-ID *customer-ID*
1 - 16	MX1615	****	0009E500405B	1.71	4.40.10.0	****

Einstellungen
properties

Kanal *channel*	Autokalibrierung *auto calibration*	Nullabgleich *zero adjust / tare*	Anzeigeanpassung *adaptation value*
1 - 16	nein	nein	****

Angaben zu Vorrichtungen und Kabel
fixture and cable data

Bezeichnung (Identifikation) *name (identification)*	
Laboreig. Performance Test System	*Owned by the laboratory: Performance Test System*

Sonstiges
other data

Kalibrierung nach Justage / Reparatur.
Calibration after adjustment / repair (as left).

Kalibrierergebnis / *Calibration result*

Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±4 mV/V	**full bridge / Br. excit. Voltage 5V**	**1,2 kHz**	10 Hz Bes.	0,000 1 mV/V

zul. Lin.-Abw.: ±0,02 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,05 % * *value* + 0,05 % * *range*)
perm. abs. dev.

Kanal / *channel* 1

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,599 9	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* 2

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,599 9	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,599 9	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **5**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,599 9	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **7**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	-0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	-0,002		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	-0,002		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	-0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	-0,002		pass
1,6	1,600 2	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 2	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 2	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 2	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 1	0,000 30	-0,002		pass
-1	-1,000 0	-1,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	-0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	-0,002		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	-0,002		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **11**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 1	0,000 30	-0,002		pass
-1	-1,000 0	-1,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	-0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	-0,002		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	-0,002		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 1	0,000 30	-0,002		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 1	0,000 30	-0,002		pass
-1	-1,000 0	-1,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 2	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 2	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 2	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 1	0,000 30	-0,002		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 1	0,000 30	0,000		pass
-1	-1,000 0	-1,000 1	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,600 1	-1,600 2	0,000 30	-0,001		pass
-2	-2,000 1	-2,000 2	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 1	0,000 30	0,002		pass
0,8	0,800 1	0,800 1	0,000 30	0,002		pass
1	1,000 1	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 1	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-1,000 0	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 0	0,000 30	0,002		pass
-2	-2,000 1	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 2	1,600 1	0,000 30	0,002		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 1	0,000 30	-0,002		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*


Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±8 mV/V	**full bridge / Br. excit. Voltage 2,5V**	**1,2 kHz**	10 Hz Bes.	0,000 1 mV/V

zul. Lin.-Abw.: ±0,02 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,05 % * *value* + 0,05 % * *range*)
perm. abs. dev.


Kanal / *channel* 1

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 1	3,000 0	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 60	-0,001		pass
5	5,000 1	5,000 0	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 2	6,000 1	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 2	8,000 1	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 9	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 9	-4,000 0	0,000 60	0,000		pass
-5	-4,999 8	-4,999 9	0,000 60	0,001		pass
-6	-5,999 9	-6,000 0	0,001 2	0,000		pass
-8	-7,999 9	-8,000 0	0,001 2	0,000		pass

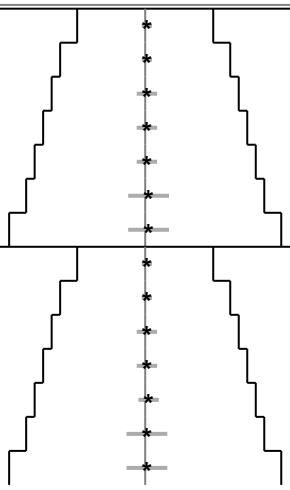


Kanal / *channel* 2

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 2	3,000 1	0,000 60	0,001		pass
4	4,000 2	4,000 1	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 1	5,000 0	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 2	6,000 1	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 2	8,000 1	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 9	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-5	-4,999 9	-5,000 0	0,000 60	0,001		pass
-6	-6,000 0	-6,000 1	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 1	0,001 2	0,000		pass

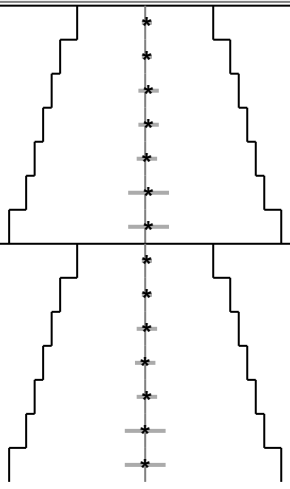


Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,001		pass
3	3,000 1	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 1	0,000 60	0,000		pass
5	5,000 1	5,000 1	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 1	6,000 1	0,001 2	-0,001		pass
8	8,000 2	8,000 2	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 0	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 1	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 1	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

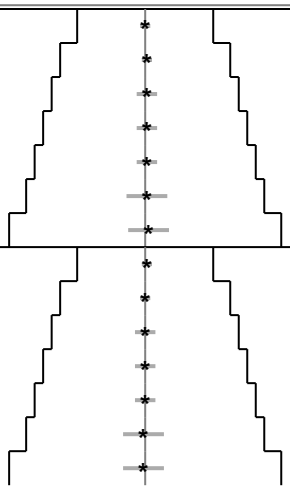


Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	1,999 9	0,000 30	-0,001		pass
3	3,000 1	3,000 0	0,000 60	0,001		pass
4	4,000 0	3,999 9	0,000 60	0,000		pass
5	4,999 9	4,999 8	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 0	5,999 9	0,001 2	0,001		pass
8	7,999 9	7,999 8	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	-0,001		pass
-3	-2,999 8	-2,999 9	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 8	-3,999 9	0,000 60	0,000		pass
-5	-4,999 7	-4,999 8	0,000 60	0,001		pass
-6	-5,999 8	-5,999 9	0,001 2	-0,001		pass
-8	-7,999 7	-7,999 8	0,001 2	0,000		pass

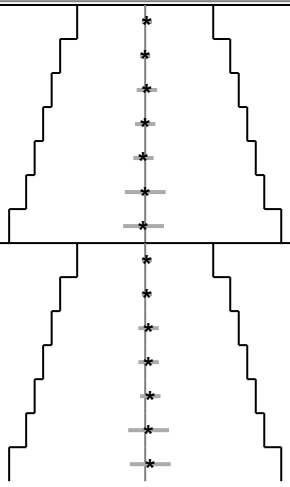


Kanal / *channel* **5**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 1	3,000 0	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 2	4,000 1	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 1	5,000 0	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 1	6,000 0	0,001 2	-0,001		pass
8	8,000 2	8,000 1	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 0	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 0	-6,000 1	0,001 2	0,001		pass
-8	-8,000 1	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass



Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 1	3,000 0	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 0	4,999 9	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 0	5,999 9	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 0	7,999 9	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 9	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 8	-3,999 9	0,000 60	0,001		pass
-5	-4,999 8	-4,999 9	0,000 60	0,000		pass
-6	-5,999 8	-5,999 9	0,001 2	0,000		pass
-8	-7,999 8	-7,999 9	0,001 2	0,000		pass



Kanal / *channel* **7**


Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	-0,001		pass
3	3,000 2	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 2	4,000 1	0,000 60	0,000		pass
5	5,000 2	5,000 1	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 2	6,000 1	0,001 2	-0,001		pass
8	8,000 3	8,000 2	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 0	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 1	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 1	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 1	3,000 0	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 60	-0,001		pass
5	5,000 1	5,000 0	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 2	6,000 1	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 2	8,000 1	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-4	-3,999 9	-4,000 0	0,000 60	0,001		pass
-5	-4,999 9	-5,000 0	0,000 60	0,001		pass
-6	-6,000 0	-6,000 1	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 1	0,001 2	0,000		pass


Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 2	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 3	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 2	5,000 1	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 3	6,000 2	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 4	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 0	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 1	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 1	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

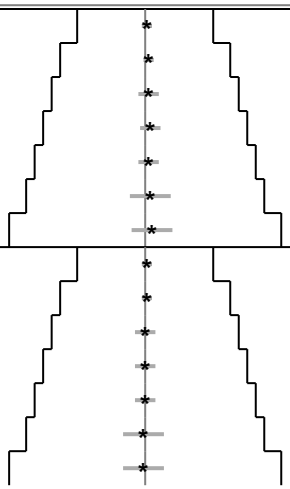

Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,001		pass
3	3,000 1	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 2	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 1	5,000 1	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 2	6,000 2	0,001 2	0,001		pass
8	8,000 2	8,000 2	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-5	-5,000 0	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 0	-6,000 1	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 1	0,001 2	0,000		pass

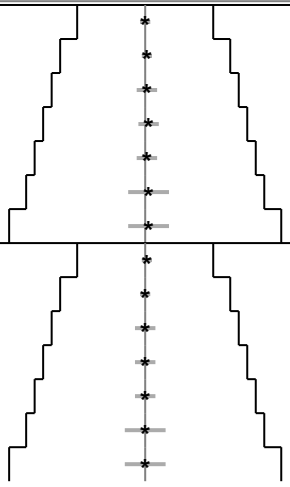

Kanal / *channel* **11**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,001		pass
3	3,000 1	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 1	0,000 60	0,000		pass
5	5,000 1	5,000 1	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 1	6,000 1	0,001 2	-0,001		pass
8	8,000 2	8,000 2	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-5	-5,000 0	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 0	-6,000 1	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 1	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 2	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 3	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 2	5,000 1	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 3	6,000 2	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 4	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass
-3	-3,000 0	-3,000 2	0,000 60	-0,001		pass
-4	-4,000 0	-4,000 2	0,000 60	-0,001		pass
-5	-5,000 0	-5,000 2	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 0	-6,000 2	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 1	-8,000 3	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 2	3,000 2	0,000 60	0,001		pass
4	4,000 2	4,000 2	0,000 60	0,000		pass
5	5,000 2	5,000 2	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 3	6,000 3	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 4	8,000 4	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 0	0,000 30	0,001		pass
-3	-3,000 1	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 1	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 1	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 2	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 2	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 1	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 1	0,000 60	-0,001		pass
5	5,000 1	5,000 1	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 2	6,000 2	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 3	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 1	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 1	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 1	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 1	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 2	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 2	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 1	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 2	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 2	5,000 2	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 3	6,000 3	0,001 2	0,001		pass
8	8,000 3	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 0	0,000 30	0,001		pass
-3	-3,000 1	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 1	-4,000 1	0,000 60	0,001		pass
-5	-5,000 1	-5,000 1	0,000 60	0,001		pass
-6	-6,000 1	-6,000 1	0,001 2	0,002		pass
-8	-8,000 3	-8,000 3	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 2	3,000 1	0,000 60	-0,001		pass
4	4,000 4	4,000 3	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 2	5,000 1	0,000 60	-0,002		pass
6	6,000 4	6,000 3	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 5	8,000 4	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 2	0,000 30	-0,002		pass
-3	-3,000 0	-3,000 2	0,000 60	-0,001		pass
-4	-3,999 9	-4,000 1	0,000 60	0,001		pass
-5	-5,000 1	-5,000 3	0,000 60	-0,001		pass
-6	-5,999 9	-6,000 1	0,001 2	0,002		pass
-8	-8,000 1	-8,000 3	0,001 2	0,000		pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*


Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±20 mV/V	**full bridge / Br. excit. Voltage 1V**	**1,2 kHz**	10 Hz Bes.	0,000 1 mV/V

zul. Lin.-Abw.: ±0,02 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,05 % * *value* + 0,05 % * *range*)
perm. abs. dev.


Kanal / *channel* 1

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 0	3,999 9	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 0	7,999 9	0,001 0	0,000		pass
10	9,999 8	9,999 7	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 8	11,999 7	0,001 5	0,000		pass
16	15,999 8	15,999 7	0,001 7	0,000		pass
20	19,999 7	19,999 6	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 8	-3,999 8	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 8	-7,999 8	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 6	-9,999 6	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 6	-11,999 6	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 4	-15,999 4	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 2	-19,999 2	0,002 1	0,000		pass

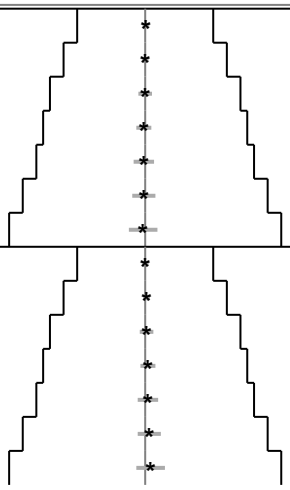

Kanal / *channel* 2

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 3	8,000 2	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 0	9,999 9	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 1	12,000 0	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 2	16,000 1	0,001 7	0,001		pass
20	20,000 0	19,999 9	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 8	-4,000 0	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 9	-8,000 1	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 8	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 9	-12,000 1	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 9	-16,000 1	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 8	-20,000 0	0,002 1	0,000		pass

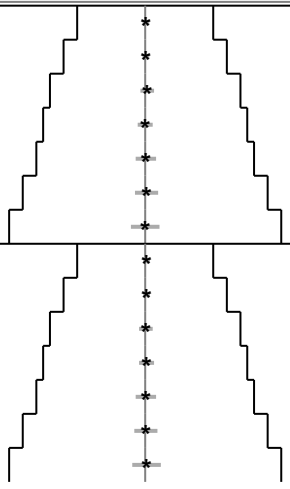

Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 9	3,999 9	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 1	8,000 1	0,001 0	0,000		pass
10	10,000 0	10,000 0	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 0	12,000 0	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 1	16,000 1	0,001 7	0,000		pass
20	20,000 0	20,000 0	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 0	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 0	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 9	-9,999 9	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 9	-11,999 9	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 8	-15,999 8	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 7	-19,999 7	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 0	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 0	8,000 0	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 9	9,999 9	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 9	11,999 9	0,001 5	0,000		pass
16	15,999 8	15,999 8	0,001 7	0,000		pass
20	19,999 7	19,999 7	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 8	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 8	-7,999 9	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 6	-9,999 7	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 6	-11,999 7	0,001 5	-0,001		pass
-16	-15,999 4	-15,999 5	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 2	-19,999 3	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **5**


Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 0	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 1	8,000 1	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 9	9,999 9	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 0	12,000 0	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 0	16,000 0	0,001 7	0,000		pass
20	19,999 9	19,999 9	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 8	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 8	-7,999 9	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 7	-9,999 8	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 6	-11,999 7	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 6	-15,999 7	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 4	-19,999 5	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 9	3,999 9	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 0	8,000 0	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 8	9,999 8	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 8	11,999 8	0,001 5	0,000		pass
16	15,999 8	15,999 8	0,001 7	0,001		pass
20	19,999 6	19,999 6	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 9	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 8	-7,999 8	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 7	-9,999 7	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 7	-11,999 7	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 6	-15,999 6	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 5	-19,999 5	0,002 1	0,000		pass


Kanal / *channel* **7**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 9	3,999 9	0,000 50	0,000		pass
8	7,999 9	7,999 9	0,001 0	0,000		pass
10	9,999 7	9,999 7	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 7	11,999 7	0,001 5	0,000		pass
16	15,999 8	15,999 8	0,001 7	0,001		pass
20	19,999 6	19,999 6	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 9	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 9	-7,999 9	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 7	-9,999 7	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 8	-11,999 8	0,001 5	-0,001		pass
-16	-15,999 6	-15,999 6	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 4	-19,999 4	0,002 1	0,000		pass




Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 3	8,000 2	0,001 0	0,000		pass
10	10,000 2	10,000 1	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 4	12,000 3	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 5	16,000 4	0,001 7	0,000		pass
20	20,000 5	20,000 4	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 2	-8,000 3	0,001 0	-0,001		pass
-10	-10,000 1	-10,000 2	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 2	-12,000 3	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,000 3	-16,000 4	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,000 3	-20,000 4	0,002 1	0,000		pass




Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 3	8,000 2	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 2	10,000 1	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 3	12,000 2	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 4	16,000 3	0,001 7	0,001		pass
20	20,000 3	20,000 2	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 9	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 8	-8,000 0	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 8	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 9	-12,000 1	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 8	-16,000 0	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 8	-20,000 0	0,002 1	0,000		pass



Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 2	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 4	8,000 2	0,001 0	0,000		pass
10	10,000 3	10,000 1	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 5	12,000 3	0,001 5	0,001		pass
16	16,000 6	16,000 4	0,001 7	0,001		pass
20	20,000 5	20,000 3	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 8	-3,999 9	0,000 50	0,001		pass
-8	-8,000 1	-8,000 2	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 9	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 0	-12,000 1	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,000 0	-16,000 1	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,000 0	-20,000 1	0,002 1	0,000		pass

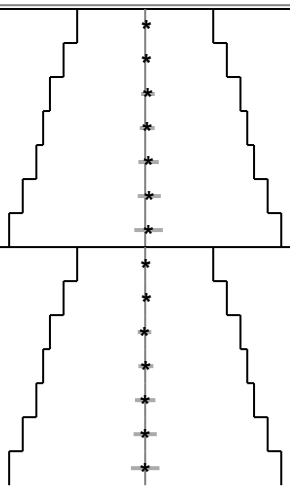

Kanal / *channel* **11**


Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 8	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	7,999 8	8,000 0	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 6	9,999 8	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 7	11,999 9	0,001 5	0,000		pass
16	15,999 8	16,000 0	0,001 7	0,001		pass
20	19,999 5	19,999 7	0,002 1	0,000		pass
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 1	-4,000 0	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 1	-8,000 0	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 9	-9,999 8	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 0	-11,999 9	0,001 5	-0,001		pass
-16	-15,999 9	-15,999 8	0,001 7	-0,001		pass
-20	-19,999 7	-19,999 6	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 2	8,000 1	0,001 0	0,000		pass
10	10,000 1	10,000 0	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 2	12,000 1	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 4	16,000 3	0,001 7	0,001		pass
20	20,000 2	20,000 1	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 9	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 2	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 8	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 8	-12,000 0	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 9	-16,000 1	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 8	-20,000 0	0,002 1	0,000		pass


Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 0	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 3	8,000 3	0,001 0	0,000		pass
10	10,000 2	10,000 2	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 2	12,000 2	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 4	16,000 4	0,001 7	0,000		pass
20	20,000 5	20,000 5	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 1	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 1	-8,000 1	0,001 0	0,000		pass
-10	-10,000 1	-10,000 1	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 2	-12,000 2	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,000 2	-16,000 2	0,001 7	0,001		pass
-20	-20,000 4	-20,000 4	0,002 1	0,000		pass



Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 2	4,000 1	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 5	8,000 4	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 3	10,000 2	0,001 1	-0,001		pass
12	12,000 7	12,000 6	0,001 5	0,001		pass
16	16,000 8	16,000 7	0,001 7	0,001		pass
20	20,000 8	20,000 7	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 2	-8,000 3	0,001 0	0,000		pass
-10	-10,000 1	-10,000 2	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 2	-12,000 3	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,000 3	-16,000 4	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,000 4	-20,000 5	0,002 1	0,000		pass



Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 50	-0,001		pass
8	8,000 4	8,000 3	0,001 0	0,000		pass
10	10,000 4	10,000 3	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 6	12,000 5	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 8	16,000 7	0,001 7	0,000		pass
20	20,000 9	20,000 8	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 3	-8,000 4	0,001 0	-0,001		pass
-10	-10,000 2	-10,000 3	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 4	-12,000 5	0,001 5	-0,001		pass
-16	-16,000 4	-16,000 5	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,000 5	-20,000 6	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 8	4,000 0	0,000 51	0,000		pass
8	8,000 3	8,000 5	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 1	10,000 3	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 0	12,000 2	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 5	16,000 7	0,001 7	0,001		pass
20	20,000 3	20,000 5	0,002 1	0,000		pass
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 1	-3,999 9	0,000 51	0,001		pass
-8	-8,000 6	-8,000 4	0,001 0	-0,001		pass
-10	-10,000 4	-10,000 2	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 4	-12,000 2	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,000 8	-16,000 6	0,001 7	-0,001		pass
-20	-20,000 6	-20,000 4	0,002 1	0,000		pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*

Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±4 mV/V	**full bridge / Br. excit. Voltage 5V**	**DC**	10 Hz Bes.	0,000 1 mV/V

zul. Lin.-Abw.: ±0,02 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,1 % * *value* + 0,1 % * *range*)
perm. abs. dev.

Kanal / *channel* 1

Messwerte *y* / *measured values y* | Spezifikation / *specification*

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 1	0,000 30	0,002		pass
0,8	0,800 1	0,800 1	0,000 30	0,002		pass
1	1,000 1	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 1	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-1,000 0	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 0	0,000 30	0,002		pass
-2	-2,000 1	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* 2

Messwerte *y* / *measured values y* | Spezifikation / *specification*

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 0	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 0	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 0	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 0	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 0	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-1,000 0	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,399 9	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 0	0,800 1	0,000 30	0,002		pass
1	1,000 0	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 0	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 0	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 1	-0,400 1	0,000 30	-0,002		pass
-0,8	-0,800 1	-0,800 1	0,000 30	-0,002		pass
-1	-1,000 0	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 1	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,600 1	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 1	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,399 8	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,799 8	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	0,999 8	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,199 8	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,599 8	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	1,999 8	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 2	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 2	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-1,000 2	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,200 2	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,600 2	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 2	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **5**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 1	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 1	1,000 0	0,000 30	-0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 0	0,000 30	-0,002		pass
1,6	1,600 1	1,600 0	0,000 30	-0,002		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 9	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 9	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-0,999 9	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,599 9	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 7	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,399 3	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,799 3	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	0,999 3	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,199 3	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,599 3	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	1,999 3	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	-0,000 7	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 7	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 7	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-1,000 7	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 7	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 7	-1,600 0	0,000 30	0,002		pass
-2	-2,000 8	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **7**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 1	0,000 30	0,002		pass
0,8	0,800 1	0,800 1	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 1	1,000 1	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 1	1,200 1	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 2	1,600 2	0,000 30	0,001		pass
2	2,000 2	2,000 2	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 1	0,000 30	-0,002		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 1	0,000 30	0,000		pass
-1	-1,000 0	-1,000 1	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,200 1	-1,200 2	0,000 30	-0,002		pass
-1,6	-1,600 1	-1,600 2	0,000 30	-0,001		pass
-2	-2,000 1	-2,000 2	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,399 9	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,799 9	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 0	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 0	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 0	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 1	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 1	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-1,000 1	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,200 1	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,600 1	-1,600 0	0,000 30	0,002		pass
-2	-2,000 2	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 1	0,400 1	0,000 30	0,002		pass
0,8	0,800 1	0,800 1	0,000 30	0,002		pass
1	1,000 1	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 1	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 1	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 1	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 1	0,000 30	-0,002		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 1	0,000 30	0,000		pass
-1	-1,000 0	-1,000 1	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 1	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 1	0,000 30	0,002		pass
-2	-2,000 1	-2,000 2	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 2	0,400 1	0,000 30	0,002		pass
0,8	0,800 2	0,800 1	0,000 30	0,002		pass
1	1,000 2	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 2	1,200 1	0,000 30	0,001		pass
1,6	1,600 2	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 8	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 8	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,2	-1,199 8	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,599 9	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **11**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 4	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 4	0,400 0	0,000 30	-0,001		pass
0,8	0,800 5	0,800 1	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 5	1,000 1	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 5	1,200 1	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 5	1,600 1	0,000 30	-0,002		pass
2	2,000 6	2,000 2	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 5	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 5	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 5	-1,000 0	0,000 30	0,001		pass
-1,2	-1,199 5	-1,200 0	0,000 30	0,002		pass
-1,6	-1,599 6	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 6	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 0	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 0	0,800 0	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 0	1,000 0	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 0	1,200 0	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 0	1,600 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,400 0	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,800 0	-0,800 0	0,000 30	0,000		pass
-1	-1,000 0	-1,000 0	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,200 0	-1,200 0	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,600 0	-1,600 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 2	0,400 0	0,000 30	0,000		pass
0,8	0,800 2	0,800 0	0,000 30	-0,001		pass
1	1,000 3	1,000 1	0,000 30	0,001		pass
1,2	1,200 2	1,200 0	0,000 30	-0,002		pass
1,6	1,600 3	1,600 1	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 3	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 8	-0,400 0	0,000 30	0,000		pass
-0,8	-0,799 8	-0,800 0	0,000 30	0,001		pass
-1	-0,999 9	-1,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,2	-1,199 9	-1,200 1	0,000 30	-0,001		pass
-1,6	-1,599 9	-1,600 1	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 4	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
0,4	0,400 5	0,400 1	0,000 30	0,002		pass
0,8	0,800 5	0,800 1	0,000 30	0,000		pass
1	1,000 5	1,000 1	0,000 30	0,000		pass
1,2	1,200 5	1,200 1	0,000 30	0,000		pass
1,6	1,600 5	1,600 1	0,000 30	-0,002		pass
2	2,000 6	2,000 2	0,000 30	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-0,4	-0,399 6	-0,400 1	0,000 30	-0,002		pass
-0,8	-0,799 6	-0,800 1	0,000 30	0,000		pass
-1	-0,999 6	-1,000 1	0,000 30	0,000		pass
-1,2	-1,199 6	-1,200 1	0,000 30	0,000		pass
-1,6	-1,599 6	-1,600 1	0,000 30	0,002		pass
-2	-1,999 7	-2,000 2	0,000 30	0,000		pass

Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000	*	pass
0,4	0,399 7	0,400 0	0,000 30	0,000	*	pass
0,8	0,799 7	0,800 0	0,000 30	-0,001	*	pass
1	0,999 8	1,000 1	0,000 30	0,001	*	pass
1,2	1,199 8	1,200 1	0,000 30	0,001	*	pass
1,6	1,599 8	1,600 1	0,000 30	0,000	*	pass
2	1,999 8	2,000 1	0,000 30	0,000	*	pass
0	-0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000	*	pass
-0,4	-0,400 3	-0,400 0	0,000 30	0,000	*	pass
-0,8	-0,800 3	-0,800 0	0,000 30	0,000	*	pass
-1	-1,000 3	-1,000 0	0,000 30	0,000	*	pass
-1,2	-1,200 3	-1,200 0	0,000 30	0,000	*	pass
-1,6	-1,600 3	-1,600 0	0,000 30	0,000	*	pass
-2	-2,000 3	-2,000 0	0,000 30	0,000	*	pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 9	0,000 0	0,000 30	0,000	*	pass
0,4	0,400 9	0,400 0	0,000 30	0,000	*	pass
0,8	0,801 0	0,800 1	0,000 30	0,002	*	pass
1	1,001 0	1,000 1	0,000 30	0,001	*	pass
1,2	1,201 0	1,200 1	0,000 30	0,001	*	pass
1,6	1,601 0	1,600 1	0,000 30	0,000	*	pass
2	2,001 0	2,000 1	0,000 30	0,000	*	pass
0	0,000 9	0,000 0	0,000 30	0,000	*	pass
-0,4	-0,399 1	-0,400 0	0,000 30	0,000	*	pass
-0,8	-0,799 1	-0,800 0	0,000 30	0,000	*	pass
-1	-0,999 1	-1,000 0	0,000 30	0,000	*	pass
-1,2	-1,199 1	-1,200 0	0,000 30	0,000	*	pass
-1,6	-1,599 1	-1,600 0	0,000 30	0,000	*	pass
-2	-1,999 1	-2,000 0	0,000 30	0,000	*	pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*


Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±8 mV/V	**full bridge / Br. excit. Voltage 2,5V**	**DC**	10 Hz Bes.	0,000 1 mV/V

zul. Lin.-Abw.: ±0,02 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,1 % * *value* + 0,1 % * *range*)
perm. abs. dev.


Kanal / *channel* 1

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	2,000 1	0,000 30	0,001		pass
3	3,000 0	3,000 1	0,000 60	0,001		pass
4	4,000 1	4,000 2	0,000 60	0,002		pass
5	4,999 9	5,000 0	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 0	6,000 1	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 0	8,000 1	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-5	-4,999 9	-5,000 0	0,000 60	0,001		pass
-6	-6,000 0	-6,000 1	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 1	0,001 2	0,000		pass

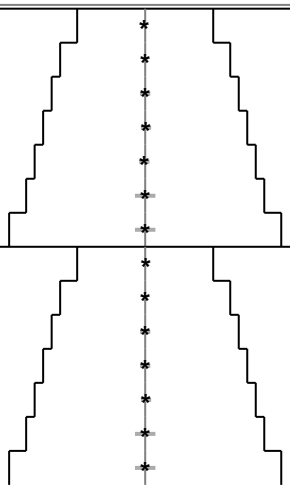

Kanal / *channel* 2

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 1	3,000 1	0,000 60	0,001		pass
4	4,000 1	4,000 1	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 0	5,000 0	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 0	6,000 0	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 0	8,000 0	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 9	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 9	-4,000 0	0,000 60	0,000		pass
-5	-4,999 9	-5,000 0	0,000 60	0,000		pass
-6	-5,999 9	-6,000 0	0,001 2	0,000		pass
-8	-7,999 9	-8,000 0	0,001 2	0,000		pass

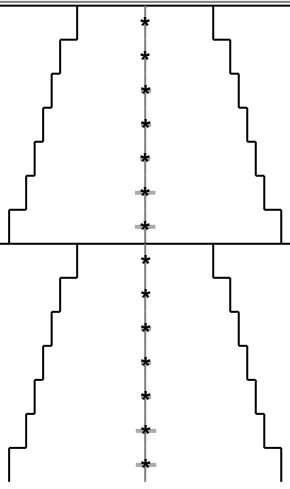

Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	1,999 8	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	2,999 9	3,000 2	0,000 60	0,001		pass
4	3,999 9	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	4,999 8	5,000 1	0,000 60	-0,001		pass
6	5,999 9	6,000 2	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 0	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 1	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass
-3	-3,000 2	-3,000 2	0,000 60	-0,001		pass
-4	-4,000 2	-4,000 2	0,000 60	-0,001		pass
-5	-5,000 2	-5,000 2	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 2	-6,000 2	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 3	-8,000 3	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	1,999 7	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	2,999 7	3,000 0	0,000 60	0,000		pass
4	3,999 8	4,000 1	0,000 60	0,001		pass
5	4,999 7	5,000 0	0,000 60	0,000		pass
6	5,999 7	6,000 0	0,001 2	0,000		pass
8	7,999 7	8,000 0	0,001 2	0,000		pass
0	-0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 3	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-3,000 3	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 3	-4,000 0	0,000 60	-0,001		pass
-5	-5,000 2	-4,999 9	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 3	-6,000 0	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 2	-7,999 9	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **5**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 3	3,000 2	0,000 60	0,001		pass
4	4,000 3	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 3	5,000 2	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 3	6,000 2	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 4	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 8	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-2,999 8	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 8	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-4,999 8	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-5,999 9	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-7,999 9	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,001 5	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	1,998 6	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	2,998 7	3,000 2	0,000 60	0,001		pass
4	3,998 7	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	4,998 7	5,000 2	0,000 60	0,000		pass
6	5,998 7	6,000 2	0,001 2	0,000		pass
8	7,998 8	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	-0,001 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,001 3	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-3,001 3	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,001 4	-4,000 1	0,000 60	-0,001		pass
-5	-5,001 3	-5,000 0	0,000 60	0,001		pass
-6	-6,001 4	-6,000 1	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,001 4	-8,000 1	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **7**


Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
3	3,000 3	3,000 2	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 4	4,000 3	0,000 60	0,000		pass
5	5,000 4	5,000 3	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 5	6,000 4	0,001 2	-0,001		pass
8	8,000 7	8,000 6	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass
-3	-3,000 1	-3,000 2	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 2	-4,000 3	0,000 60	-0,001		pass
-5	-5,000 2	-5,000 3	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 3	-6,000 4	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 4	-8,000 5	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	1,999 8	2,000 0	0,000 30	-0,001		pass
3	2,999 9	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	3,999 9	4,000 1	0,000 60	0,000		pass
5	4,999 9	5,000 1	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 0	6,000 2	0,001 2	0,001		pass
8	8,000 0	8,000 2	0,001 2	0,000		pass
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 2	-2,000 0	0,000 30	0,001		pass
-3	-3,000 2	-3,000 0	0,000 60	0,001		pass
-4	-4,000 2	-4,000 0	0,000 60	0,001		pass
-5	-5,000 2	-5,000 0	0,000 60	0,002		pass
-6	-6,000 3	-6,000 1	0,001 2	0,001		pass
-8	-8,000 4	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass


Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 2	2,000 1	0,000 30	0,001		pass
3	3,000 2	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 3	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 2	5,000 1	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 3	6,000 2	0,001 2	0,001		pass
8	8,000 3	8,000 2	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 9	-2,000 0	0,000 30	0,001		pass
-3	-2,999 9	-3,000 0	0,000 60	0,001		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-4,999 9	-5,000 0	0,000 60	0,002		pass
-6	-6,000 0	-6,000 1	0,001 2	0,001		pass
-8	-8,000 1	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass



Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 4	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 4	3,000 1	0,000 60	-0,001		pass
4	4,000 5	4,000 2	0,000 60	0,000		pass
5	5,000 5	5,000 2	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 6	6,000 3	0,001 2	0,000		pass
8	8,000 7	8,000 4	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 4	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 7	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 8	-3,000 2	0,000 60	-0,001		pass
-4	-3,999 8	-4,000 2	0,000 60	0,000		pass
-5	-4,999 8	-5,000 2	0,000 60	0,001		pass
-6	-5,999 9	-6,000 3	0,001 2	0,000		pass
-8	-8,000 0	-8,000 4	0,001 2	0,000		pass



Kanal / *channel* **11**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 9	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 9	2,000 0	0,000 30	0,000		pass
3	3,001 0	3,000 1	0,000 60	0,001		pass
4	4,001 0	4,000 1	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 9	5,000 0	0,000 60	-0,001		pass
6	6,000 9	6,000 0	0,001 2	-0,001		pass
8	8,001 0	8,000 1	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 9	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 1	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 1	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 1	-4,000 0	0,000 60	0,000		pass
-5	-4,999 0	-4,999 9	0,000 60	0,001		pass
-6	-5,999 1	-6,000 0	0,001 2	0,000		pass
-8	-7,999 1	-8,000 0	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 0	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,000 0	3,000 1	0,000 60	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 1	5,000 2	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 2	6,000 3	0,001 2	0,001		pass
8	8,000 2	8,000 3	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 0	-2,000 1	0,000 30	-0,001		pass
-3	-3,000 0	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 0	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 0	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 1	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 1	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,000 4	2,000 1	0,000 30	0,001		pass
3	3,000 5	3,000 2	0,000 60	0,002		pass
4	4,000 5	4,000 2	0,000 60	0,001		pass
5	5,000 4	5,000 1	0,000 60	0,000		pass
6	6,000 5	6,000 2	0,001 2	0,001		pass
8	8,000 5	8,000 2	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 3	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 7	-2,000 0	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 7	-3,000 0	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 7	-4,000 0	0,000 60	0,001		pass
-5	-4,999 7	-5,000 0	0,000 60	0,001		pass
-6	-5,999 8	-6,000 1	0,001 2	0,000		pass
-8	-7,999 8	-8,000 1	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 9	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,001 0	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	3,001 1	3,000 2	0,000 60	0,001		pass
4	4,001 1	4,000 2	0,000 60	0,000		pass
5	5,001 1	5,000 2	0,000 60	-0,001		pass
6	6,001 2	6,000 3	0,001 2	0,000		pass
8	8,001 3	8,000 4	0,001 2	0,000		pass
0	0,000 9	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,999 2	-2,000 1	0,000 30	0,000		pass
-3	-2,999 2	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,999 2	-4,000 1	0,000 60	0,001		pass
-5	-4,999 2	-5,000 1	0,000 60	0,001		pass
-6	-5,999 3	-6,000 2	0,001 2	0,000		pass
-8	-7,999 4	-8,000 3	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 7	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	1,999 4	2,000 1	0,000 30	0,000		pass
3	2,999 4	3,000 1	0,000 60	-0,001		pass
4	3,999 6	4,000 3	0,000 60	0,001		pass
5	4,999 6	5,000 3	0,000 60	0,001		pass
6	5,999 6	6,000 3	0,001 2	0,000		pass
8	7,999 7	8,000 4	0,001 2	0,000		pass
0	-0,000 6	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-2,000 6	-2,000 0	0,000 30	0,001		pass
-3	-3,000 7	-3,000 1	0,000 60	0,000		pass
-4	-4,000 7	-4,000 1	0,000 60	0,000		pass
-5	-5,000 7	-5,000 1	0,000 60	0,000		pass
-6	-6,000 8	-6,000 2	0,001 2	-0,001		pass
-8	-8,000 8	-8,000 2	0,001 2	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,001 9	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
2	2,002 1	2,000 2	0,000 30	0,001		pass
3	3,002 2	3,000 3	0,000 60	0,001		pass
4	4,002 2	4,000 3	0,000 60	0,000		pass
5	5,002 3	5,000 4	0,000 60	0,000		pass
6	6,002 4	6,000 5	0,001 2	0,001		pass
8	8,002 5	8,000 6	0,001 2	0,000		pass
0	0,002 0	0,000 0	0,000 30	0,000		pass
-2	-1,998 1	-2,000 1	0,000 30	0,001		pass
-3	-2,998 2	-3,000 2	0,000 60	0,000		pass
-4	-3,998 2	-4,000 2	0,000 60	0,001		pass
-5	-4,998 3	-5,000 3	0,000 60	0,001		pass
-6	-5,998 4	-6,000 4	0,001 2	0,001		pass
-8	-7,998 6	-8,000 6	0,001 2	0,000		pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*

Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±20 mV/V	**full bridge / Br. excit. Voltage 1V**	**DC**	10 Hz Bes.	0,000 1 mV/V

zul. Lin.-Abw.: ±0,02 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,1 % * *value* + 0,1 % * *range*)
perm. abs. dev.

Kanal / *channel* 1


Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 4	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 6	4,000 0	0,000 50	0,001		pass
8	7,999 4	7,999 8	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 3	9,999 7	0,001 1	0,001		pass
12	11,999 2	11,999 6	0,001 5	0,001		pass
16	15,999 0	15,999 4	0,001 7	0,001		pass
20	19,998 7	19,999 1	0,002 1	0,000		pass
0	-0,000 3	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 0	-3,999 7	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 9	-7,999 6	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 7	-9,999 4	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 7	-11,999 4	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 5	-15,999 2	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 2	-19,998 9	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* 2

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 8	3,999 9	0,000 50	0,000		pass
8	7,999 8	7,999 9	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 5	9,999 6	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 5	11,999 6	0,001 5	0,000		pass
16	15,999 4	15,999 5	0,001 7	0,001		pass
20	19,999 1	19,999 2	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 7	-3,999 8	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 7	-7,999 8	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 5	-9,999 6	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 4	-11,999 5	0,001 5	-0,001		pass
-16	-15,999 3	-15,999 4	0,001 7	-0,001		pass
-20	-19,998 9	-19,999 0	0,002 1	0,000		pass


Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 5	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 5	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	7,999 6	8,000 1	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 3	9,999 8	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 4	11,999 9	0,001 5	0,001		pass
16	15,999 4	15,999 9	0,001 7	0,001		pass
20	19,999 1	19,999 6	0,002 1	0,000		pass
0	-0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 2	-4,000 1	0,000 50	-0,001		pass
-8	-8,000 2	-8,000 1	0,001 0	-0,001		pass
-10	-10,000 1	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 1	-12,000 0	0,001 5	-0,001		pass
-16	-16,000 0	-15,999 9	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 9	-19,999 8	0,002 1	0,000		pass



Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,001 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 0	4,000 0	0,000 50	0,001		pass
8	7,999 0	8,000 0	0,001 0	0,001		pass
10	9,998 7	9,999 7	0,001 1	0,000		pass
12	11,998 8	11,999 8	0,001 5	0,001		pass
16	15,998 7	15,999 7	0,001 7	0,001		pass
20	19,998 4	19,999 4	0,002 1	0,000		pass
0	-0,000 8	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 7	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 6	-7,999 8	0,001 0	0,000		pass
-10	-10,000 4	-9,999 6	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 5	-11,999 7	0,001 5	-0,001		pass
-16	-16,000 3	-15,999 5	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,000 1	-19,999 3	0,002 1	0,000		pass



Kanal / *channel* **5**


Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 3	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 4	4,000 1	0,000 50	0,001		pass
8	8,000 3	8,000 0	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 1	9,999 8	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 2	11,999 9	0,001 5	0,001		pass
16	16,000 1	15,999 8	0,001 7	0,001		pass
20	19,999 9	19,999 6	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 4	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 4	-7,999 9	0,001 0	-0,001		pass
-10	-9,999 2	-9,999 7	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 3	-11,999 8	0,001 5	-0,001		pass
-16	-15,999 2	-15,999 7	0,001 7	-0,001		pass
-20	-19,999 0	-19,999 5	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,003 8	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,996 3	4,000 1	0,000 50	0,000		pass
8	7,996 4	8,000 2	0,001 0	0,001		pass
10	9,996 2	10,000 0	0,001 1	0,000		pass
12	11,996 4	12,000 2	0,001 5	0,001		pass
16	15,996 3	16,000 1	0,001 7	0,000		pass
20	19,996 2	20,000 0	0,002 1	0,000		pass
0	-0,003 4	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,003 5	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,003 5	-8,000 1	0,001 0	-0,001		pass
-10	-10,003 3	-9,999 9	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,003 4	-12,000 0	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,003 4	-16,000 0	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,003 4	-20,000 0	0,002 1	0,000		pass


Kanal / *channel* **7**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 1	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 4	8,000 3	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 3	10,000 2	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 3	12,000 2	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 4	16,000 3	0,001 7	0,001		pass
20	20,000 3	20,000 2	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 8	-4,000 0	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 9	-8,000 1	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 8	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 9	-12,000 1	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 9	-16,000 1	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 9	-20,000 1	0,002 1	0,000		pass



Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 7	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 4	4,000 1	0,000 50	0,000		pass
8	7,999 5	8,000 2	0,001 0	0,001		pass
10	9,999 4	10,000 1	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 6	12,000 3	0,001 5	0,001		pass
16	15,999 6	16,000 3	0,001 7	0,001		pass
20	19,999 4	20,000 1	0,002 1	0,000		pass
0	-0,000 5	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,000 5	-4,000 0	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,000 6	-8,000 1	0,001 0	0,000		pass
-10	-10,000 5	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,000 6	-12,000 1	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,000 6	-16,000 1	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,000 6	-20,000 1	0,002 1	0,000		pass



Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 0	4,000 0	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 1	8,000 1	0,001 0	0,000		pass
10	10,000 0	10,000 0	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 1	12,000 1	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 1	16,000 1	0,001 7	0,000		pass
20	20,000 0	20,000 0	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 9	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 9	-8,000 1	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 9	-10,000 1	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 8	-12,000 0	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 8	-16,000 0	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 8	-20,000 0	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 5	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 7	4,000 2	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 9	8,000 4	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 8	10,000 3	0,001 1	0,000		pass
12	12,000 9	12,000 4	0,001 5	0,000		pass
16	16,000 9	16,000 4	0,001 7	0,000		pass
20	20,001 0	20,000 5	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 7	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 3	-4,000 0	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 4	-8,000 1	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 4	-10,000 1	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 5	-12,000 2	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 6	-16,000 3	0,001 7	-0,001		pass
-20	-19,999 5	-20,000 2	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **11**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,002 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,002 3	4,000 1	0,000 50	0,001		pass
8	8,002 5	8,000 3	0,001 0	0,002		pass
10	10,002 2	10,000 0	0,001 1	0,000		pass
12	12,002 3	12,000 1	0,001 5	0,001		pass
16	16,002 3	16,000 1	0,001 7	0,001		pass
20	20,002 0	19,999 8	0,002 1	0,000		pass
0	0,002 4	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,997 5	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,997 5	-7,999 9	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,997 4	-9,999 8	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,997 5	-11,999 9	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,997 4	-15,999 8	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,997 4	-19,999 8	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,000 2	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,999 7	3,999 9	0,000 50	0,000		pass
8	7,999 7	7,999 9	0,001 0	0,000		pass
10	9,999 6	9,999 8	0,001 1	0,000		pass
12	11,999 6	11,999 8	0,001 5	0,000		pass
16	15,999 5	15,999 7	0,001 7	0,000		pass
20	19,999 4	19,999 6	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 0	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 9	-3,999 9	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 9	-7,999 9	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 7	-9,999 7	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 7	-11,999 7	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 6	-15,999 6	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 5	-19,999 5	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,000 5	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,000 7	4,000 2	0,000 50	0,000		pass
8	8,000 9	8,000 4	0,001 0	0,001		pass
10	10,000 8	10,000 3	0,001 1	0,000		pass
12	12,001 1	12,000 6	0,001 5	0,001		pass
16	16,001 2	16,000 7	0,001 7	0,001		pass
20	20,001 1	20,000 6	0,002 1	0,000		pass
0	0,000 8	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,999 3	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,999 4	-8,000 2	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,999 4	-10,000 2	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,999 5	-12,000 3	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,999 5	-16,000 3	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,999 6	-20,000 4	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,002 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,002 2	4,000 1	0,000 50	0,000		pass
8	8,002 3	8,000 2	0,001 0	0,001		pass
10	10,002 3	10,000 2	0,001 1	0,000		pass
12	12,002 4	12,000 3	0,001 5	0,001		pass
16	16,002 5	16,000 4	0,001 7	0,001		pass
20	20,002 3	20,000 2	0,002 1	0,000		pass
0	0,002 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,997 9	-4,000 0	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,998 0	-8,000 1	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,997 9	-10,000 0	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,998 0	-12,000 1	0,001 5	0,000		pass
-16	-15,998 0	-16,000 1	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,998 0	-20,000 1	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	-0,001 7	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	3,998 5	4,000 2	0,000 50	0,001		pass
8	7,998 6	8,000 3	0,001 0	0,001		pass
10	9,998 6	10,000 3	0,001 1	0,001		pass
12	11,998 6	12,000 3	0,001 5	0,001		pass
16	15,998 6	16,000 3	0,001 7	0,001		pass
20	19,998 4	20,000 1	0,002 1	0,000		pass
0	-0,001 4	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-4,001 5	-4,000 1	0,000 50	0,000		pass
-8	-8,001 6	-8,000 2	0,001 0	-0,001		pass
-10	-10,001 5	-10,000 1	0,001 1	0,000		pass
-12	-12,001 5	-12,000 1	0,001 5	0,000		pass
-16	-16,001 6	-16,000 2	0,001 7	0,000		pass
-20	-20,001 6	-20,000 2	0,002 1	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
mV/V	mV/V	mV/V	mV/V	%	mV/V	
0	0,004 9	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
4	4,005 1	4,000 2	0,000 50	0,000		pass
8	8,005 4	8,000 5	0,001 0	0,000		pass
10	10,005 4	10,000 5	0,001 1	0,000		pass
12	12,005 6	12,000 7	0,001 5	0,000		pass
16	16,005 9	16,001 0	0,001 7	0,001		pass
20	20,006 0	20,001 1	0,002 1	0,000		pass
0	0,005 1	0,000 0	0,000 50	0,000		pass
-4	-3,995 1	-4,000 2	0,000 50	0,000		pass
-8	-7,995 4	-8,000 5	0,001 0	0,000		pass
-10	-9,995 5	-10,000 6	0,001 1	0,000		pass
-12	-11,995 7	-12,000 8	0,001 5	-0,001		pass
-16	-15,995 8	-16,000 9	0,001 7	0,000		pass
-20	-19,996 0	-20,001 1	0,002 1	0,000		pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*

Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±15 V	**DC 10V**		10 Hz Bes.	0,000 1 V

zul. Lin.-Abw.: ±0,02 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,05 % * *value* + 0,05 % * *range*)
perm. abs. dev.

Kanal / *channel* 1


Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 6	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 4	1,999 8	0,000 24	0,000		pass
4	4,000 0	3,999 4	0,000 39	-0,001		pass
5	5,000 0	4,999 4	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 9	5,999 3	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 5	7,998 9	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 3	9,998 7	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 2	-1,999 7	0,000 24	0,001		pass
-4	-3,999 0	-3,999 5	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 8	-4,999 3	0,001 6	0,001		pass
-6	-5,998 7	-5,999 2	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 5	-7,999 0	0,001 7	0,001		pass
-10	-9,998 4	-9,998 9	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* 2

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 2	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 7	3,999 2	0,000 39	-0,001		pass
5	4,999 7	4,999 2	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 5	5,999 0	0,001 6	0,000		pass
8	7,999 1	7,998 6	0,001 7	0,000		pass
10	9,998 8	9,998 3	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 2	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,998 9	-3,999 4	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 7	-4,999 2	0,001 6	0,001		pass
-6	-5,998 6	-5,999 1	0,001 6	0,000		pass
-8	-7,998 3	-7,998 8	0,001 7	0,001		pass
-10	-9,998 1	-9,998 6	0,001 7	0,000		pass


Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 4	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 1	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 7	3,999 3	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 6	4,999 2	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 5	5,999 1	0,001 6	0,000		pass
8	7,999 1	7,998 7	0,001 7	0,000		pass
10	9,998 8	9,998 4	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 2	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,998 9	-3,999 4	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 7	-4,999 2	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 6	-5,999 1	0,001 6	0,000		pass
-8	-7,998 3	-7,998 8	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 0	-9,998 5	0,001 7	0,000		pass

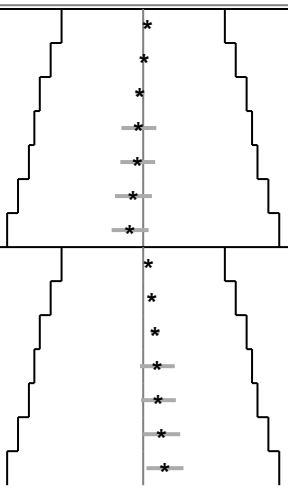

Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 4	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 3	1,999 9	0,000 24	0,001		pass
4	3,999 9	3,999 5	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 9	4,999 5	0,001 6	0,001		pass
6	5,999 8	5,999 4	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 4	7,999 0	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 2	9,998 8	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 4	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 3	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 1	-3,999 5	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 9	-4,999 3	0,001 6	0,001		pass
-6	-5,998 8	-5,999 2	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 6	-7,999 0	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 4	-9,998 8	0,001 7	0,000		pass

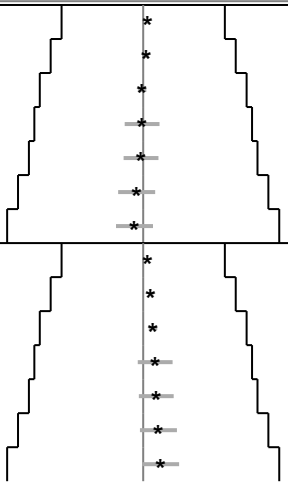

Kanal / *channel* **5**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 2	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 0	1,999 8	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 7	3,999 5	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 6	4,999 4	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 5	5,999 3	0,001 6	0,000		pass
8	7,999 2	7,999 0	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 0	9,998 8	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 3	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 4	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 1	-3,999 4	0,000 39	0,001		pass
-5	-4,999 0	-4,999 3	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 8	-5,999 1	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 6	-7,998 9	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 4	-9,998 7	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 3	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 0	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 7	3,999 4	0,000 39	-0,001		pass
5	4,999 7	4,999 4	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 6	5,999 3	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 2	7,998 9	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 0	9,998 7	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 4	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 4	-1,999 8	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 1	-3,999 5	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 9	-4,999 3	0,001 6	0,001		pass
-6	-5,998 8	-5,999 2	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 6	-7,999 0	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 4	-9,998 8	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **7**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 3	1,999 8	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 9	3,999 4	0,000 39	-0,001		pass
5	4,999 9	4,999 4	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 8	5,999 3	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 4	7,998 9	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 2	9,998 7	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 2	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 0	-3,999 5	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 9	-4,999 4	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 7	-5,999 2	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 5	-7,999 0	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 3	-9,998 8	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 2	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 8	3,999 3	0,000 39	-0,001		pass
5	4,999 8	4,999 3	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 6	5,999 1	0,001 6	0,000		pass
8	7,999 2	7,998 7	0,001 7	-0,001		pass
10	9,999 0	9,998 5	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 2	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,998 9	-3,999 4	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 8	-4,999 3	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 6	-5,999 1	0,001 6	0,000		pass
-8	-7,998 4	-7,998 9	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 1	-9,998 6	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 4	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 2	1,999 8	0,000 24	0,001		pass
4	3,999 8	3,999 4	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 7	4,999 3	0,001 6	0,001		pass
6	5,999 5	5,999 1	0,001 6	0,000		pass
8	7,999 1	7,998 7	0,001 7	0,000		pass
10	9,998 8	9,998 4	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 2	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,998 9	-3,999 4	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 8	-4,999 3	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 6	-5,999 1	0,001 6	0,000		pass
-8	-7,998 3	-7,998 8	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 0	-9,998 5	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 3	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 1	1,999 8	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 8	3,999 5	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 7	4,999 4	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 6	5,999 3	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 2	7,998 9	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 0	9,998 7	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 3	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 4	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 2	-3,999 5	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,999 0	-4,999 3	0,001 6	0,001		pass
-6	-5,998 9	-5,999 2	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 7	-7,999 0	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 5	-9,998 8	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **11**


Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 4	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 1	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 7	3,999 3	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 6	4,999 2	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 5	5,999 1	0,001 6	0,000		pass
8	7,999 1	7,998 7	0,001 7	0,000		pass
10	9,998 8	9,998 4	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 4	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 3	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 0	-3,999 4	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 9	-4,999 3	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 7	-5,999 1	0,001 6	0,000		pass
-8	-7,998 4	-7,998 8	0,001 7	0,001		pass
-10	-9,998 2	-9,998 6	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 2	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 9	3,999 4	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 7	4,999 2	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 6	5,999 1	0,001 6	0,000		pass
8	7,999 2	7,998 7	0,001 7	0,000		pass
10	9,998 9	9,998 4	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 5	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 2	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,998 9	-3,999 4	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,998 7	-4,999 2	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 5	-5,999 0	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 2	-7,998 7	0,001 7	0,001		pass
-10	-9,998 0	-9,998 5	0,001 7	0,000		pass


Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 2	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 1	1,999 9	0,000 24	0,001		pass
4	3,999 9	3,999 7	0,000 39	0,001		pass
5	4,999 8	4,999 6	0,001 6	0,001		pass
6	5,999 7	5,999 5	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 4	7,999 2	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 2	9,999 0	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 3	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 5	-1,999 8	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 3	-3,999 6	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,999 2	-4,999 5	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,999 1	-5,999 4	0,001 6	0,000		pass
-8	-7,998 9	-7,999 2	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 7	-9,999 0	0,001 7	0,000		pass

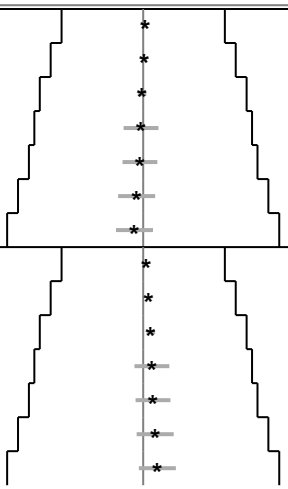

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 3	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 1	1,999 8	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 8	3,999 5	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 7	4,999 4	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 6	5,999 3	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 2	7,998 9	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 0	9,998 7	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 3	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 4	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,999 2	-3,999 5	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,999 1	-4,999 4	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 9	-5,999 2	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 7	-7,999 0	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 5	-9,998 8	0,001 7	0,000		pass

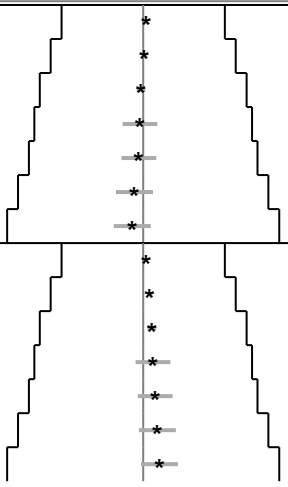

Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 8	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	2,000 5	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	4,000 2	3,999 4	0,000 39	0,000		pass
5	5,000 1	4,999 3	0,001 6	0,000		pass
6	6,000 0	5,999 2	0,001 6	0,001		pass
8	7,999 6	7,998 8	0,001 7	0,000		pass
10	9,999 3	9,998 5	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 7	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 0	-1,999 7	0,000 24	0,000		pass
-4	-3,998 7	-3,999 4	0,000 39	0,001		pass
-5	-4,998 6	-4,999 3	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 4	-5,999 1	0,001 6	0,001		pass
-8	-7,998 2	-7,998 9	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 0	-9,998 7	0,001 7	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
V	V	V	V	%	V	
0	0,000 1	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
2	1,999 8	1,999 7	0,000 24	0,000		pass
4	3,999 5	3,999 4	0,000 39	0,000		pass
5	4,999 3	4,999 2	0,001 6	0,000		pass
6	5,999 2	5,999 1	0,001 6	0,000		pass
8	7,998 8	7,998 7	0,001 7	0,000		pass
10	9,998 5	9,998 4	0,001 7	0,000		pass
0	0,000 1	0,000 0	0,000 12	0,000		pass
-2	-1,999 5	-1,999 6	0,000 24	0,001		pass
-4	-3,999 2	-3,999 3	0,000 39	0,000		pass
-5	-4,999 1	-4,999 2	0,001 6	0,000		pass
-6	-5,998 9	-5,999 0	0,001 6	0,000		pass
-8	-7,998 6	-7,998 7	0,001 7	0,000		pass
-10	-9,998 3	-9,998 4	0,001 7	0,000		pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*

Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±40000 µm/m	**SG quarter bridge, 120Ohms, 4wire / Br. excit. Voltage 1V**	**DC**	1,25 Hz Bes.	1 µm/m

zul. Lin.-Abw.: ±0,05 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,2 % * *value* + 0,2 % * *range*)
perm. abs. dev.

Kanal / *channel* 1

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-15	0	10	0,000		pass
3200	3185	3200	10	0,001		pass
6400	6385	6400	10	0,002		pass
8000	7984	7999	10	0,000		pass
9600	9586	9601	10	0,006		pass
12800	12785	12800	10	0,004		pass
16000	15983	15998	10	0,000		pass
0	-14	0	10	0,000		pass
-3200	-3211	-3197	10	0,006		pass
-6400	-6411	-6397	10	0,004		pass
-8000	-8010	-7996	10	0,006		pass
-9600	-9611	-9597	10	0,003		pass
-12800	-12809	-12795	10	0,006		pass
-16000	-16011	-15997	10	0,000		pass

Kanal / *channel* 2

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-11	0	10	0,000		pass
3200	3187	3198	10	-0,006		pass
6400	6390	6401	10	0,001		pass
8000	7989	8000	10	-0,002		pass
9600	9591	9602	10	0,002		pass
12800	12791	12802	10	0,001		pass
16000	15991	16002	10	0,000		pass
0	-11	0	10	0,000		pass
-3200	-3211	-3200	10	0,001		pass
-6400	-6413	-6402	10	-0,004		pass
-8000	-8009	-7998	10	0,006		pass
-9600	-9611	-9600	10	0,002		pass
-12800	-12811	-12800	10	0,002		pass
-16000	-16012	-16001	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **3**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-7	0	10	0,000		pass
3200	3193	3200	10	-0,001		pass
6400	6394	6401	10	0,001		pass
8000	7994	8001	10	0,001		pass
9600	9592	9599	10	-0,004		pass
12800	12792	12799	10	-0,005		pass
16000	15994	16001	10	0,000		pass
0	-3	0	10	0,000		pass
-3200	-3203	-3200	10	0,000		pass
-6400	-6403	-6400	10	-0,001		pass
-8000	-8002	-7999	10	0,001		pass
-9600	-9603	-9600	10	-0,001		pass
-12800	-12802	-12799	10	0,001		pass
-16000	-16002	-15999	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **4**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	8	0	10	0,000		pass
3200	3206	3198	10	-0,004		pass
6400	6407	6399	10	0,000		pass
8000	8007	7999	10	0,000		pass
9600	9605	9597	10	-0,004		pass
12800	12806	12798	10	-0,001		pass
16000	16006	15998	10	0,000		pass
0	9	0	10	0,000		pass
-3200	-3189	-3198	10	0,004		pass
-6400	-6390	-6399	10	0,002		pass
-8000	-7990	-7999	10	0,001		pass
-9600	-9590	-9599	10	0,001		pass
-12800	-12789	-12798	10	0,003		pass
-16000	-15990	-15999	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **5**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-25	0	10	0,000		pass
3200	3174	3199	10	-0,003		pass
6400	6377	6402	10	0,003		pass
8000	7978	8003	10	0,005		pass
9600	9576	9601	10	0,000		pass
12800	12776	12801	10	-0,001		pass
16000	15977	16002	10	0,000		pass
0	-22	0	10	0,000		pass
-3200	-3221	-3199	10	0,002		pass
-6400	-6422	-6400	10	-0,001		pass
-8000	-8019	-7997	10	0,006		pass
-9600	-9619	-9597	10	0,006		pass
-12800	-12821	-12799	10	0,001		pass
-16000	-16021	-15999	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-9	0	10	0,000		pass
3200	3187	3196	10	-0,004		pass
6400	6384	6393	10	-0,004		pass
8000	7984	7993	10	-0,001		pass
9600	9584	9593	10	0,002		pass
12800	12781	12790	10	0,001		pass
16000	15978	15987	10	0,000		pass
0	-11	0	10	0,000		pass
-3200	-3206	-3195	10	0,004		pass
-6400	-6403	-6392	10	0,004		pass
-8000	-8003	-7992	10	0,000		pass
-9600	-9603	-9592	10	-0,004		pass
-12800	-12798	-12787	10	0,000		pass
-16000	-15995	-15984	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **7**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-20	0	10	0,000		pass
3200	3178	3198	10	-0,003		pass
6400	6378	6398	10	-0,001		pass
8000	7977	7997	10	-0,003		pass
9600	9579	9599	10	0,003		pass
12800	12778	12798	10	0,003		pass
16000	15976	15996	10	0,000		pass
0	-21	0	10	0,000		pass
-3200	-3219	-3198	10	0,004		pass
-6400	-6421	-6400	10	-0,002		pass
-8000	-8019	-7998	10	0,002		pass
-9600	-9620	-9599	10	-0,001		pass
-12800	-12818	-12797	10	0,003		pass
-16000	-16019	-15998	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **8**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-24	0	10	0,000		pass
3200	3176	3200	10	-0,001		pass
6400	6377	6401	10	0,001		pass
8000	7976	8000	10	-0,001		pass
9600	9577	9601	10	0,001		pass
12800	12777	12801	10	0,000		pass
16000	15977	16001	10	0,000		pass
0	-21	0	10	0,000		pass
-3200	-3220	-3199	10	0,002		pass
-6400	-6421	-6400	10	-0,001		pass
-8000	-8021	-8000	10	-0,001		pass
-9600	-9621	-9600	10	-0,001		pass
-12800	-12820	-12799	10	0,001		pass
-16000	-16020	-15999	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **9**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-5	0	10	0,000		pass
3200	3196	3201	10	0,002		pass
6400	6398	6403	10	0,006		pass
8000	7994	7999	10	-0,005		pass
9600	9595	9600	10	-0,003		pass
12800	12795	12800	10	-0,004		pass
16000	15997	16002	10	0,000		pass
0	-3	0	10	0,000		pass
-3200	-3203	-3200	10	0,000		pass
-6400	-6403	-6400	10	0,000		pass
-8000	-8003	-8000	10	0,000		pass
-9600	-9601	-9598	10	0,005		pass
-12800	-12802	-12799	10	0,002		pass
-16000	-16003	-16000	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **10**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	1	0	10	0,000		pass
3200	3202	3201	10	0,001		pass
6400	6401	6400	10	-0,003		pass
8000	8001	8000	10	-0,004		pass
9600	9603	9602	10	0,000		pass
12800	12803	12802	10	-0,001		pass
16000	16004	16003	10	0,000		pass
0	3	0	10	0,000		pass
-3200	-3198	-3201	10	0,000		pass
-6400	-6399	-6402	10	-0,001		pass
-8000	-7999	-8002	10	0,000		pass
-9600	-9600	-9603	10	-0,001		pass
-12800	-12800	-12803	10	0,001		pass
-16000	-16001	-16004	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **11**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	9	0	10	0,000		pass
3200	3209	3200	10	-0,001		pass
6400	6410	6401	10	0,001		pass
8000	8011	8002	10	0,003		pass
9600	9609	9600	10	-0,003		pass
12800	12809	12800	10	-0,004		pass
16000	16011	16002	10	0,000		pass
0	11	0	10	0,000		pass
-3200	-3188	-3199	10	0,002		pass
-6400	-6389	-6400	10	0,000		pass
-8000	-7990	-8001	10	-0,002		pass
-9600	-9590	-9601	10	-0,002		pass
-12800	-12789	-12800	10	0,000		pass
-16000	-15989	-16000	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-2	0	10	0,000		pass
3200	3196	3198	10	-0,004		pass
6400	6397	6399	10	0,000		pass
8000	7996	7998	10	-0,001		pass
9600	9597	9599	10	0,002		pass
12800	12795	12797	10	-0,002		pass
16000	15995	15997	10	0,000		pass
0	-4	0	10	0,000		pass
-3200	-3203	-3199	10	0,002		pass
-6400	-6404	-6400	10	0,000		pass
-8000	-8002	-7998	10	0,005		pass
-9600	-9602	-9598	10	0,005		pass
-12800	-12802	-12798	10	0,005		pass
-16000	-16004	-16000	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	2	0	10	0,000		pass
3200	3200	3198	10	-0,004		pass
6400	6402	6400	10	0,001		pass
8000	8002	8000	10	0,001		pass
9600	9602	9600	10	0,001		pass
12800	12801	12799	10	-0,001		pass
16000	16001	15999	10	0,000		pass
0	2	0	10	0,000		pass
-3200	-3196	-3198	10	0,004		pass
-6400	-6395	-6397	10	0,005		pass
-8000	-7997	-7999	10	0,000		pass
-9600	-9597	-9599	10	-0,001		pass
-12800	-12795	-12797	10	0,003		pass
-16000	-15996	-15998	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-1	0	10	0,000		pass
3200	3198	3199	10	-0,002		pass
6400	6401	6402	10	0,005		pass
8000	8000	8001	10	0,002		pass
9600	9600	9601	10	0,002		pass
12800	12800	12801	10	0,002		pass
16000	15999	16000	10	0,000		pass
0	0	0	10	0,000		pass
-3200	-3200	-3200	10	0,000		pass
-6400	-6401	-6401	10	-0,003		pass
-8000	-8000	-8000	10	-0,001		pass
-9600	-9599	-9599	10	0,001		pass
-12800	-12800	-12800	10	-0,002		pass
-16000	-15999	-15999	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **15**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-17	0	10	0,000		pass
3200	3183	3200	10	0,000		pass
6400	6384	6401	10	0,003		pass
8000	7985	8002	10	0,006		pass
9600	9587	9604	10	0,011		pass
12800	12786	12803	10	0,009		pass
16000	15982	15999	10	0,000		pass
0	-15	0	10	0,000		pass
-3200	-3217	-3202	10	-0,006		pass
-6400	-6417	-6402	10	-0,006		pass
-8000	-8014	-7999	10	0,001		pass
-9600	-9616	-9601	10	-0,004		pass
-12800	-12815	-12800	10	-0,002		pass
-16000	-16014	-15999	10	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-1	0	10	0,000		pass
3200	3200	3201	10	0,000		pass
6400	6403	6404	10	0,004		pass
8000	8002	8003	10	0,000		pass
9600	9605	9606	10	0,006		pass
12800	12805	12806	10	0,003		pass
16000	16005	16006	10	0,000		pass
0	1	0	10	0,000		pass
-3200	-3199	-3200	10	0,003		pass
-6400	-6402	-6403	10	-0,002		pass
-8000	-8001	-8002	10	0,002		pass
-9600	-9604	-9605	10	-0,004		pass
-12800	-12803	-12804	10	0,002		pass
-16000	-16005	-16006	10	0,000		pass

Kalibrierergebnis / *Calibration result*

Messbereich *measuring range*	Sensortyp / -parameter *sensor type / parameter*	Trägerfreq. *carrier freq.*	Filter *filter*	Anz.-Schrittweite *indication step width*
±16000 µm/m	**SG quarter bridge, 350Ohms, 4wire / Br. excit. Voltage 2,5V**	**DC**	2,5 Hz Bes.	1 µm/m

zul. Lin.-Abw.: ±0,05 %
perm. lin. dev.

zul. abs. Abw.: ±(0,2 % * *value* + 0,2 % * *range*)
perm. abs. dev.

Kanal / *channel* 1


Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-6	0	4,0	0,000		pass
3200	3194	3200	4,0	-0,001		pass
6400	6394	6400	4,0	-0,003		pass
8000	7994	8000	4,0	-0,003		pass
9600	9595	9601	4,0	0,002		pass
12800	12794	12800	4,0	-0,005		pass
16000	15995	16001	4,0	0,000		pass
0	-4	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3205	-3201	4,0	-0,007		pass
-6400	-6405	-6401	4,0	-0,009		pass
-8000	-8004	-8000	4,0	-0,003		pass
-9600	-9604	-9600	4,0	-0,004		pass
-12800	-12804	-12800	4,0	-0,005		pass
-16000	-16003	-15999	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* 2

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-2	0	4,0	0,000		pass
3200	3198	3200	4,0	0,003		pass
6400	6397	6399	4,0	-0,001		pass
8000	7998	8000	4,0	0,006		pass
9600	9597	9599	4,0	0,001		pass
12800	12796	12798	4,0	-0,002		pass
16000	15996	15998	4,0	0,000		pass
0	-5	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3205	-3200	4,0	0,000		pass
-6400	-6404	-6399	4,0	0,006		pass
-8000	-8005	-8000	4,0	0,000		pass
-9600	-9604	-9599	4,0	0,006		pass
-12800	-12805	-12800	4,0	0,000		pass
-16000	-16005	-16000	4,0	0,000		pass


Kanal / *channel* **3**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	1	0	4,0	0,000		pass
3200	3201	3200	4,0	-0,002		pass
6400	6400	6399	4,0	-0,011		pass
8000	8001	8000	4,0	-0,006		pass
9600	9601	9600	4,0	-0,007		pass
12800	12802	12801	4,0	-0,004		pass
16000	16003	16002	4,0	0,000		pass
0	0	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3199	-3199	4,0	0,008		pass
-6400	-6400	-6400	4,0	0,003		pass
-8000	-8000	-8000	4,0	0,003		pass
-9600	-9600	-9600	4,0	0,004		pass
-12800	-12801	-12801	4,0	-0,001		pass
-16000	-16001	-16001	4,0	0,000		pass

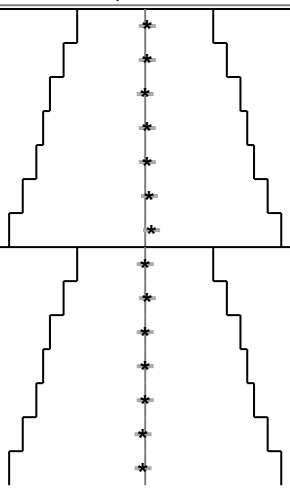

Kanal / *channel* **4**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	0	0	4,0	0,000		pass
3200	3201	3201	4,0	0,004		pass
6400	6399	6399	4,0	-0,011		pass
8000	8001	8001	4,0	0,000		pass
9600	9601	9601	4,0	-0,001		pass
12800	12801	12801	4,0	-0,004		pass
16000	16002	16002	4,0	0,000		pass
0	2	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3198	-3200	4,0	0,000		pass
-6400	-6396	-6398	4,0	0,012		pass
-8000	-7997	-7999	4,0	0,006		pass
-9600	-9597	-9599	4,0	0,006		pass
-12800	-12797	-12799	4,0	0,006		pass
-16000	-15998	-16000	4,0	0,000		pass

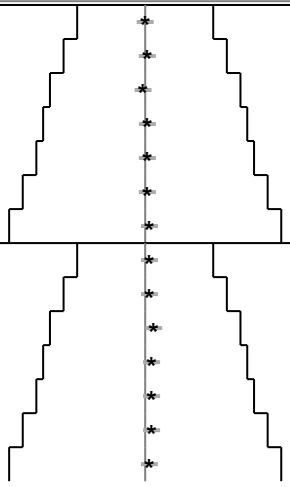

Kanal / *channel* **5**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-3	0	4,0	0,000		pass
3200	3198	3201	4,0	0,002		pass
6400	6399	6402	4,0	0,005		pass
8000	8000	8003	4,0	0,009		pass
9600	9599	9602	4,0	0,001		pass
12800	12800	12803	4,0	0,004		pass
16000	16000	16003	4,0	0,000		pass
0	-3	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3204	-3201	4,0	-0,004		pass
-6400	-6403	-6400	4,0	0,005		pass
-8000	-8003	-8000	4,0	0,006		pass
-9600	-9605	-9602	4,0	-0,005		pass
-12800	-12805	-12802	4,0	-0,003		pass
-16000	-16005	-16002	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **6**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-4	0	4,0	0,000		pass
3200	3196	3200	4,0	-0,004		pass
6400	6397	6401	4,0	-0,001		pass
8000	7997	8001	4,0	-0,003		pass
9600	9598	9602	4,0	0,001		pass
12800	12797	12801	4,0	-0,009		pass
16000	15999	16003	4,0	0,000		pass
0	-3	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3204	-3201	4,0	-0,004		pass
-6400	-6405	-6402	4,0	-0,008		pass
-8000	-8003	-8000	4,0	0,006		pass
-9600	-9604	-9601	4,0	0,001		pass
-12800	-12804	-12801	4,0	0,004		pass
-16000	-16005	-16002	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **7**


Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-7	0	4,0	0,000		pass
3200	3193	3200	4,0	0,000		pass
6400	6393	6400	4,0	0,000		pass
8000	7993	8000	4,0	0,000		pass
9600	9594	9601	4,0	0,006		pass
12800	12793	12800	4,0	0,000		pass
16000	15993	16000	4,0	0,000		pass
0	-8	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3209	-3201	4,0	-0,006		pass
-6400	-6408	-6400	4,0	0,000		pass
-8000	-8007	-7999	4,0	0,006		pass
-9600	-9608	-9600	4,0	0,000		pass
-12800	-12808	-12800	4,0	0,000		pass
-16000	-16008	-16000	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **8**

Messwerte *y* / *measured values y*				Spezifikation / *specification*		
Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-4	0	4,0	0,000		pass
3200	3196	3200	4,0	-0,002		pass
6400	6397	6401	4,0	0,001		pass
8000	7998	8002	4,0	0,006		pass
9600	9598	9602	4,0	0,005		pass
12800	12799	12803	4,0	0,009		pass
16000	15998	16002	4,0	0,000		pass
0	-2	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3202	-3200	4,0	0,001		pass
-6400	-6403	-6401	4,0	-0,004		pass
-8000	-8003	-8001	4,0	-0,003		pass
-9600	-9603	-9601	4,0	-0,002		pass
-12800	-12804	-12802	4,0	-0,007		pass
-16000	-16003	-16001	4,0	0,000		pass


Kanal / *channel* **9**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-1	0	4,0	0,000		pass
3200	3200	3201	4,0	0,006		pass
6400	6398	6399	4,0	-0,006		pass
8000	7999	8000	4,0	0,000		pass
9600	9599	9600	4,0	0,000		pass
12800	12798	12799	4,0	-0,006		pass
16000	15999	16000	4,0	0,000		pass
0	-2	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3201	-3199	4,0	0,008		pass
-6400	-6402	-6400	4,0	0,003		pass
-8000	-8002	-8000	4,0	0,003		pass
-9600	-9603	-9601	4,0	-0,002		pass
-12800	-12802	-12800	4,0	0,005		pass
-16000	-16003	-16001	4,0	0,000		pass



Kanal / *channel* **10**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	3	0	4,0	0,000		pass
3200	3203	3200	4,0	0,000		pass
6400	6403	6400	4,0	0,000		pass
8000	8003	8000	4,0	0,000		pass
9600	9602	9599	4,0	-0,006		pass
12800	12803	12800	4,0	0,000		pass
16000	16003	16000	4,0	0,000		pass
0	2	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3198	-3200	4,0	-0,001		pass
-6400	-6398	-6400	4,0	-0,002		pass
-8000	-7997	-7999	4,0	0,003		pass
-9600	-9596	-9598	4,0	0,009		pass
-12800	-12796	-12798	4,0	0,008		pass
-16000	-15997	-15999	4,0	0,000		pass



Kanal / *channel* **11**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	2	0	4,0	0,000		pass
3200	3202	3200	4,0	-0,001		pass
6400	6403	6401	4,0	0,004		pass
8000	8004	8002	4,0	0,009		pass
9600	9604	9602	4,0	0,009		pass
12800	12804	12802	4,0	0,007		pass
16000	16003	16001	4,0	0,000		pass
0	2	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3198	-3200	4,0	0,000		pass
-6400	-6398	-6400	4,0	0,000		pass
-8000	-7998	-8000	4,0	0,000		pass
-9600	-9598	-9600	4,0	0,000		pass
-12800	-12798	-12800	4,0	0,000		pass
-16000	-15998	-16000	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **12**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	3	0	4,0	0,000		pass
3200	3203	3200	4,0	-0,004		pass
6400	6404	6401	4,0	-0,001		pass
8000	8005	8002	4,0	0,003		pass
9600	9604	9601	4,0	-0,005		pass
12800	12805	12802	4,0	-0,003		pass
16000	16006	16003	4,0	0,000		pass
0	4	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3197	-3201	4,0	-0,004		pass
-6400	-6396	-6400	4,0	0,005		pass
-8000	-7997	-8001	4,0	0,000		pass
-9600	-9597	-9601	4,0	0,001		pass
-12800	-12797	-12801	4,0	0,004		pass
-16000	-15998	-16002	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **13**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	2	0	4,0	0,000		pass
3200	3202	3200	4,0	-0,001		pass
6400	6403	6401	4,0	0,004		pass
8000	8003	8001	4,0	0,003		pass
9600	9602	9600	4,0	-0,004		pass
12800	12802	12800	4,0	-0,005		pass
16000	16003	16001	4,0	0,000		pass
0	3	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3197	-3200	4,0	0,001		pass
-6400	-6397	-6400	4,0	0,003		pass
-8000	-7997	-8000	4,0	0,003		pass
-9600	-9598	-9601	4,0	-0,002		pass
-12800	-12798	-12801	4,0	-0,001		pass
-16000	-15998	-16001	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **14**

Eing. Wert *set value*	untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
	Messwerte *y* / *measured values y*			Spezifikation / *specification*		
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	7	0	4,0	0,000		pass
3200	3206	3199	4,0	-0,009		pass
6400	6409	6402	4,0	0,008		pass
8000	8008	8001	4,0	0,000		pass
9600	9609	9602	4,0	0,005		pass
12800	12808	12801	4,0	-0,004		pass
16000	16009	16002	4,0	0,000		pass
0	7	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3193	-3200	4,0	0,002		pass
-6400	-6394	-6401	4,0	-0,001		pass
-8000	-7995	-8002	4,0	-0,006		pass
-9600	-9596	-9603	4,0	-0,011		pass
-12800	-12796	-12803	4,0	-0,009		pass
-16000	-15995	-16002	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **15**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-3	0	4,0	0,000		pass
3200	3197	3200	4,0	0,000		pass
6400	6398	6401	4,0	0,006		pass
8000	7997	8000	4,0	0,000		pass
9600	9598	9601	4,0	0,006		pass
12800	12797	12800	4,0	0,000		pass
16000	15997	16000	4,0	0,000		pass
0	-3	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3204	-3201	4,0	-0,002		pass
-6400	-6405	-6402	4,0	-0,005		pass
-8000	-8007	-8004	4,0	-0,016		pass
-9600	-9606	-9603	4,0	-0,008		pass
-12800	-12806	-12803	4,0	-0,004		pass
-16000	-16006	-16003	4,0	0,000		pass

Kanal / *channel* **16**

Eing. Wert *set value*	Messwerte *y* / *measured values y* untariert *not tared*	tariert *tared*	erw. MU *exp. uncert.*	Spezifikation / *specification* lin. Abw. *lin. error*	abs. Abweichung *abs. deviation*	Bem. *note*
µm/m	µm/m	µm/m	µm/m	%	µm/m	
0	-3	0	4,0	0,000		pass
3200	3197	3200	4,0	-0,002		pass
6400	6397	6400	4,0	-0,005		pass
8000	7998	8001	4,0	0,000		pass
9600	9598	9601	4,0	-0,001		pass
12800	12799	12802	4,0	0,003		pass
16000	15999	16002	4,0	0,000		pass
0	-2	0	4,0	0,000		pass
-3200	-3203	-3201	4,0	-0,001		pass
-6400	-6403	-6401	4,0	0,004		pass
-8000	-8003	-8001	4,0	0,006		pass
-9600	-9602	-9600	4,0	0,015		pass
-12800	-12804	-12802	4,0	0,008		pass
-16000	-16006	-16004	4,0	0,000		pass

Ende des Kalibrierscheins / *End of calibration certificate*