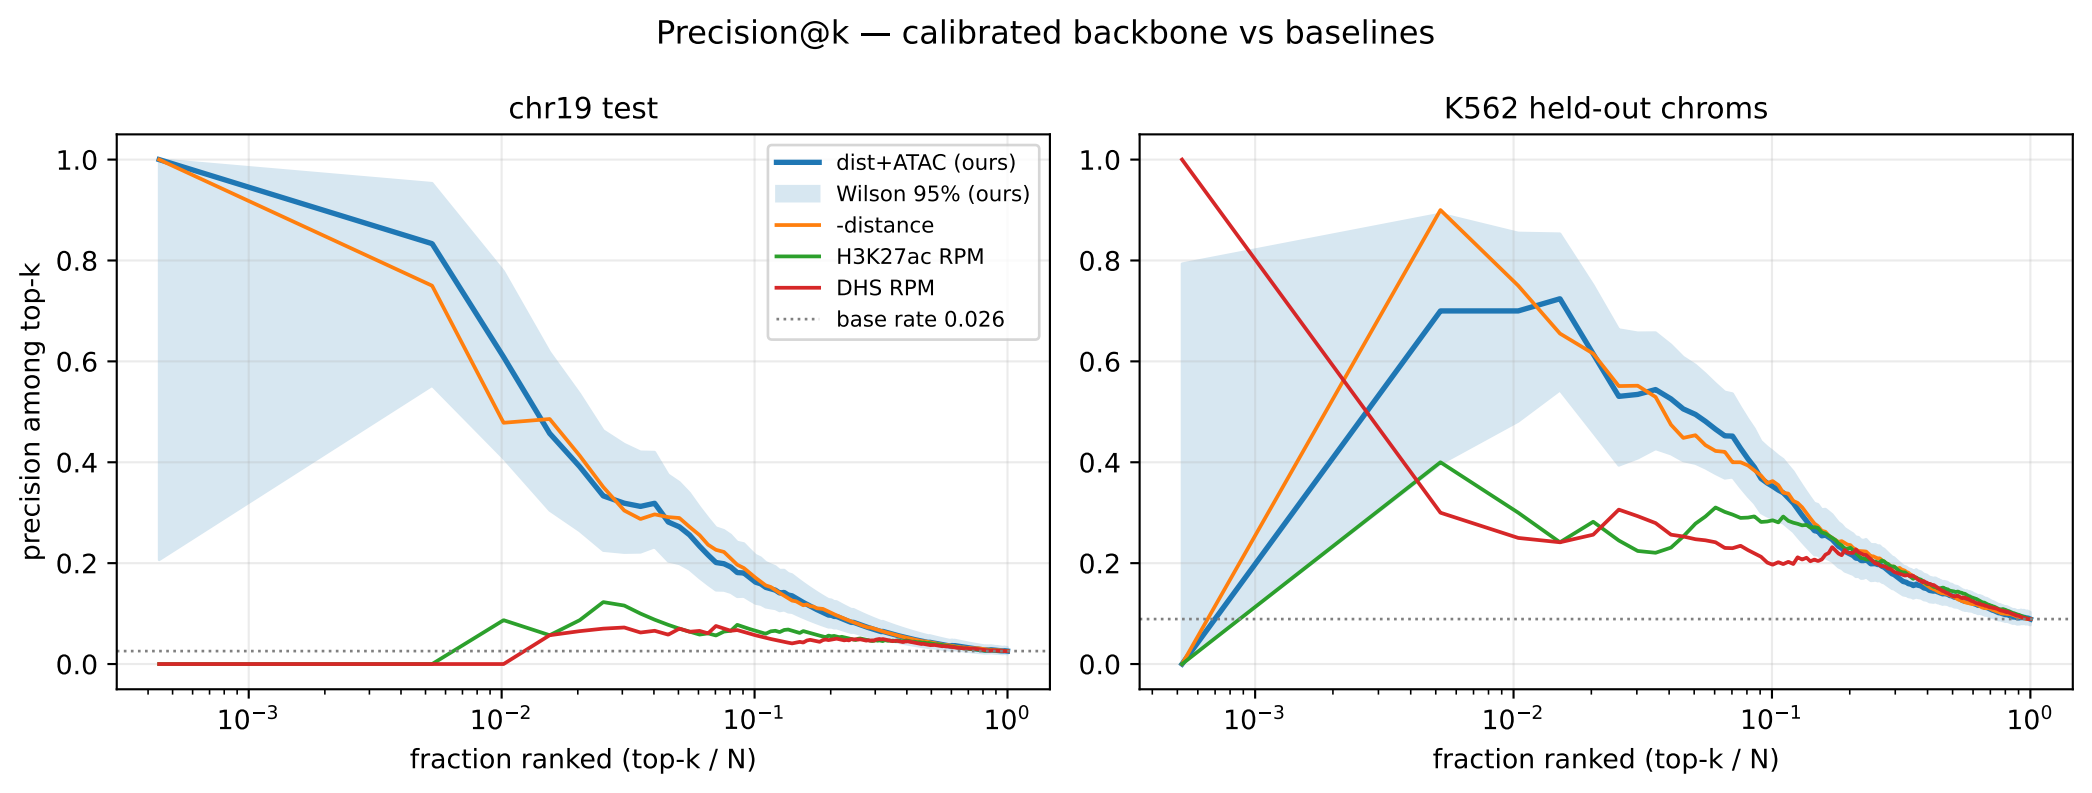
Precision@k — calibrated backbone vs baselines
chr19 test
K562 held-out chroms
dist+ATAC (ours)
Wilson 95% (ours)
-distance
H3K27ac RPM
DHS RPM
base rate 0.026
precision among top-k
fraction ranked (top-k / N)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}