ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ООО «АИЦ»)
Юридический адрес: 601655, Россия, Владимирская область, Александровский район, город Александров, улица Гагарина, дом 2, помещение 4
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»)
Адрес места осуществления деятельности: 601655, РОССИЯ, Владимирская область, район Александровский, город Александров, улица Гагарина, дом 2, этаж 1; 601655, РОССИЯ, Владимирская область, район Александровский, город Александров, улица Гагарина, дом 2, этаж 3, помещение 4 (архив лаборатории), (Архив); 142324, РОССИЯ, Московская область, район Чеховский, деревня Люторецкое, территория промзоны "Люторецкое", строение 4/1; 420051, РОССИЯ, Татарстан республика, район Зеленодольский, с/п Осиновское, промышленная площадка Индустриальный парк "М-7" здание № 7.
Телефон: +7 4922251150, +7 4922251160; адрес электронной почты: official@aic-lab.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»

_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ 20 _____

МП

АКТ
оценки результатов технических испытаний медицинского изделия
№ 27-25МИ от 20.11.2025

Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025

(наименование медицинского изделия)

Составлен ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ООО «АИЦ»)

(наименование организации, проводящей испытания

420051, РОССИЯ, Татарстан Республика, район Зеленодольский, с/п Осиновское, промышленная площадка Индустриальный парк "М-7", здание № 7

(с указанием места проведения испытаний)

Полномочия на проведение испытаний, аккредитация на техническую компетентность и независимость для проведения работ по испытаниям
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21МО57
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 12.12.2023

1. В период с 07.10.2025 по 17.10.2025

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»)

(наименование испытательной организации)

проведена оценка результатов технических испытаний в форме проведения испытаний

Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025

(наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению)

производства ООО «Лаборатория Инноваций», Россия

(наименование производителя, страна производства)

в соответствии с ТУ 32.50.50-001-55480932-2025

наименование и обозначение технической документации

на соответствие требованиям ТУ 32.50.50-001-55480932-2025, ГОСТ 20790-93

наименование и обозначение нормативной и технической документации (например, техническим регламентам, СанПиН, приказам, постановлениям, международным документам)

2. Для проведения технических испытаний представлены:

1. Заявка на проведение испытаний;
2. Акт приема-передачи образцов;
3. Сведения о нормативной документации;
4. ТУ 32.50.50-001-55480932-2025;
5. Инструкция по применению, версия 1 от 11.11.2025г.;
6. Файл менеджмента риска, редакция 1 от 11.11.2025г.;
7. Файл проектирования с учетом эксплуатационной пригодности № ФЭП.001-01/25, редакция 1 от 11.11.2025г.;
8. Протокол № ПС.001-01/25 исследования стабильности от 12.11.2025г.;
9. Акт № АКИ-001.01/25 и Протокол № ПКИ-001.01/25 квалификационных испытаний медицинского изделия от 11.11.2025г.;
10. Протокол № 01/25 от 10.11.2025г.;
11. Протокол № 05/25 от 12.11.2025г.;
12. Протокол № 06/25 от 12.11.2025г.;
13. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B39694/24;
14. Аналитический отчет, номер партии 2486443;
15. Сертификат анализа, номер партии 20250506;
16. Сертификат анализа, номер CAS 3844-45-9;
17. Сертификат анализа № 2002750/120;
18. Сертификат анализа, номер партии 241212F161;
19. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-BR.PA06.B.66362/24;
20. Паспорт безопасности химической продукции ПБХП РБ 600122610-001-2022;
21. Сертификат анализа № 2157362;
22. Паспорт № 720;
23. Удостоверение качества и безопасности № 00-00015511;
24. Паспорт качества № 3457;
25. Паспорт безопасности химической продукции ПБХПРБ 300042199.105-2014;
26. Сертификат качества № 0802106647/900001;
27. Лист безопасности 120-001-ЛПЭ;
28. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.00374/24;
29. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.42497/24;
30. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.43925/24;
31. Паспорт № 328-2025;
32. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.51397/22;
33. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.89658/25;
34. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.86552/25;
35. Протокол испытаний № 001/25 от 10.11.2025г.;
36. Сертификат анализа на гранулы полиэтилена высокой плотности, номер партии 22L0342;
37. Фотографические изображения (Приложение А);
38. Образцы медицинского изделия «Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025»:

перечень документов, данных, образцов медицинского изделия (количество)

№	Наименование медицинского изделия, артикул, заводской номер (при наличии)	Номер партии/серии (при наличии)	Количество, шт./уп.	Дата изготовления	Условный номер образца

1.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл	2	1	1.09.2025	06102025/1
2.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/2
3.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный, объёмом 5000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/3
4.	Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 1000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/4

3. ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»)

наименование испытательной организации

проведена оценка результатов технических испытаний Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025

наименование медицинского изделия

в соответствии с утвержденной программой технических испытаний (Приложение Б).

3.1. Документация представлена в полном объеме. Оформление и содержание технический документации соответствует требованиям действующих стандартов и достаточна для проведения технических испытаний. Замечания к технической и эксплуатационной документации отсутствуют.

оценка представленной документации

3.2. Замечания отсутствуют

рекомендации по устранению отдельных недостатков

3.3. 1

класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий

4. Краткое изложение результатов испытаний Испытания проведены согласно утверждённой программе технических испытаний медицинского изделия в полном объёме и с требуемой точностью

5. Выводы по результатам испытаний	Испытанный(е) образец(цы) медицинского изделия соответствует(ют) требованиям нормативной документации, предъявляемой к данному медицинскому изделию

6. Выводы о соответствии требованиям технической документации производителя (изготовителя)

Испытанное медицинское изделие соответствует требованиям технической документации производителя (изготовителя)

7. Оценка результатов технических испытаний

Испытанный(е) образец(цы) медицинского изделия СООТВЕТСТВУЕТ(ЮТ) требованиям:

- ТУ 32.50.50-001-55480932-2025 «Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения»;
- ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025

наименование медицинского изделия

СООТВЕТСТВУЕТ (ЮТ) требованиям нормативной документации, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

Приложения:

а) фотографические изображения образца (образцов) медицинского изделия, принадлежностей и его (их) маркировки;

б) утвержденная программа технических испытаний медицинского изделия (с перечнем проверок, оценок, которые следует проводить при испытаниях);

в) протокол технических испытаний;

г) варианты исполнения медицинского изделия.

Приложения являются неотъемлемой частью Акта.

Акт выдан на основании протокола испытаний, выгруженного в личный кабинет ИЛ ФГИС Росаккредитации:

1. 12-25/м от 20.11.2025.

Акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия распространяется на все *модели (марки) – варианты исполнения*, указанные в Приложении Г, так как с испытанными образцами:
а) изготовлены по одной и той же технологической документации;
б) относятся к одному классу потенциального риска применения;
в) имеют эквивалентное функциональное назначение и принцип действия;
г) имеют различные технические параметры, не влияющие на принцип работы и функциональное назначение;
д) образуют типоразмерный (модельный) ряд или являются группой исполнения медицинского изделия. При этом под группой исполнения медицинского изделия понимаются изделия, в отношении которых выполнены

один групповой чертеж деталей и (или) одна техническая документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие;
е) имеют одинаковые признаки в части:

- области применения;
- инвазивности;
- стерильности (в том числе с учетом методов стерилизации);
- частоты использования (однократное применение);
- эксплуатационных и конструктивных особенностей.

Подписи:

Председатель комиссии Начальник ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»

_____

должность, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Члены комиссии Инженер-испытатель ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»

_____

должность, фамилия, имя и отчество (при наличии)

Приложение А

Фотографические изображения образца (образцов) медицинского изделия, принадлежностей и его (их) маркировки.

Рис. А.1.1.1- Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл

Рис. А.1.1.2- Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл

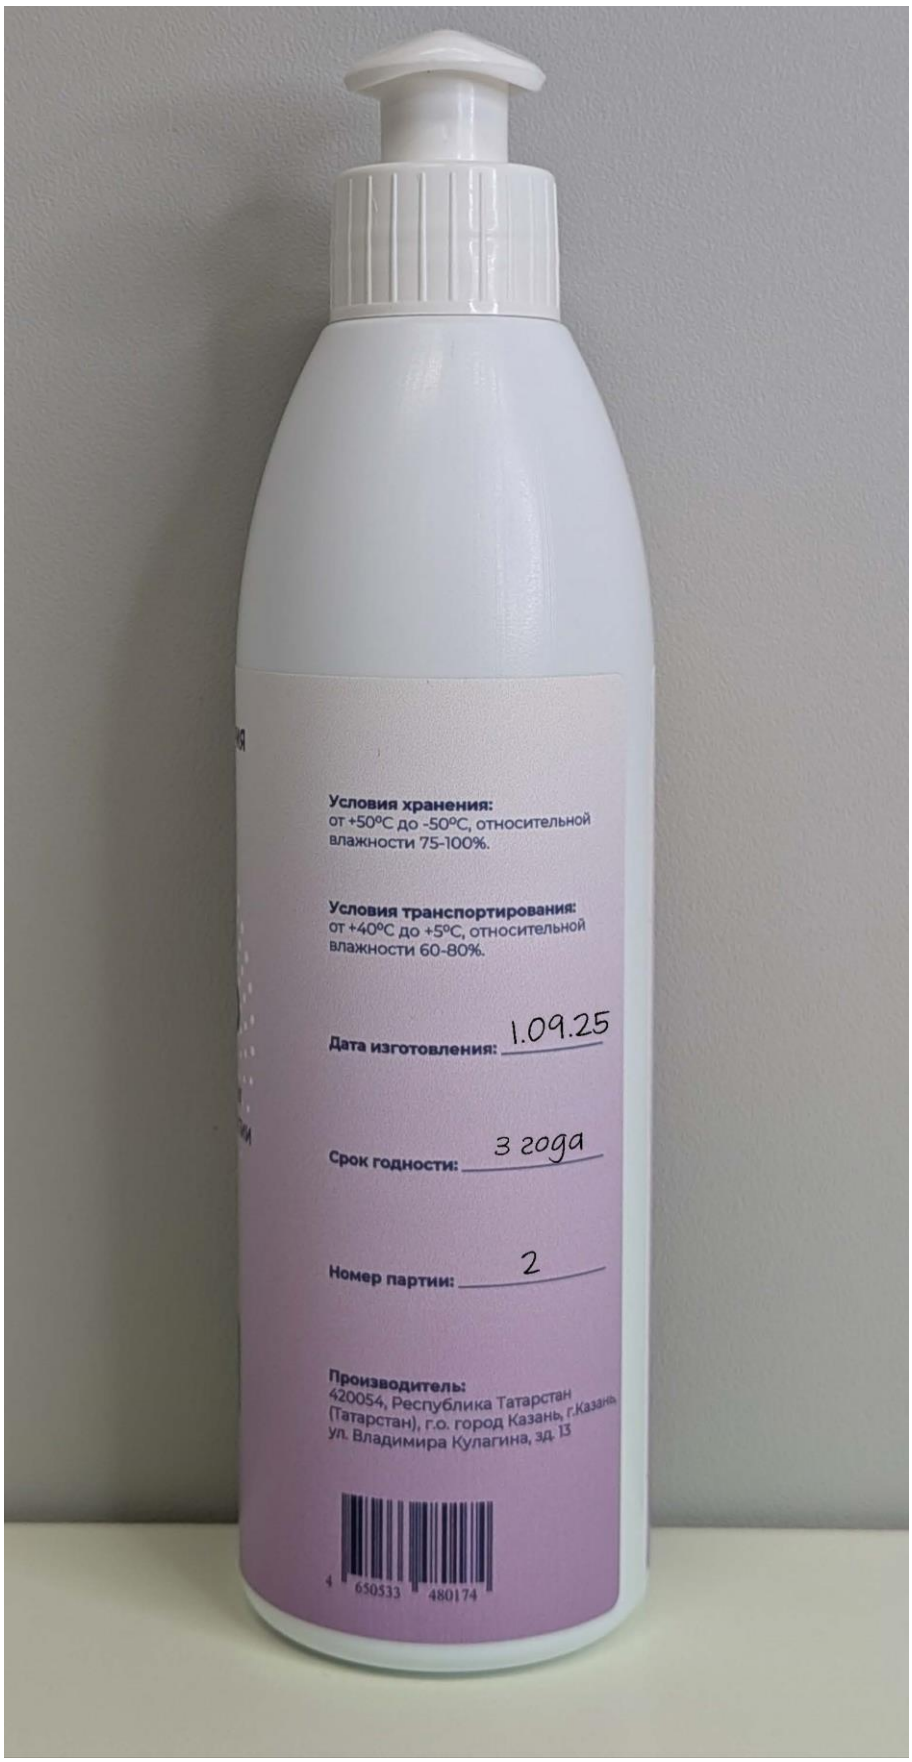

Рис. А.1.1.3- Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл

Рис. А.1.1.4- Маркировка дна потребительской (индивидуальной) упаковки. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл

,

Рис. А.1.2.1- Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл

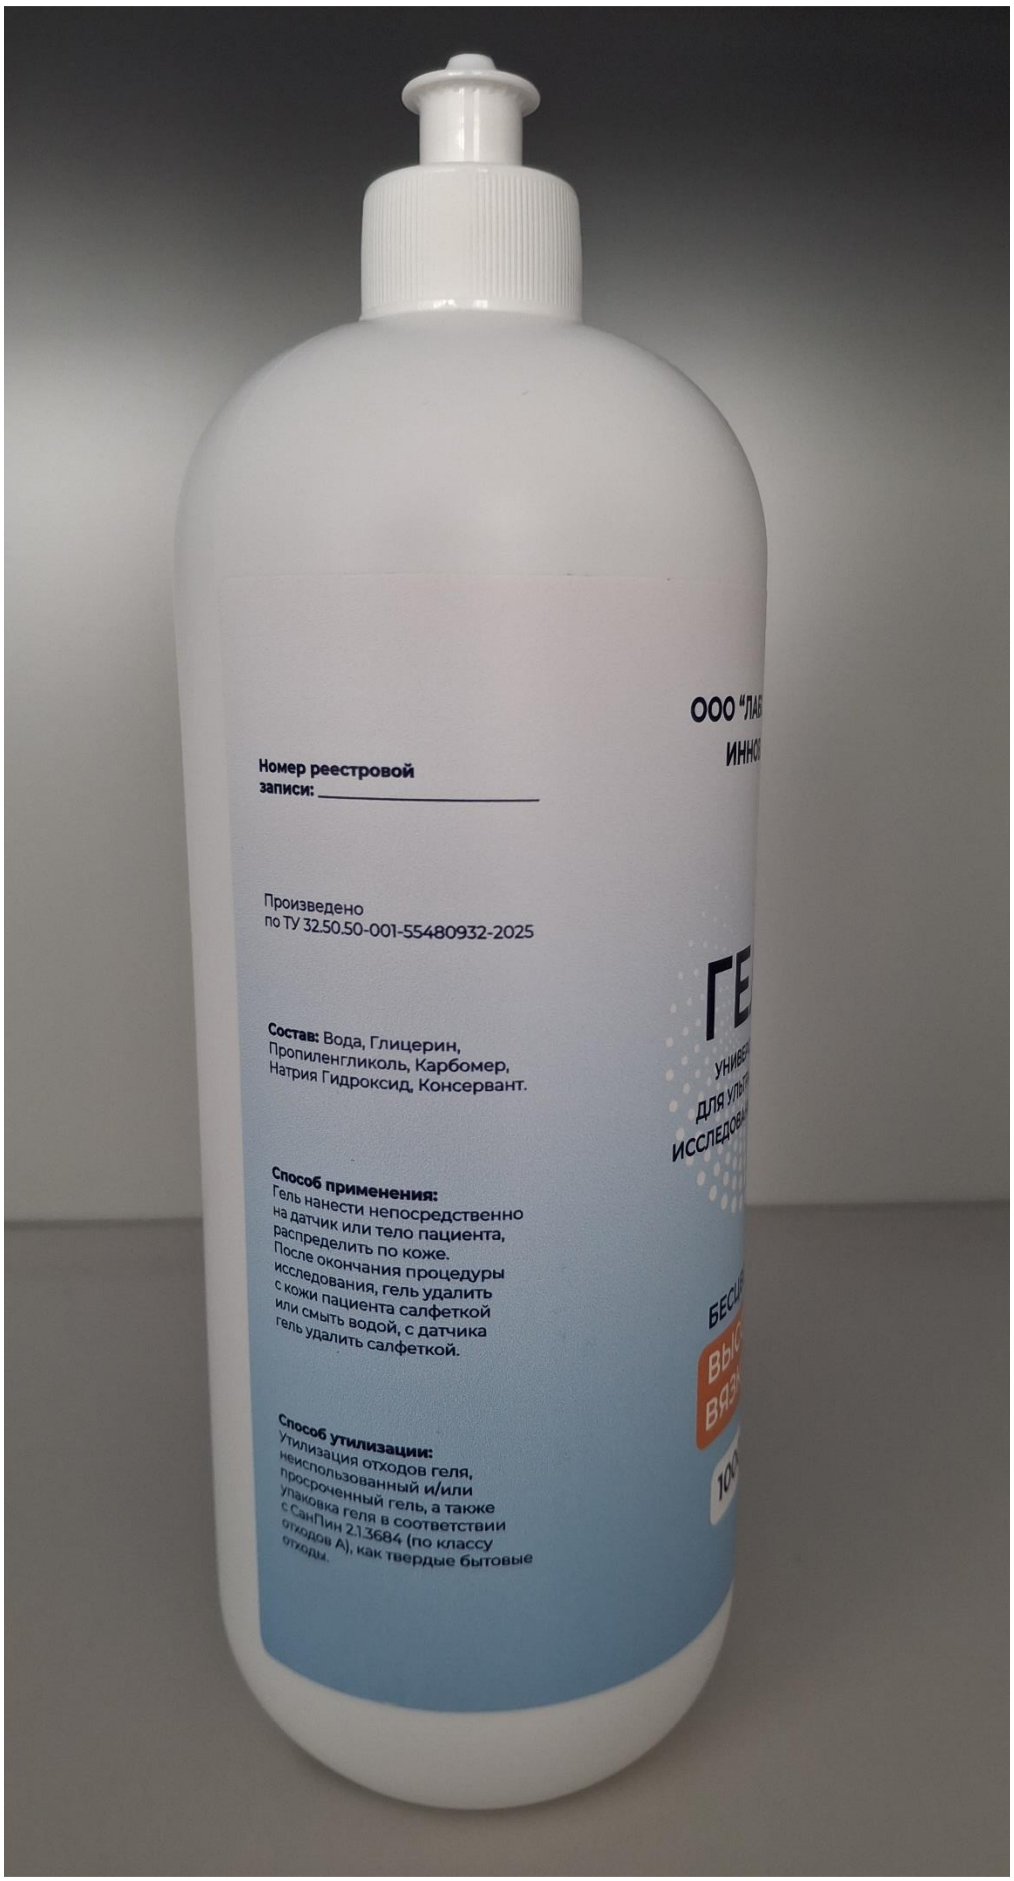

Рис. А.1.2.2- Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл

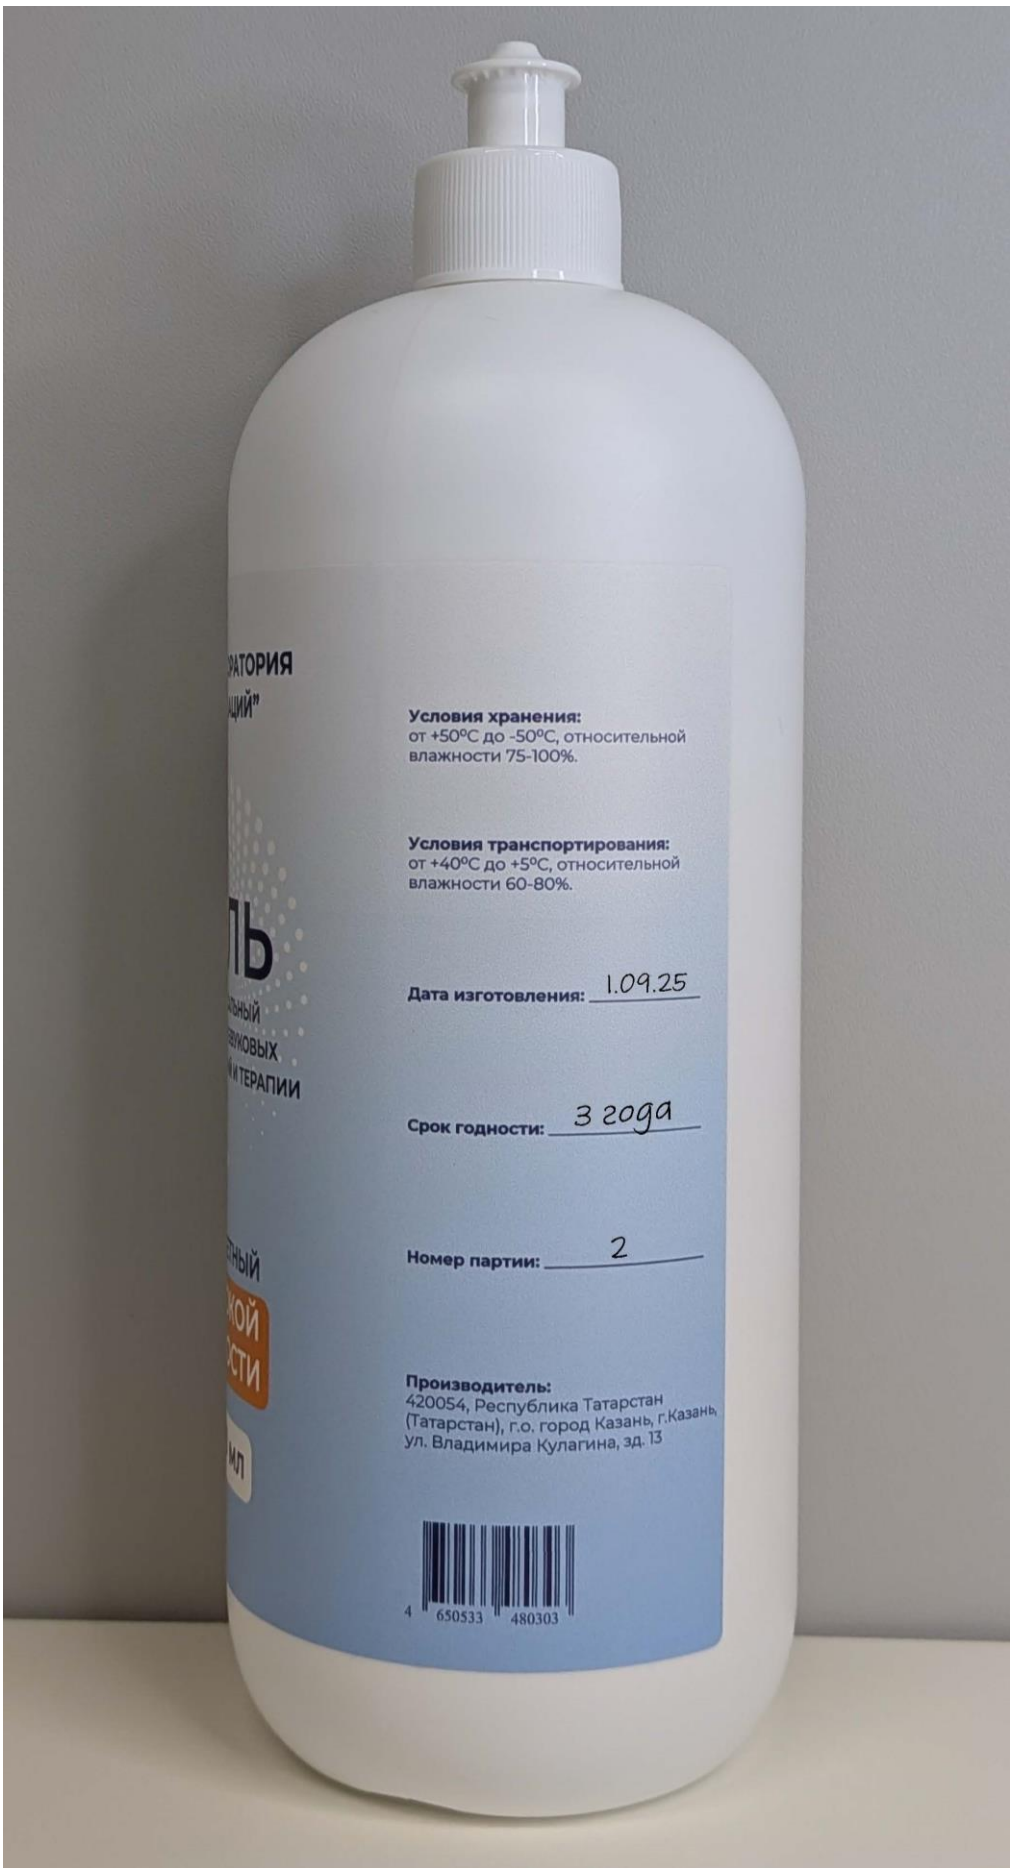

Рис. А.1.2.3- Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл

Рис. А.1.2.4- Маркировка дна потребительской (индивидуальной) упаковки. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл

Рис. А.1.3.1- Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный, объёмом 5000 мл

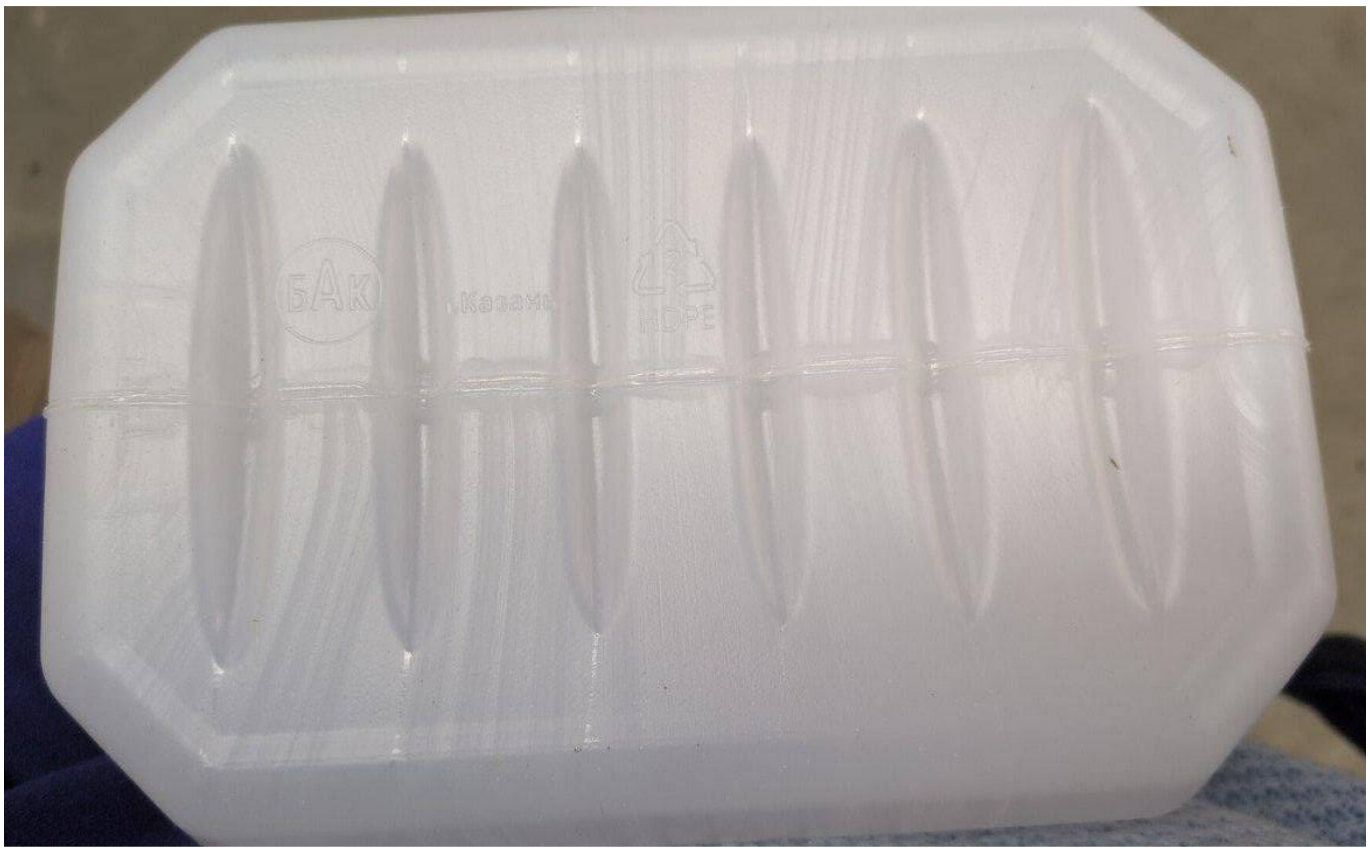

Рис. А.1.3.2- Маркировка дна потребительской (индивидуальной) упаковки. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный, объёмом 5000 мл

Рис. А.1.4.1- Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 1000 мл

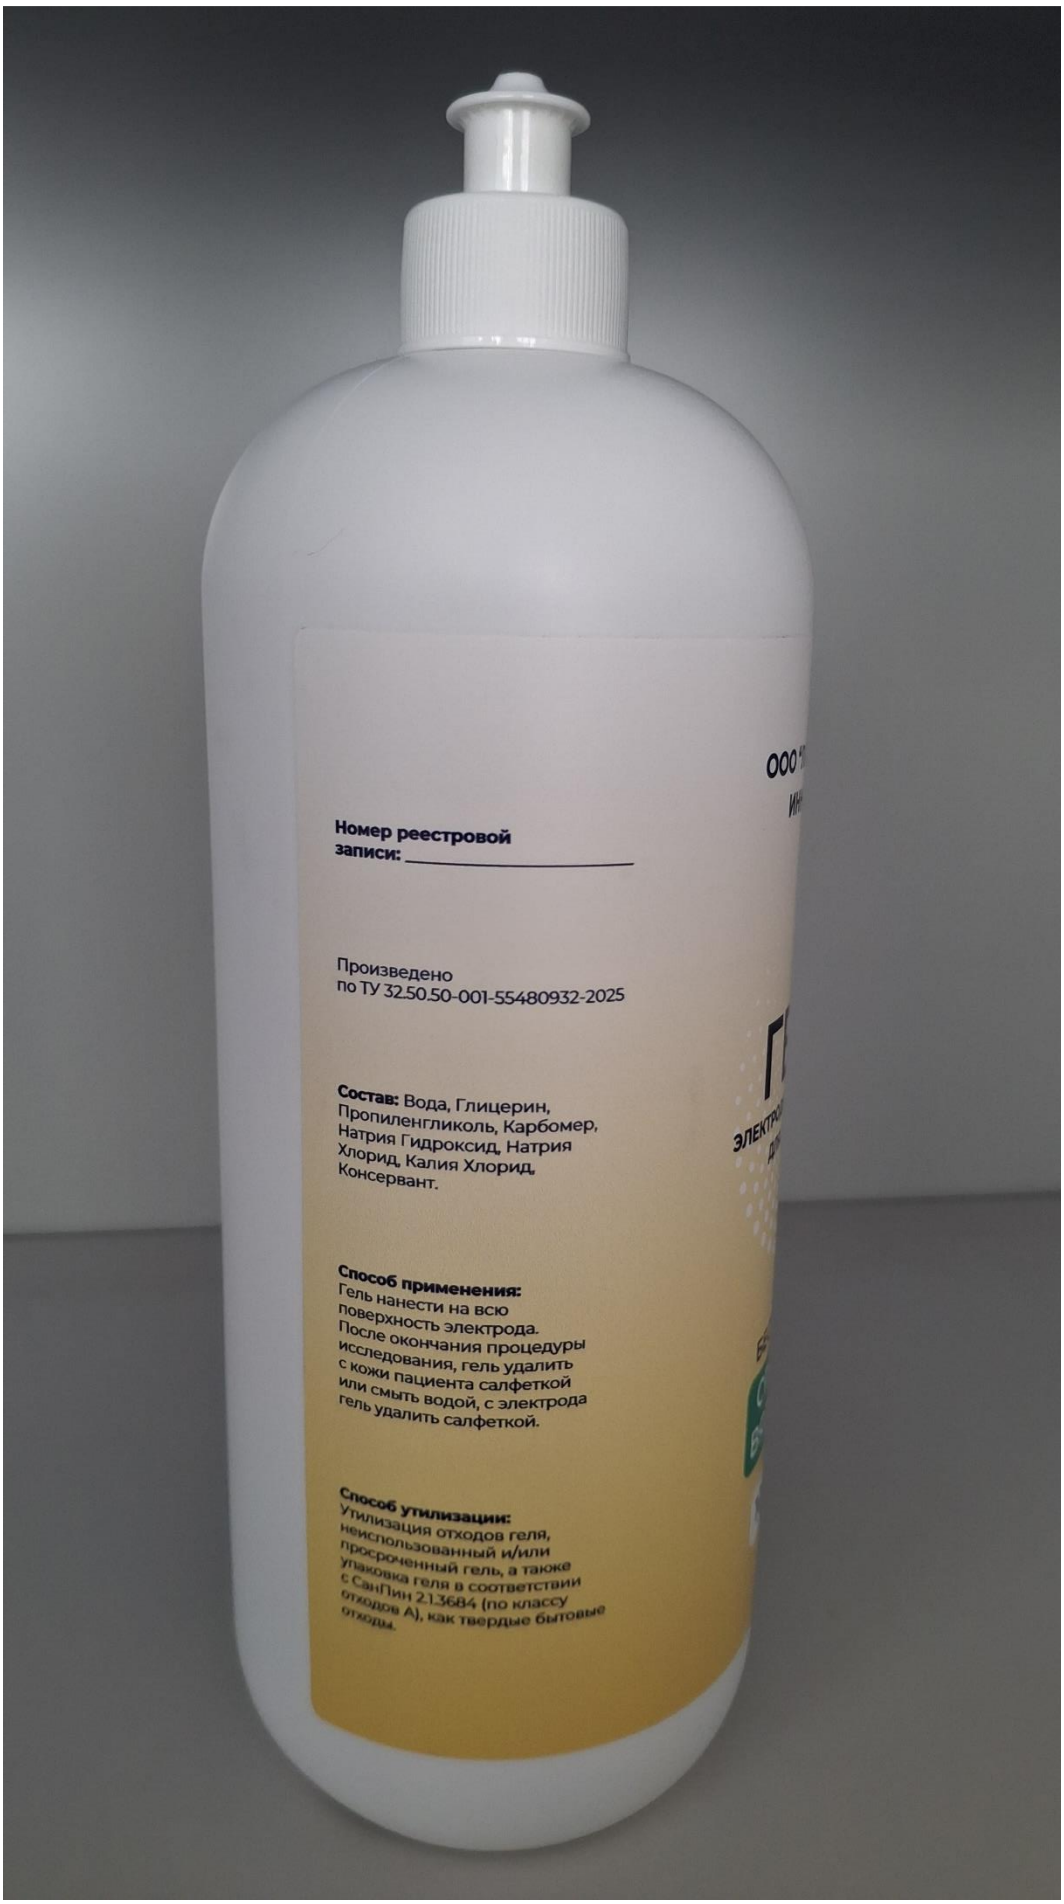

Рис. А.1.4.2- Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 1000 мл

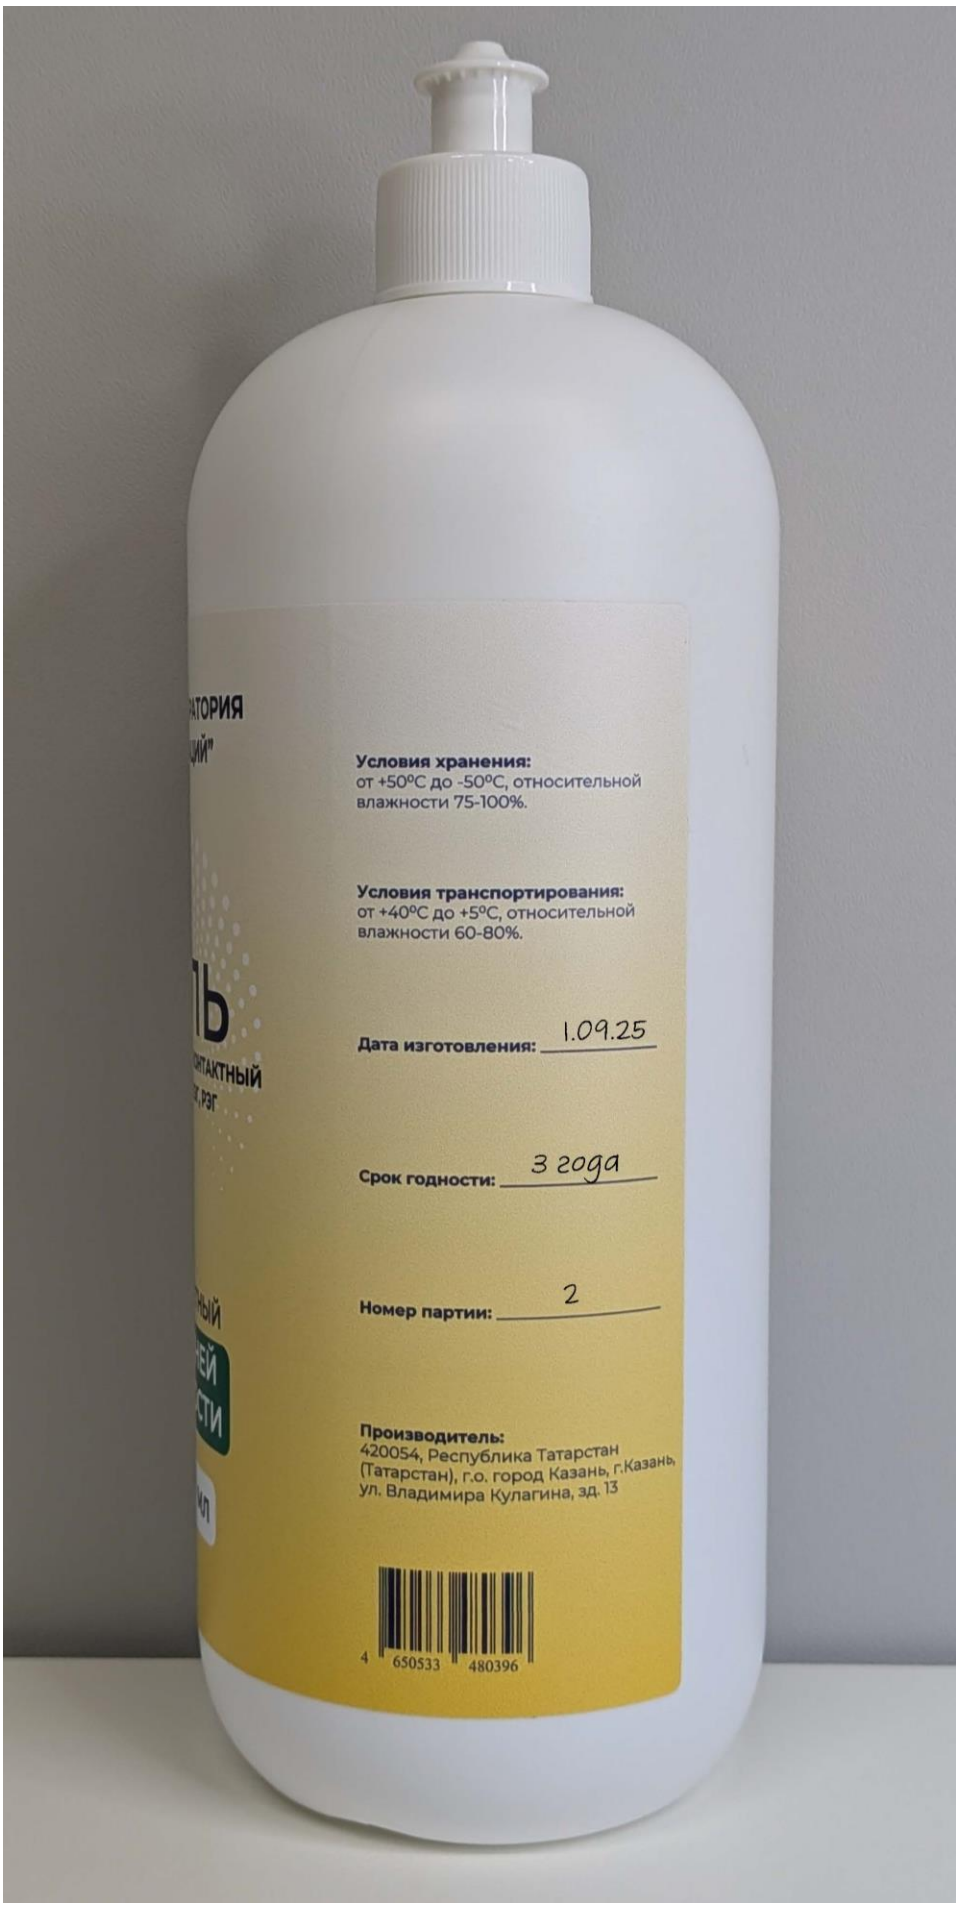

Рис. А.1.4.3- Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 1000 мл

Рис. А.1.4.4- Маркировка дна потребительской (индивидуальной) упаковки. Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 1000 мл

Рис. А.2.3- Транспортная упаковка и ее маркировка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ООО «АИЦ»)
Юридический адрес: 601655, Россия, Владимирская область, Александровский район, город Александров, улица Гагарина, дом 2, помещение 4
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»)
Адрес места осуществления деятельности: 601655, РОССИЯ, Владимирская область, район Александровский, город Александров, улица Гагарина, дом 2, этаж 1; 601655, РОССИЯ, Владимирская область, район Александровский, город Александров, улица Гагарина, дом 2, этаж 3, помещение 4 (архив лаборатории), (Архив); 142324, РОССИЯ, Московская область, район Чеховский, деревня Люторецкое, территория промзоны "Люторецкое", строение 4/1; 420051, РОССИЯ, Татарстан республика, район Зеленодольский, с/п Осиновское, промышленная площадка Индустриальный парк "М-7", здание № 7.
Телефон: +7 4922251150, +7 4922251160; адрес электронной почты: official@aic-lab.ru

Приложение Б

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Директор	Начальник
ООО «Лаборатория Инноваций»	ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»
А.И. Мишина	
(подпись) (инициалы, фамилия)	(подпись) (инициалы, фамилия)
_____ 20 _____	_____ 20 _____

ПРОГРАММА
технических испытаний медицинского изделия

Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025

(наименование медицинского изделия)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Объект испытаний

1.1.1	Наименование медицинского изделия	Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025
1.1.2	Наименование производителя (изготовителя) медицинского изделия	Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Инноваций» (ООО «Лаборатория Инноваций»)
1.1.3	Наименование и обозначение технической документации	ТУ 32.50.50-001-55480932-2025
1.1.4	Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	275460
1.1.5	Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	1
1.1.6	Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности	32.50.50.190
1.1.7	Назначение медицинского изделия, установленное производителем (изготовителем)	для применения в качестве высокоэффективной контактной среды для ультразвуковых исследований (ультразвуковой диагностики – УЗ-диагностика, ультразвуковой допплерографии сосудов – УЗДГ, эхокардиографии, ультразвуковой диагностики с эластографией), в терапии (электромиостимуляция, электрофорез) и для электрофизиологических исследований с применением электродов (снятие электрокардиограмм – ЭКГ, холтеровского мониторирования электрокардиограмм – ЭКГ в течении суток, велоэргометрии – ЭКГ во время физической нагрузки, электроэнцефалографии – ЭЭГ, реоэнцефалографии – РЭГ)

1.2 Цель испытаний

1.2.1 Проверка качества и безопасности медицинского изделия при использовании его в соответствии с назначением, предусмотренным документацией производителя (изготовителя) в целях государственной регистрации медицинского изделия или внесения изменений в регистрационное досье.

1.3 Место проведения испытаний

1.3.1 ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»)

1.4 Условия проведения испытаний

1.4.1 Нормальные климатические условия по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»:

- температура окружающей среды (25 ± 10) °С;
- относительная влажность воздуха (45 – 80) %;
- атмосферное давление (84,0 – 106,7) кПа / (630 – 800) мм рт. ст.

1.5 Комплектация медицинского изделия

№	Наименование медицинского изделия	Количество
1.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл	1 шт.
2.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл	1 шт.
3.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный, объёмом 5000 мл	1 шт.
4.	Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 1000 мл	1 шт.
5.	Инструкция по применению	1 шт.

1.6 Количество образцов, предоставляемых на испытания

1.6.1 Образец (образцы) медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению:

№	Наименование медицинского изделия, артикул, заводской номер (при наличии)	Номер партии/серии (при наличии)	Количество, шт./уп.	Дата изготовления	Условный номер образца
1.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл	2	1	1.09.2025	06102025/1
2.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/2
3.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный, объёмом 5000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/3
4.	Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 1000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/4

1.7 Нормативные документы, используемые при проведении испытаний:

Приказ Минздрава России от 30 августа 2021 года N 885н	Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. № 4н	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий
Приказ от 11 апреля 2025 года № 181н	Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия
ГОСТ 8.417-2024	Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ Р 58973-2020	Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 20790-93	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.

1.8 Сроки проведения испытаний

1.8.1 Технические испытания медицинских изделий проводятся испытательной организацией в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня предоставления заявителем в испытательную организацию образца (образцов) медицинского изделия, а также специального оборудования (при наличии), при условии оплаты заявителем услуг испытательной организации в соответствии с заключенным договором. Срок проведения технических испытаний по согласованию с заявителем может быть продлен руководителем испытательной организации не более чем на 20 рабочих дней.

2 СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

2.1.1 При проведении технических испытаний осуществляется:

№	Стадия технических испытаний	Нормативный документ	Объём работ
1.	Идентификация медицинского изделия	Документация СМК ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»	Проверка комплектности и полноты образца(ов) медицинского изделия Присвоение условного номера образцу(цам) медицинского изделия
2.	Определение и согласование с заявителем класса потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2012 г. № 4н	Определение класса потенциального риска применения медицинского изделия
3.	Анализ документов, представленных на испытания	Пункт 5 Приказа Минздрава России от 30 августа 2021 года N 885н Приказ Минздрава России от 11 апреля 2025 года № 181н ГОСТ 8.417-2024	Проверка комплектности документации Проверка полноты и объективности установленных в технической документации производителя (изготовителя) характеристик, подлежащих контролю при технических испытаниях, а также методов испытаний Соответствие единиц физических величин, регламентируемых в технических и эксплуатационных документациях
4.	Проведение испытаний образца (образцов) медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению	Утверждённая Программа технических испытаний	Соответствие медицинского изделия требованиям применимых документов национальной системы стандартизации, а также нормативной документации, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя)
5.	Оценка и анализ данных, относящихся к медицинскому изделию, для проверки его качества и	Утверждённая Программа технических испытаний	Соответствие качества медицинского изделия и безопасности его применения

№	Стадия технических испытаний	Нормативный документ	Объём работ
	безопасности		
6.	Оформление и выдача (вручение или направление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) заявителю акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия.	Приказ Минздрава России от 30 августа 2021 года N 885н	Оформление и отправка Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия

2.1.2 Объём технических испытаний

Проверка образцов на соответствие требованиям нормативной документации

1.	ГОСТ 20790-93 в соответствии с Областью аккредитации

Проверка характеристик образцов на соответствие требованиям технической документации

№	Проверяемая характеристика / параметр	Методика и условия проведения испытаний и измерений
1.	Внешний вид, цвет, запах	Визуальный контроль, органолептический метод (п. 4.4 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
2.	Водородный показатель pH	Физические измерения (п.4.5 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
3.	Вязкость, акустический импеданс, удельная электропроводность геля, коэффициент ослабления ультразвука в геле*	Сличение с документацией (п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.4.14 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
4.	Водорастворимость	Физико-механические испытания (п.4.9 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
5.	Масса потребительской тары, масса геля, объём геля в потребительской таре	Механические измерения (п.4.10 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
6.	Габаритные размеры потребительской тары	Механические измерения (п.4.12 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
7.	Материалы*	Сличение с документацией (п.4.13 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
8.	Устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании, хранении и эксплуатации*	Климатические испытания, сличение с документацией (п.4.15, п.4.16, п.4.17 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
9.	Устойчивость к воздействию механических факторов при эксплуатации, транспортировании	Вибрационные испытания (п.4.19, п.4.20 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
10.	Комплектность, маркировка, упаковка	Визуальный контроль (п.4.21 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)
11.	Проверка надёжности*	Сличение с документацией (п. 4.18 ТУ 32.50.50-001-55480932-2025)

** Проверка осуществляется путем рассмотрения предоставленных документов, подтверждающих проверяемые характеристики/параметры*

2.1.3 Перечень средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования, материалов

№ п/п	Наименование средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования, материалов
1.	Прибор комбинированный, Testo 622
2.	Климатическая камера REOCAM TCH-1000-EtEh
3.	Электропечь сопротивления низкотемпературная SNOL 120/300
4.	Установка испытательная вибрационная электродинамическая ВСВ-203-150
5.	Система управления виброиспытаниями ВС-207, модификации ВС-207.4
6.	Вибропреобразователь серии АР2037-10
7.	Мультиметр цифровой U1252B
8.	Секундомер электронный «Интеграл С-01»
9.	Весы лабораторные ВЛЭ-1023СI
10.	Весы лабораторные ВЛТЭ-8100Т
11.	Штангенциркуль ШЦ ШЦ-1-150-0,01
12.	Штангенциркуль ШЦ ШЦ-1-250-0,05
13.	Линейка измерительная металлическая 0-300 мм
14.	Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании Цилиндр 1-1000-2
15.	Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании Цилиндр 1-250-2
16.	Термометр инфракрасный Testo 830-T1
17.	pH-метр/ милливольтметр портативный МАРК-901
18.	Электрод стеклянный комбинированный ЭКС-1 модификации ЭСК-10601/7
19.	Промышленный автономный увлажнитель воздуха ГТ-3,2 (кубик)
20.	Промышленный автономный увлажнитель воздуха ГТ-3.0-2Т
21.	Каталог образцов цвета RAL-K-5 глянцевый
22.	Дистиллированная вода

Примечания:
1. Испытательное оборудование и средства измерения имеют действующие сроки поверки и аттестации.
2. Представленный список оборудования не является окончательным. При проведении технических испытаний может быть задействовано иное оборудование. Изменение в списке оборудования будет отражено в протоколе испытаний.

3 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

3.1.1 По результатам технических испытаний в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 885н от 30 августа 2021 года «Об утверждении Порядка проведения оценки соответствия медицинских изделий в форме технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний в целях государственной регистрации медицинских изделий» составляется Акт оценки результатов технических испытаний медицинского изделия в 3-х экземплярах.

3.1.2 Результаты технических испытаний оформляются в форме протоколов испытаний, оформленных в соответствии с ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Правила к оформлению протоколов испытаний» и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

3.1.3 Протокол(ы) испытаний является(ются) неотъемлемой частью Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия.

3.1.4 Программа технических испытаний медицинского изделия является неотъемлемой частью Акта оценки результатов технических испытаний медицинского изделия.

3.1.5 Отдельные пункты программы технических испытаний медицинского изделия в процессе

испытаний могут быть дополнены или изменены по решению комиссии.

Программу составил Инженер-испытатель ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»

_____

должность, фамилия, имя и отчество (при наличии)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ООО «АИЦ»)
Юридический адрес: 601655, Россия, Владимирская область, Александровский район, город Александров, улица Гагарина, дом 2, помещение 4
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР) РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ И БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
(ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»)
Адрес места осуществления деятельности: 601655, РОССИЯ, Владимирская область, район Александровский, город Александров, улица Гагарина, дом 2, этаж 1; 601655, РОССИЯ, Владимирская область, район Александровский, город Александров, улица Гагарина, дом 2, этаж 3, помещение 4 (архив лаборатории), (Архив); 142324, РОССИЯ, Московская область, район Чеховский, деревня Люторецкое, территория промзоны "Люторецкое", строение 4/1; 420051, РОССИЯ, Татарстан республика, район Зеленодольский, с/п Осиновское, промышленная площадка Индустриальный парк "М-7", здание № 7.
Телефон: +74922251150, +74922251160; адрес электронной почты: official@aic-lab.ru

Приложение В

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»

_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ 20 _____

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 27-25МИ

Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025

2025

1 Основные данные

1.1 Заказчик:

– наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Инноваций» (ООО «Лаборатория Инноваций»);

– реквизиты организации (ИНН): 1655505685;

– место нахождения (адрес юридического лица): 420054, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, зд. 13;

– фактический адрес места осуществления деятельности: ООО «Лаборатория Инноваций», 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 13;

– контактные данные: Тел. 8 (939) 346-14-67, 8 (995) 766-22-68 e-mail: razrabotkacosmetiki@mail.ru, linaprof@mail.ru.

1.2 Изготовитель:

– наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория Инноваций» (ООО «Лаборатория Инноваций»);

– место нахождения (адрес юридического лица): 420054, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, зд. 13;

– фактический адрес места осуществления деятельности (адрес места производства): ООО «Лаборатория Инноваций», 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 13.

1.3 Дата получения образца: 06.10.2025.

1.4 Основание для проведения испытаний (измерений): Заявка на проведение испытания продукции.

1.5 Цель проведения испытаний: Определение соответствия характеристик и свойств медицинского изделия требованиям:

– ТУ 32.50.50-001-55480932-2025 «Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения».

1.6 Место и дата(ы) проведения испытаний: Испытательная лаборатория (центр) радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью «Александровский испытательный центр» (ИЛ БРЭА ООО «АИЦ»). Адрес места проведения испытаний- РОССИЯ, Татарстан Республика, район Зеленодольский, с/п Осиновское, промышленная площадка Индустриальный парк "М-7", здание № 7, 07.10.2025 по 17.10.2025.

1.7 Сведения об отборе образца(ов):

– акт отбора образца(ов): -

– документ, определяющий правила и методы отбора образца: -

– место отбора: -

Образец предоставлен заказчиком. ИЛ БРЭА ООО «АИЦ» не несет ответственность за стадию отбора образца.

1.8 Документация, представленная на испытания:

– Заявка на проведение испытаний;
– Акт приема-передачи образцов;
– Сведения о нормативной документации;
– ТУ 32.50.50-001-55480932-2025;
– Инструкция по применению, версия 1 от 11.11.2025г.;
– Файл менеджмента риска, редакция 1 от 11.11.2025г.;
– Файл проектирования с учетом эксплуатационной пригодности № ФЭП.001-01/25, редакция 1 от 11.11.2025г.;
– Протокол № ПС.001-01/25 исследования стабильности от 12.11.2025г.;
– Акт № АКИ-001.01/25 и Протокол № ПКИ-001.01/25 квалификационных испытаний медицинского изделия от 11.11.2025г.;

- Протокол № 01/25 от 10.11.2025г.;
- Протокол № 05/25 от 12.11.2025г.;
- Протокол № 06/25 от 12.11.2025г.;
- Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B39694/24;
- Аналитический отчет, номер партии 2486443;
- Сертификат анализа, номер партии 20250506;
- Сертификат анализа, номер CAS 3844-45-9;
- Сертификат анализа № 2002750/120;
- Сертификат анализа, номер партии 241212F161;
- Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-BR.PA06.B.66362/24;
- Паспорт безопасности химической продукции ПБХП РБ 600122610-001-2022;
- Сертификат анализа № 2157362;
- Паспорт № 720;
- Удостоверение качества и безопасности № 00-00015511;
- Паспорт качества № 3457;
- Паспорт безопасности химической продукции ПБХПРБ 300042199.105-2014;
- Сертификат качества № 0802106647/900001;
- Лист безопасности 120-001-ЛПЭ;
- Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.00374/24;
- Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.42497/24;
- Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.43925/24;
- Паспорт № 328-2025;
- Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.51397/22;
- Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.89658/25;
- Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.86552/25;
- Протокол испытаний № 001/25 от 10.11.2025г.;
- Сертификат анализа на гранулы полиэтилена высокой плотности, номер партии 22L0342.

2 Наименование образца испытаний

Таблица 1 – Наименование образца (ов) испытаний

№	Наименование медицинского изделия, артикул, заводской номер (при наличии)	Номер партии/серии (при наличии)	Количество, шт./уп.	Дата изготовления	Условный номер образца
1.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл	2	1	1.09.2025	06102025/1
2.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объёмом 1000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/2
3.	Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный, объёмом 5000 мл	2	1	1.09.2025	06102025/3
4.	Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости,	2	1	1.09.2025	06102025/4

№	Наименование медицинского изделия, артикул, заводской номер (при наличии)	Номер партии/серии (при наличии)	Количество, шт./уп.	Дата изготовления	Условный номер образца
	бесцветный, объемом 1000 мл				

3 Процедура испытаний

3.1 Проверка работоспособности

Работоспособность образца соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду изделия.

3.2 Идентификация применяемого(ых) метода(ов):

Испытания проводились в соответствии утвержденной Программной технических испытаний, по методикам, изложенным в ТУ 32.50.50-001-55480932-2025.

4 Испытательное оборудование и средства измерений

4.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Испытательное оборудование и средства измерений

Наименование оборудования	Тип	Заводской № (инвентарный №)	Срок очередной поверки/ аттестации
Климатическая камера	REOCAM TCH-1000-EtEh	0820-368 (ИО/К.15)	12.03.2026
Электропечь сопротивления низкотемпературная	SNOL 120/300	960 (ИО/К.14)	11.03.2026
Установка испытательная вибрационная электродинамическая	ВСВ-203-150	644 (ИО/К.17)	13.03.2026
Система управления виброиспытаниями ВС-207	модификации ВС-207.4	207400607 (СИ/К.438)	24.03.2026
Вибропреобразователь	серии АР2037-10	21016 (СИ/К.435)	02.02.2026
Прибор комбинированный	Testo 622	39539986/1223 (СИ/К.440)	17.03.2026
Прибор комбинированный	Testo 622	39539961/1223 (СИ/К.441)	17.03.2026
Мультиметр цифровой	U1252B	MY54270138 (СИ/К.2)	14.10.2026
Секундомер электронный	«Интеграл С-01»	409677 (СИ/К.182)	14.11.2025
Весы лабораторные	ВЛЭ-1023СI	К351-002 (СИ/К.41)	27.12.2025
Весы лабораторные	ВЛТЭ-8100Т	J73-005 (СИ/К.40)	04.12.2025
Штангенциркуль ШЦ	ШЦ-1-150-0,01	63045788 (СИ/К.16)	29.09.2026
Штангенциркуль ШЦ	ШЦ-1-250-0,05	80081838 (СИ/К.17)	04.12.2025
Линейка измерительная металлическая	0-300 мм	143 (СИ/К.7)	27.12.2025
Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании	Цилиндр 1-1000-2	06.35864 (СИ/К.428)	клеймо на корпусе
Цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании	Цилиндр 1-250-2	06.31279 (СИ/К.417)	клеймо на корпусе
Термометр инфракрасный	Testo 830-T1	84379754 (СИ/К.100)	13.04.2026
pH-метр/ милливольтметр портативный	МАРК-901	2689 (СИ/К.227)	19.01.2026
Электрод стеклянный комбинированный ЭКС-1	модификации ЭСК-10601/7	12920 (СИ/К.247)	08.12.2025

4.2 Перечень вспомогательного оборудования и материалов приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Вспомогательное оборудование и материалы

Наименование оборудования и материалов	Тип	Заводской № (инвентарный №)
Промышленный автономный увлажнитель воздуха	ГТ-3,2 (кубик)	23-02534

Наименование оборудования и материалов	Тип	Заводской № (инвентарный №)
		(ВО/К.90)
Промышленный автономный увлажнитель воздуха	ГТ-3.0-2Т	23-02510 (ВО/К.91)
Каталог образцов цвета	RAL-K-5 глянцевый	б/н (ВО/К.78)
Дистиллированная вода	-	-

5 Результаты испытаний

5.1 Условия проведения испытаний

Адрес места осуществления деятельности:420051, РОССИЯ, Татарстан Республика, район Зеленодольский, с/п Осиновское, промышленная площадка Индустриальный парк "М-7", здание № 7.

Таблица 4 - Условия проведения испытаний

Наименование условий при испытании	Нормативное значение	Фактическое значение
Дата проведения испытаний	-	07.10.2025 – 17.10.2025
Температура окружающего воздуха, °С	15 – 35	22,4 – 23,8
Относительная влажность воздуха, %	45 – 80	48,4 – 59,8
Атмосферное давление, кПа	84,0 – 106,7	99,6 – 101,3
Напряжение сети электропитания, В	198 – 242 342 – 418	228,7 – 229,1 398,6 – 399,0
Частота переменного тока в сети электропитания, Гц	49 – 51	49,9 – 50,0

5.2 Проведены испытания по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025.

Таблица 5- Результаты испытаний

Пункты НД, содержащие требования	Нормы, которым должны соответствовать образцы	Результаты испытаний выборочных образцов	Вывод *
1	2	3	4
Проверка соответствия требованиям ТУ 32.50.50-001-55480932-2025			
1	**Технические требования**		
1.1	**Основные параметры и характеристики**		
1.1.1	Гель должен соответствовать требованиям настоящих технических условий, ГОСТ 20790 и изготавливаться по технологической документации (регламенту), утвержденной в установленном порядке.	Требование выполнено. Образцы соответствуют требованиям ТУ 32.50.50-001-55480932-2025, ГОСТ 20790-93.	С
1.1.2	Гель должен представлять собой однородную гелеобразную массу без посторонних примесей. Допускается наличие пузырьков воздуха.	Требование выполнено. Гель представляет собой однородную гелеобразную массу без посторонних примесей, имеются пузырьки воздуха.	С
1.1.3	Гель в зависимости от варианта исполнения должен быть бесцветным (прозрачным или слегка мутноватым) или цветным (слабоокрашенным, светло-голубым).	Требование выполнено. обр. №06102025/1 –цветной (светло-голубой); обр. №06102025/2 – бесцветный; обр. №06102025/3 – бесцветный; обр. №06102025/4 – бесцветный.	С
1.1.4	Гель должен обеспечивать смачиваемость поверхности кожи при распределении его путем легкого разглаживания, при этом гель не должен собираться в капли и скатываться с поверхности.	Требование выполнено. При распределении 10 мл геля по поверхности листа бумаги гель не	С

<table>
<tr><td></td><td></td><td>собирается в капли, не скатывается с поверхности.</td><td></td></tr>
<tr><td>1.1.5</td><td>Органолептические и физико-химические показатели геля должны соответствовать указанному в таблице 1.
Таблица 1
<table>
<tr><th rowspan="2">Наименование показателя</th><th colspan="2">Характеристики (норма)</th></tr>
<tr><th>Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии</th><th>Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ</th></tr>
<tr><td>Водородный показатель pH</td><td colspan="2">6,0 - 8,0</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">без запаха</td></tr>
<tr><td>Водорастворимость</td><td colspan="2">полная</td></tr>
<tr><td colspan="3">Вязкость геля по Брукфильду, Па·с (при +23°С):</td></tr>
<tr><td>- гель низкой вязкости</td><td colspan="2">9-18 (скорость сдвига (7,5±0,05) $с^{-1}$)</td></tr>
<tr><td>- гель средней вязкости</td><td colspan="2">18-23 (скорость сдвига (7,5±0,05) $с^{-1}$)</td></tr>
<tr><td>- гель высокой вязкости</td><td colspan="2">23-31 (скорость сдвига (7,5±0,05) $с^{-1}$)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Акустический импеданс, г/$см^2$·с:</td></tr>
<tr><td>- гель низкой вязкости</td><td>от $1,51\times10^5$ до $1,58\times10^5$</td><td>---</td></tr>
<tr><td>- гель средней вязкости</td><td>от $1,52\times10^5$ до $1,58\times10^5$</td><td>---</td></tr>
<tr><td>- гель высокой вязкости</td><td>от $1,53\times10^5$ до $1,58\times10^5$</td><td>---</td></tr>
<tr><td colspan="3">Удельная электропроводность, см/м:</td></tr>
<tr><td>- гель низкой вязкости</td><td>---</td><td>0,2-0,6</td></tr>
<tr><td>- гель средней вязкости</td><td>---</td><td>0,2-0,6</td></tr>
<tr><td>- гель высокой вязкости</td><td>---</td><td>0,2-0,6</td></tr>
</table></td><td>Требование выполнено.
Водородный показатель pH:
обр. №06102025/1 – 7,022;
обр. №06102025/2 – 7,030;
обр. №06102025/3 – 6,563;
обр. №06102025/4 – 6,702.
Для проверки водорастворимости 5 г образца перемешивали со 100 мл дистиллированной воды. Полученный раствор выдержали при температуре 37 °С в течении 2 ч, перемешивая его каждые 30 мин.
После окончания выдержки зафиксировано полное растворение геля, отсутствие осадка и остатков геля.
Водородный показатель pH полученного раствора из образца:
обр. №06102025/1 – 7,590;
обр. №06102025/2 – 7,808;
обр. №06102025/3 – 7,476;
обр. №06102025/4 – 7,610.
Образцы смывали струёй воды со стеклянной 30 с; следы, плёнка на поверхности не остаются.
Соответствие вязкости геля, акустического импеданса, удельной электропроводности представленным в таблице 1 требованиям подтверждается документацией, предоставленной заказчиком:
1. Протокол №01/25 от 10.11.2025;
2. Протокол №05/25 от 12.11.2025;
3. Протокол №06/25 от 12.11.2025;
4. Акт № АКИ-001.01/25 и Протокол № ПКИ-001.01/25 квалификационных испытаний медицинского изделия от 11.11.2025г.</td><td>С</td></tr>
<tr><td>1.1.6</td><td>Масса геля в потребительской таре должна быть:
- в бутылке объемом 250 мл – (0,25±0,01) кг;
- в бутылке объемом 1000 мл – (1,00±0,05) кг;
- в канистре объемом 5000 мл – (5,00±0,1) кг.</td><td>Требование выполнено.
Масса геля в потребительской таре, кг:
обр. №06102025/1 – 0,247;
обр. №06102025/2 – 0,996;
обр. №06102025/3 – 4,963;
обр. №06102025/4 – 1,000.</td><td>С</td></tr>
<tr><td>1.1.7</td><td>Массогабаритные размеры потребительской тары должны соответствовать указанному в таблице 2.
Таблица 2
<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Объем, $дм^3$</th><th>Высота, мм</th><th>Длина, мм</th><th>Ширина, мм</th><th>Диаметр, мм</th><th>Диаметр горловины, мм</th><th>Масса, кг</th></tr>
<tr><td>Бутылка объем</td><td>0,250±0,03</td><td>171,5±1</td><td>---</td><td>---</td><td>50,5±0,7</td><td>23,5±0,4</td><td>0,026±0,003</td></tr>
</table></td><td>Требование выполнено. Результаты представлены в Приложении 1.</td><td>С</td></tr>
</table>

ом 250 мл							
Бутылка объемом 1000 мл	*1±0,05*	*227±3*	---	---	*82±3*	*27±0,5*	*0,066±0,005*
Канистра объемом 5000 мл	*5±0,3*	*275±3*	*190±2*	*130±2*	---	*37±0,5*	*0,15±0,03*
Укупорочное средство на бутылку объемом 250 мл	---	*32,9±1*	---	---	*27,4±1*	---	*0,004±0,0005*
Укупорочное средство на бутылку объемом 1000 мл	---	*37±2*	---	---	*32±2*	---	*0,0035±0,0005*
Укупорочное средство на канистру объемом 5000 мл	---	*23±1*	---	---	*44±0,15*	----	*0,0065±0,0005*

Минимальная толщина стенки тары должна быть не менее 0,2 мм.

1.1.8	Для изготовления изделия, должны быть использованы материалы и компоненты, разрешенные в установленном порядке к применению в медицинской практике в Российской Федерации. Перечень материалов и компонентов, используемых при изготовлении изделия, должен соответствовать указанному в таблицах 3 и 4. Таблица 3. Компоненты, используемые при изготовлении геля	Требование выполнено. Подтверждается документацией, предоставленной заказчиком: 1. Протокол испытаний № 001/25 от 10.11.2025г.; 2. Сертификат анализа № 2002750/120; 3. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-BR.PA06.B.66362/24; 4. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.00374/24; 5. Паспорт №720; 6. Сертификат анализа № 2157362; 7. Сертификат анализа, номер CAS 3844-45-9; 8. Сертификат анализа, номер партии 241212F161; 9. Аналитический отчет, номер партии 2486443; 10. Сертификат анализа, номер партии 20250506; 11. Удостоверение качества и безопасности № 00-00015511;	С

Наименование компонента	***Наименование Компонента в составе (эксплуатационной документации)***	***Производитель / Нормативный документ***	***Содержание компонента, %***
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA*	*3,0 ± 2,0*

сверхчистый марки 99,8%		*AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, цветной			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Краситель Синий блестящий, цвет – 901	*Краситель*	*ГОСТ 32745 / Koel Colours Pvt Ltd, Индия*	*0,001 ± 0,0005*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*

12. Паспорт безопасности химической продукции ПБХПРБ 300042199.105-2014;
13. Сертификат качества № 08002106647/900001;
14. Паспорт качества №3457;
15. Сертификат анализа на гранулы полиэтилена высокой плотности, номер партии 22L0342;
16. Лист безопасности 120-001-ЛПЭ;
17. Паспорт безопасности химической продукции ПБХПРБ 300042199.105-2014;
18. Акт № АКИ-001.01/25 и Протокол № ПКИ-001.01/25 квалификационных испытаний медицинского изделия от 11.11.2025г.

Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Краситель Синий блестящий, цвет – 901	*Краситель*	*ГОСТ 32745 / Koel Colours Pvt Ltd, Индия*	*0,001 ± 0,0005*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный, с Д-пантенолом			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Д-пантенол	*Д-пантенол*	*XINFA PHARMACEUTICAL CO.,LTD, Китай*	*0,5 ± 0,2*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный, с соком Алоэ Вера			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*

Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Алоэ вера гель	*Сок листьев алоэ Барбаденсис*	*Provital, S.A., Испания*	*0,5 ± 0,2*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный, с Аллантоином			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Аллантоин	*Аллантоин*	*WUHAN ONER CHEMICAL CO., LTD., Китай*	*0,3 ± 0,1*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, цветной			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA*	*3,0 ± 2,0*

		E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия	
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Краситель Синий блестящий, цвет – 901	*Краситель*	*ГОСТ 32745 / Koel Colours Pvt Ltd, Индия*	*0,001 ± 0,0005*
Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, низкой вязкости, бесцветный			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Соль пищевая выварочная сорт экстра	*Натрия хлорид*	*ГОСТ 51574 / ОАО «Мозырьсоль», Беларусь*	*0,015 ± 0,01*
Калий хлористый	*Калия хлорид*	*ГОСТ 4568 / ОАО «Беларуськалий», Беларусь*	*0,02 ± 0,01*
Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY*	*3,0 ± 2,0*

		(DONGYING) CO LTD., Китай	
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Соль пищевая выварочная сорт экстра	*Натрия хлорид*	*ГОСТ 51574 / ОАО «Мозырьсоль», Беларусь*	*0,015 ± 0,01*
Калий хлористый	*Калия хлорид*	*ГОСТ 4568 / ОАО «Беларуськалий», Беларусь*	*0,02 ± 0,01*
Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, высокой вязкости, бесцветный			
Вода	*Вода*	*ГОСТ Р 58144*	*До 100*
Карбомер	*Карбомер*	*SNF, Франция*	*0,7 ± 0,3*
Глицерин	*Глицерин*	*ГОСТ 6824 / MERIDIONAL TCS INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS S/A, Бразилия*	*3,0 ± 2,0*
Пропиленгликоль сверхчистый марки 99,8%	*Пропиленгликоль*	*ГОСТ 10136 / SHINGHWA AMPEREX TECHNOLOGY (DONGYING) CO LTD., Китай*	*3,0 ± 2,0*
Натр едкий (Натрий гидроксид)	*Натрия гидроксид*	*ГОСТ 4328 / АО «Каустик», Россия*	*1,0 ± 0,5*
EVAGUARD® 100 (Феноксиэтанол и этилгексилглицерин)	*Консервант*	*ООО «ЭВА», Россия*	*0,9 ± 0,1*
Соль пищевая выварочная сорт экстра	*Натрия хлорид*	*ГОСТ 51574 / ОАО «Мозырьсоль», Беларусь*	*0,015 ± 0,01*
Калий хлористый	*Калия хлорид*	*ГОСТ 4568 / ОАО «Беларуськалий», Беларусь*	*0,02 ± 0,01*

Таблица 4. Материалы используемые при изготовлении изделия

Наименование материала	***Производитель / Нормативный документ***	***Наименование изделия***
Полиэтилен, марка HD 10530 LB	*ООО «ЗапСибНефтехим», Россия / ТУ 20.16.10-006-81060768-2018 с изм. 1-15*	*бутылка объемом 1000 мл; канистра объемом 5000 мл.*
Полиэтилен высокого давления марки 15803-020	*ОАО «Нафтан», Беларусь / ГОСТ 16337*	*бутылка объемом 250 мл;*

	Полиэтилен низкого давления (HDPE), марка BL6200	*JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC / Узбекистан*	*Укупорочное средство на бутылку объемом 250 мл; Укупорочное средство на бутылку объемом 1000 мл.*		
	Полиэтилен, марка HD 10530 LB	*ООО «ЗапСибНефтехим», Россия / ТУ 20.16.10-006-81060768-2018 с изм. 1-15*	*укупорочное средство на канистру объемом 5000 мл*		
	Концентрат Tofill™ 120-001-ЛПЭ белый	*ООО «ТОХОМ», Россия*			
1.1.9	Ослабление ультразвукового сигнала (коэффициент затухания ультразвука в геле) при толщине слоя геля 2 мм не должно превышать 1,0 дБ/см при 4,7 МГц и 2,0 дБ/см при 14,4 МГц (только для геля универсального для ультразвуковых исследований и терапии).		Требование выполнено. Подтверждается документацией, предоставленной заказчиком: 1. Акт № АКИ-001.01/25 и Протокол № ПКИ-001.01/25 квалификационных испытаний медицинского изделия от 11.11.2025г.	С
1.1.10	Изделие при эксплуатации должно выдерживать воздействие климатических факторов по ГОСТ 15150 для исполнения категории УХЛ 4.2.		Требование выполнено. Образцы климатического исполнения УХЛ 4.2 поместили в климатическую камеру. Выдержали при температуре +35°С 2 часа с момента достижения рабочего режима. Выдержали при температуре +10°С 2 часа с момента достижения рабочего режима. Выдержали при относительной влажности 80% при 25 °С в течении 2 часов с момента достижения рабочего режима. По окончанию испытаний образцы не имеют механических дефектов и нарушений внешнего вида.	С
1.1.11	Изделие при транспортировании должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150, для группы условий хранения 5.		Требование выполнено. Образцы в транспортной упаковке поместили в климатическую камеру. При транспортировании климатическое исполнение 5(ОЖ4): Выдержали: - при температуре -50°С 2 часа с момента достижения рабочего режима, после выдержали в нормальных климатических условиях в течении 12 ч; - при t° +50°С 2 часа с момента достижения рабочего режима, после выдержали в нормальных климатических условиях в течении 12 ч. По окончанию испытаний образцы не имеют механических дефектов и нарушений внешнего вида; образцы соответствуют требованиям п.1.1.2, 1.1.3 настоящих ТУ. Образцы выдержали в климатической камере при	С

		относительной влажности 93% при 40 °С в течении 16 часов с момента достижения рабочего режима, после выдержаны при температуре 35°С в течении 8 часов при относительной влажности 95-100%. Выполнено 4 цикла. После выдержаны при нормальных климатических условиях в течении 12 часов. По окончанию испытаний целостность транспортной упаковки не нарушена, образцы не имеют механических дефектов и нарушений внешнего вида, образцы соответствуют требованиям п.1.1.2, 1.1.3. Соответствие вязкости, акустического импеданса, удельной электропроводности после проведения испытаний на устойчивость к воздействию климатических факторов при транспортировании – подтверждается документацией, предоставленной заказчиком: 1. Протокол №06/25 от 12.11.2025.	
1.1.12	Изделие при хранении должно быть устойчиво к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150, для группы условий хранения 1 (Л).	Требование выполнено. Образцы в транспортной упаковке поместили в климатическую камеру. При хранении климатическое исполнение 1Л: Выдержали: - при температуре +5°С 2 часа с момента достижения рабочего режима, после выдержали в нормальных климатических условиях в течении 12 ч; - при t° +40°С 2 часа с момента достижения рабочего режима, после выдержали в нормальных климатических условиях в течении 12 ч. Образцы выдержали в климатической камере при относительной влажности 80% при 25 °С в течении 16 часов с момента достижения рабочего режима, после выдержаны в нормальных климатических условиях в течении 12 часов. По окончанию испытаний целостность транспортной упаковки не нарушена, образцы не имеют механических дефектов и нарушений внешнего вида, образцы соответствуют требованиям п.1.1.2, 1.1.3. Соответствие вязкости, акустического импеданса,	С

		удельной электропроводности после проведения испытаний на устойчивость к воздействию климатических факторов при хранении подтверждается документацией, предоставленной заказчиком: 1. Протокол №06/25 от 12.11.2025.	
1.1.13	Средний срок службы изделия –3 года с даты изготовления. Критерием отказа является несоответствие изделия п. 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.5.	Требование выполнено. Подтверждается документацией, предоставленной заказчиком: 1. Протокол № ПС.001-01/25 исследования стабильности «Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025».	С
1.1.14	Изделие при эксплуатации и транспортировании должно быть устойчиво к механическим воздействиям по ГОСТ 20790 для изделий группы 3.	Требование выполнено. Режимы испытаний: - начальная амплитуда: 0,35 мм; - начальная частота: 10 Гц; - конечная амплитуда: 0,35 мм; - конечная частота: 55 Гц; - число проходов профиля: 10; - выбор порядка проходов: Начало-Конец-Начало; - скорость: 1 окт/мин. После испытаний целостность упаковки не нарушена.	С
1.2	**Комплектность**		
1.2.1	В комплект поставки изделия должны входить: - гель в потребительской упаковке одного варианта исполнения – 1 шт.; - инструкция по применению – 1 шт.	Требование выполнено. Комплектация представлена в п.1.5 Программы технических испытаний.	С
1.3	**Маркировка**		
1.3.1	Маркировка изделия должна соответствовать требованиям настоящих технических условий. На этикетках могут быть использованы необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.	Требование выполнено. Маркировка соответствует настоящему техническому условию.	С
1.3.2	*На потребительской (индивидуальной) упаковке геля должно быть указано:* *- наименование и адрес предприятия-изготовителя;* *- наименование варианта исполнения изделия;* *- обозначение настоящих технических условий;* *- номер реестровой записи;* *- способ применения;* *- состав геля;* *- номер партии (код);* *- дата изготовления;* *- информацию о сроке годности;* *- условия хранения и транспортирования;* *- правила утилизации;* *- объем;* *- штрих-код;* *- дополнительная информация для потребителя (при необходимости).*	Требование выполнено. Информация имеется.	С

1.3.3	На дне или нижней части корпуса потребительской (индивидуальной) упаковки геля имеется маркировка: символ «Петля Мебиуса» с указанием обозначения материала.	Требование выполнено. Информация имеется.	С
1.3.4	Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 и должна содержать: - наименование и адрес предприятия-изготовителя; - наименование медицинского изделия; - обозначение настоящих технических условий; - габаритные размеры транспортной упаковки; - масса брутто и нетто транспортной упаковки; - символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1: «Изготовитель», «Не допускать воздействия влаги», «Не допускать воздействия солнечного света», «Хрупкое, обращаться осторожно», «Температурный диапазон»; - манипуляционные знаки по ГОСТ 14192: «Верх», «Предел по количеству ярусов в штабеле»; - грузополучатель; - пункт назначения; - пункт перегрузки; - место для надписей транспортных организаций; - брутто, кг; - нетто, кг; - габаритные размеры упаковки, см. Символы, применяемые на маркировке: 	Требование выполнено. Информация имеется. Символ «Петля Мебиуса» с указанием обозначения материала – требование не применимо к образцам.	С НП
1.4	**Упаковка**		
1.4.1	Гель должен быть расфасован в потребительскую (индивидуальную) упаковку (полимерные бутылки объемом 250 мл / 1000 мл и канистры объемом 5000 мл по ГОСТ 33756 с укупорочными средствами по ГОСТ 32626).	Требование выполнено. Подтверждается документацией, предоставленной заказчиком: 1. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.42497/24; 2. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA03.B.43925/24; 3. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-CN.PA07.B.51397/22; 4. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.89658/25; 5. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.86552/25.	С
1.4.2	Для транспортирования изделие в потребительской (индивидуальной) упаковке должны быть уложены в транспортную упаковку из гофрированного картона ГОСТ 9142. Швы коробок должны быть сшиты или склеены.	Требование выполнено. Подтверждается документацией, предоставленной заказчиком: 1. Декларация о соответствии, № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B39694/24.	С

1.4.3	Масса транспортной тары (брутто) должна быть не более 32 кг.	Требование выполнено. Масса транспортной тары (брутто) составляет 7,788 кг.	С
1.4.4	Масса транспортной тары (нетто) должна быть не более 31 кг.	Требование выполнено. Масса транспортной тары (нетто) составляет 7,254 кг.	С
1.4.5	Габаритные размеры транспортной тары должны быть, не более (Д×Ш×В): 48×32×35 см.	Требование выполнено. Габаритные размеры транспортной тары: 25,9×19,6×28,9 см.	С

Примечание:
Условное обозначение:
«С» – соответствует требованиям нормативно-технической документации.
«Н» – не соответствует требованиям нормативно-технической документации.
«НП» – требование не применимо к образцам.
«-» – требование не проверялось в рамках проведения технических испытаний.

6 Дополнения, отклонения или исключения из метода

Дополнения, отклонения или исключения из метода отсутствуют.

7 Результаты, полученные от внешних поставщиков

Результаты, полученные от внешних поставщиков, отсутствуют.

8 Заключение о соответствии

Испытанный(е) образец(цы) медицинского изделия СООТВЕТСТВУЕТ(ЮТ) требованиям:

1. ТУ 32.50.50-001-55480932-2025 «Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения».

9 Дополнительная информация

9.1 Настоящий протокол не является сертификатом соответствия продукции в области безопасности оборудования.

9.2 Полученные результаты, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

9.3 Если специально не оговорено, настоящий протокол предназначен только для использования заказчиком.

9.4 Страницы с изложением результатов испытаний (измерений) не могут быть использованы отдельно без полного протокола об испытаниях.

9.5 Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

9.6 В случае проверки выполнения требований, установленных к объекту испытаний, проверки параметров (показателей), предусматривающих осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, и при этом нормативный документ на метод / методику испытаний, включающий в себя осмотр объекта испытаний, визуальное определение параметра (характеристики, состояния) или измерения, не предусмотрен перечнем стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, обозначение НД на метод / методику испытаний не указывается.

9.7 Протокол об испытаниях составлен с учетом требований руководства по качеству ИЛ БРЭА ООО «АИЦ».

9.8 Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний, могут быть забраны заказчиком в течение 14 календарных дней с момента выдачи протокола, после чего ИЛ БРЭА ООО «АИЦ» не несет ответственность за их сохранность.

Испытания провел (а):

Инженер-испытатель _____ _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата выдачи протокола: _____ 20 _____.

Приложение 1

Результаты испытаний

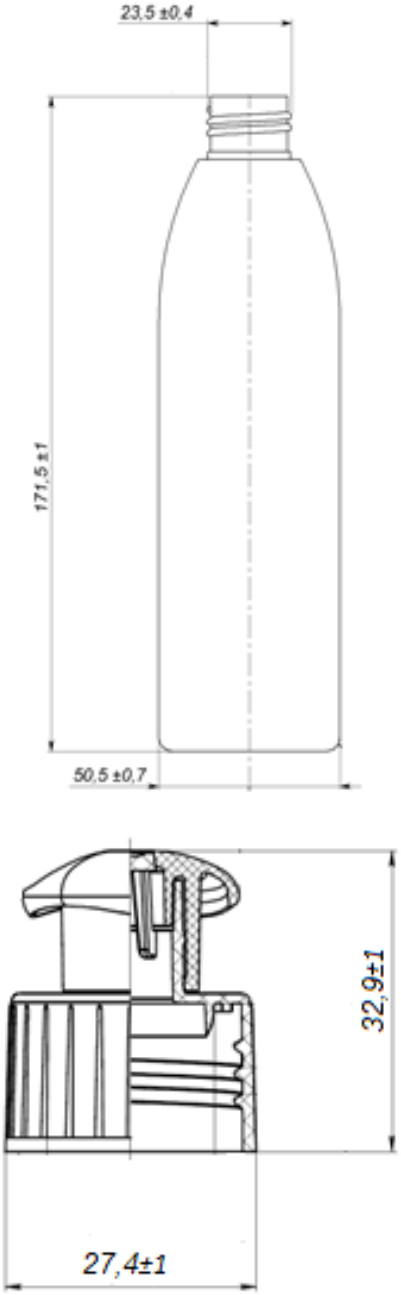

Рисунок 1 – Размеры потребительской тары объемом 250 мл

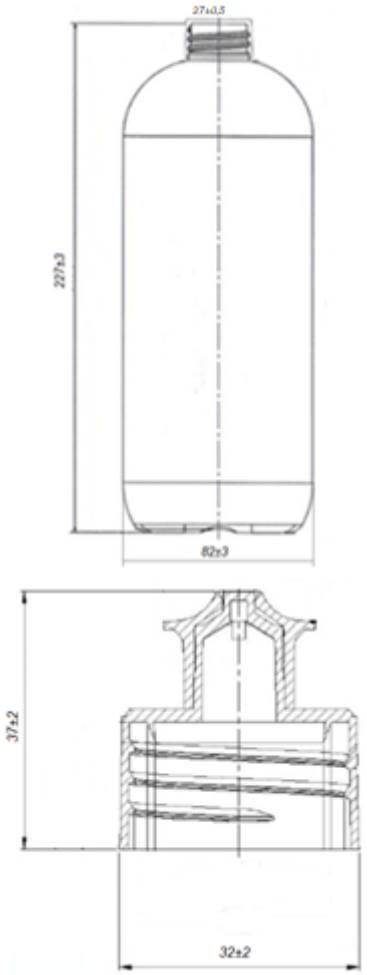

Рисунок 2 – Размеры потребительской тары объемом 1000 мл

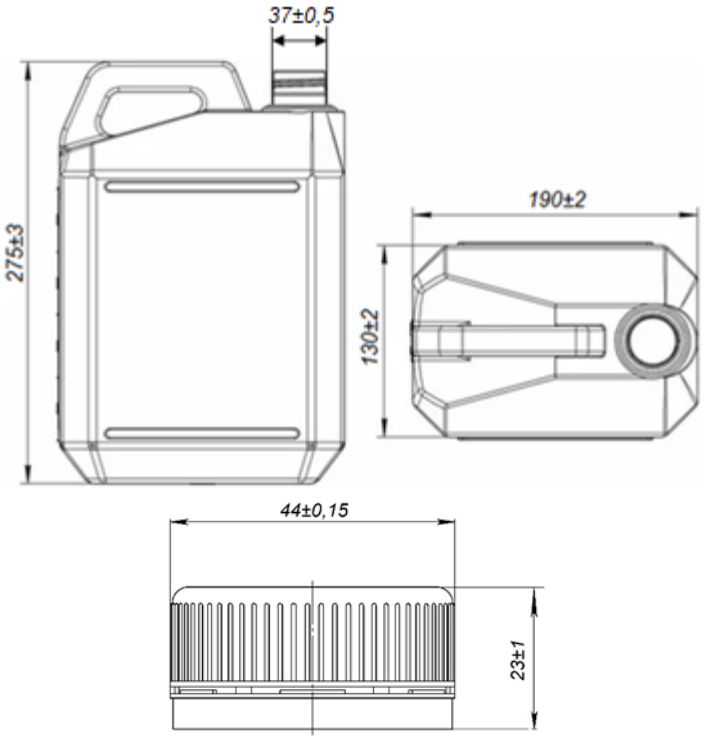

Рисунок 3 – Размеры потребительской тары объемом 5000 мл

Таблица 1 – Массогабаритные размеры потребительской тары

№ образца	Объем, дм^3	Высота, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Диаметр, мм	Диаметр горловины, мм	Масса, кг	Минимальная толщина стенки тары, мм
06102025/1	0,239	172,45	НП	НП	50,87	23,16	0,027	0,70
06102025/2	0,967	228	НП	НП	83,50	27,41	0,071	0,95
06102025/3	4,818	277	190,00	130,75	НП	37,39	0,18	0,82
06102025/4	0,971	227	НП	НП	83,70	27,44	0,071	1,03

Таблица 2 – Размеры укупорочного средства на бутылку/канистру

№ образца	Высота, мм	Диаметр, мм	Масса, кг
06102025/1	32,87	27,30	0,00450
06102025/2	35,00	30,08	0,00357
06102025/3	23,78	43,91	0,00644
06102025/4	35,80	30,62	0,00355

-----конец протокола испытаний-----

Приложение Г

Модели (марки) – варианты исполнения медицинского изделия

«Гель универсальный и электродный контактный, в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-55480932-2025»

I. Варианты исполнения:

1. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
2. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, низкой вязкости, цветной, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
3. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
4. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, цветной, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
5. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный, с Д-пантенолом, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
6. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный, с соком Алоэ Вера, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
7. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, средней вязкости, бесцветный, с Аллантоином, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
8. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
9. Гель универсальный для ультразвуковых исследований и терапии, высокой вязкости, цветной, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
10. Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, низкой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
11. Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, средней вязкости, бесцветный, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл
12. Гель электродный контактный для ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, высокой вязкости, бесцветный, объемом 250 мл / 1000 мл / 5000 мл

II. Эксплуатационная документация:

1. Инструкция по применению.