


Энергетическая калибровка

Аппаратурный спектр контрольного источника :

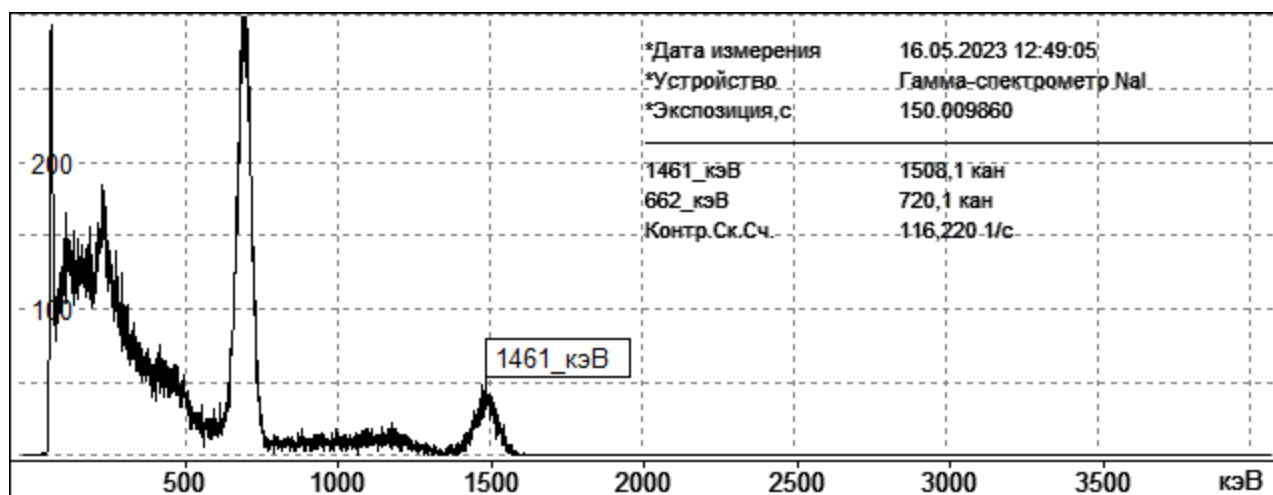


Результаты последних калибровок:

Дата измерения	Контрольная скорость счета, 1/с	Линия 662 кэВ	
		позиция, кан	разрешение, кэВ
16.05.2023 12:49:05	116.22	720.284	60.389
02.05.2023 14:52:53	115.211	729.089	59.448
02.05.2023 13:15:52	117.196	724.485	61.393
03.04.2023 13:15:36	114.431	735.449	60.503
24.03.2023 13:42:39	116.718	736.255	61.724

Контрольные значения, установленные изготовителем СИ для источника $^{137}\text{Cs} + 40\text{K}$ N 517.22:

Дата измерения	Контрольная скорость счета, 1/с	Линия 662 кэВ	
		позиция, кан	разрешение, кэВ
на 13.10.2022	115	730	62
на 16.05.2023	113.4		

Зависимость контрольной скорости счета от времени:

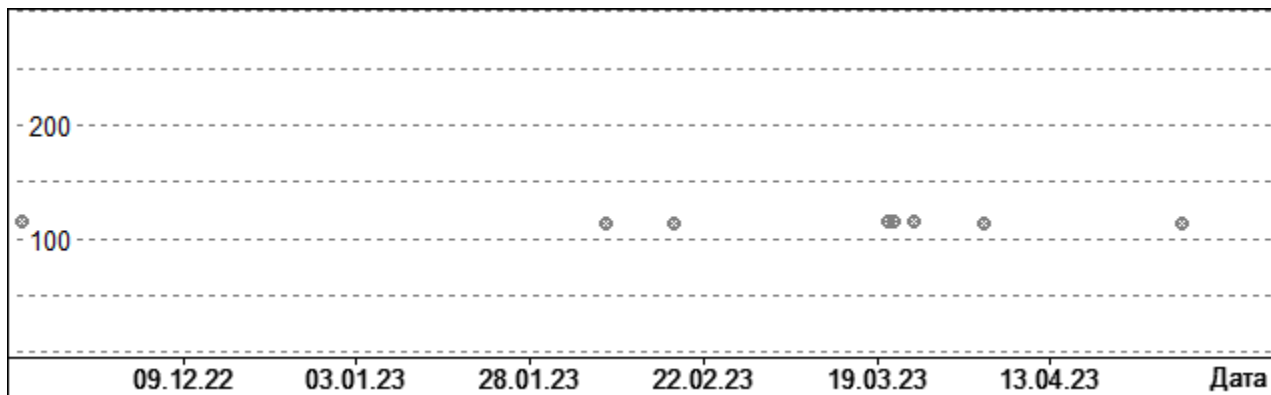

Зависимость позиции репера 662 кэВ от времени:

