



V vs I - 33s_2x #1 (punto step = 1.00)

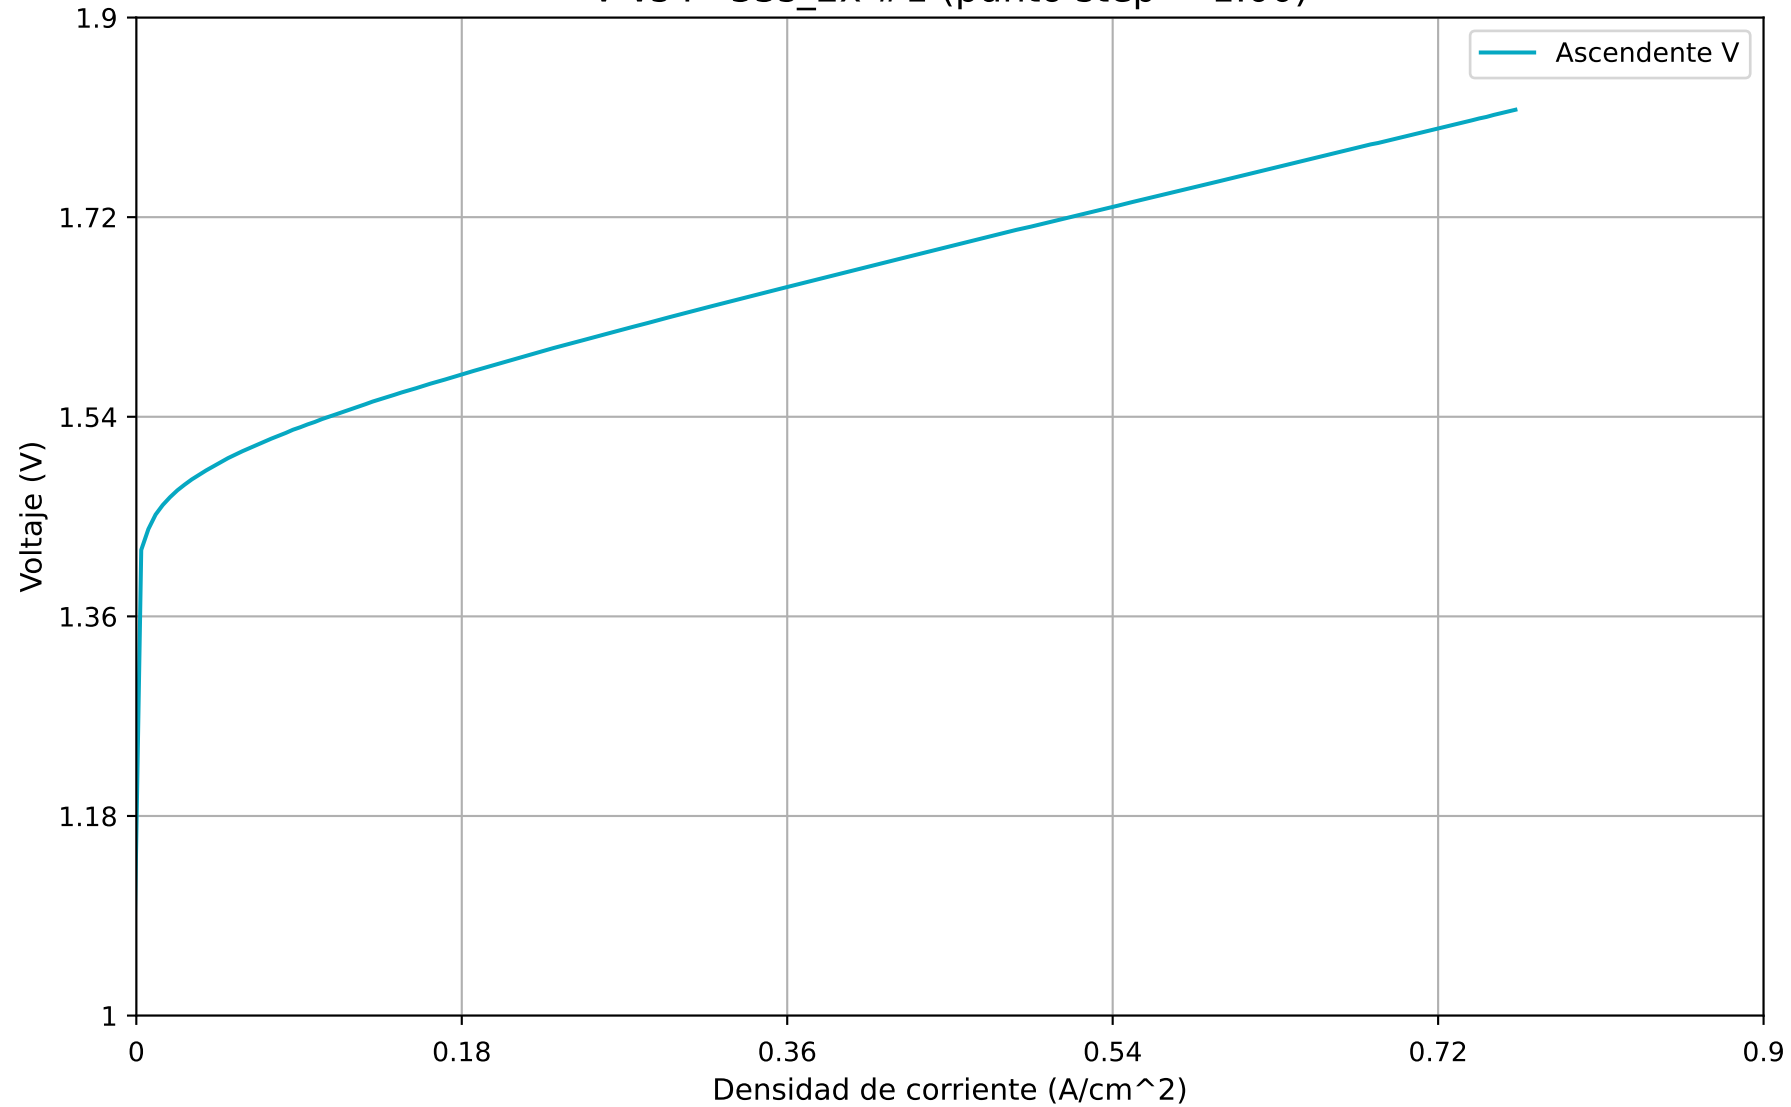

Temperatura vs corriente - 33s_2x #1

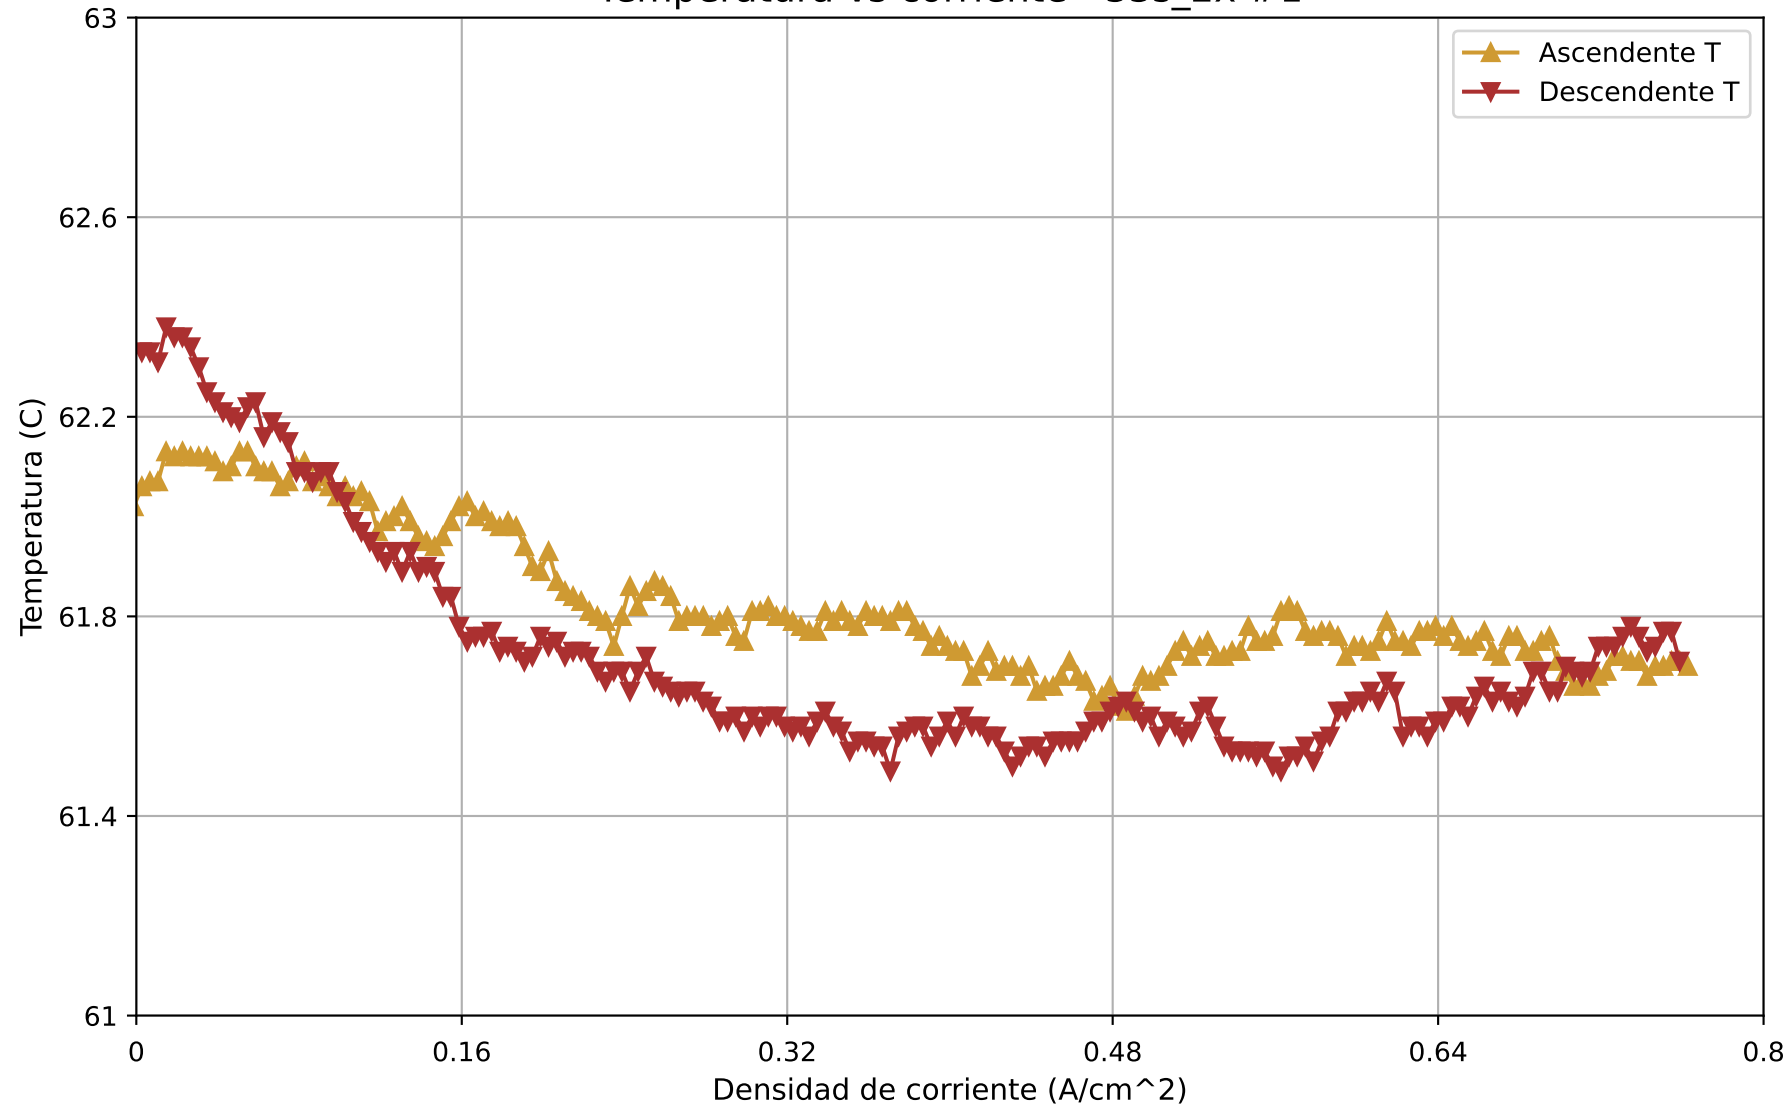

Reporte PC - 33s_2x #1

Metadata e indicadores de la curva de polarizacion

Metadata

Nombre	Valor	Unidad
Curva	33s_2x #1	
Tecnica	Chronopotentiometry Scan	
Fecha	27/5/2026	
Hora	17:00:32	
Rango de corriente	0 a 0.764	A/cm^2
Duracion del paso	33	s
Paso de corriente	0.004	A/cm^2
Velocidad de barrido	0.000121212	A/cm^2/s
Tiempo de muestreo	1	s
Area	25	cm^2
Archivos Asc	96	
Archivos Dsc	95	

Indicadores

Nombre	Valor	Unidad
Tiempo fin ascendente	6431	s
Tiempo total	12795	s
Rango de voltaje	0.77655	V
Temperatura promedio	61.7734	C
Delta T maximo	0.91	C