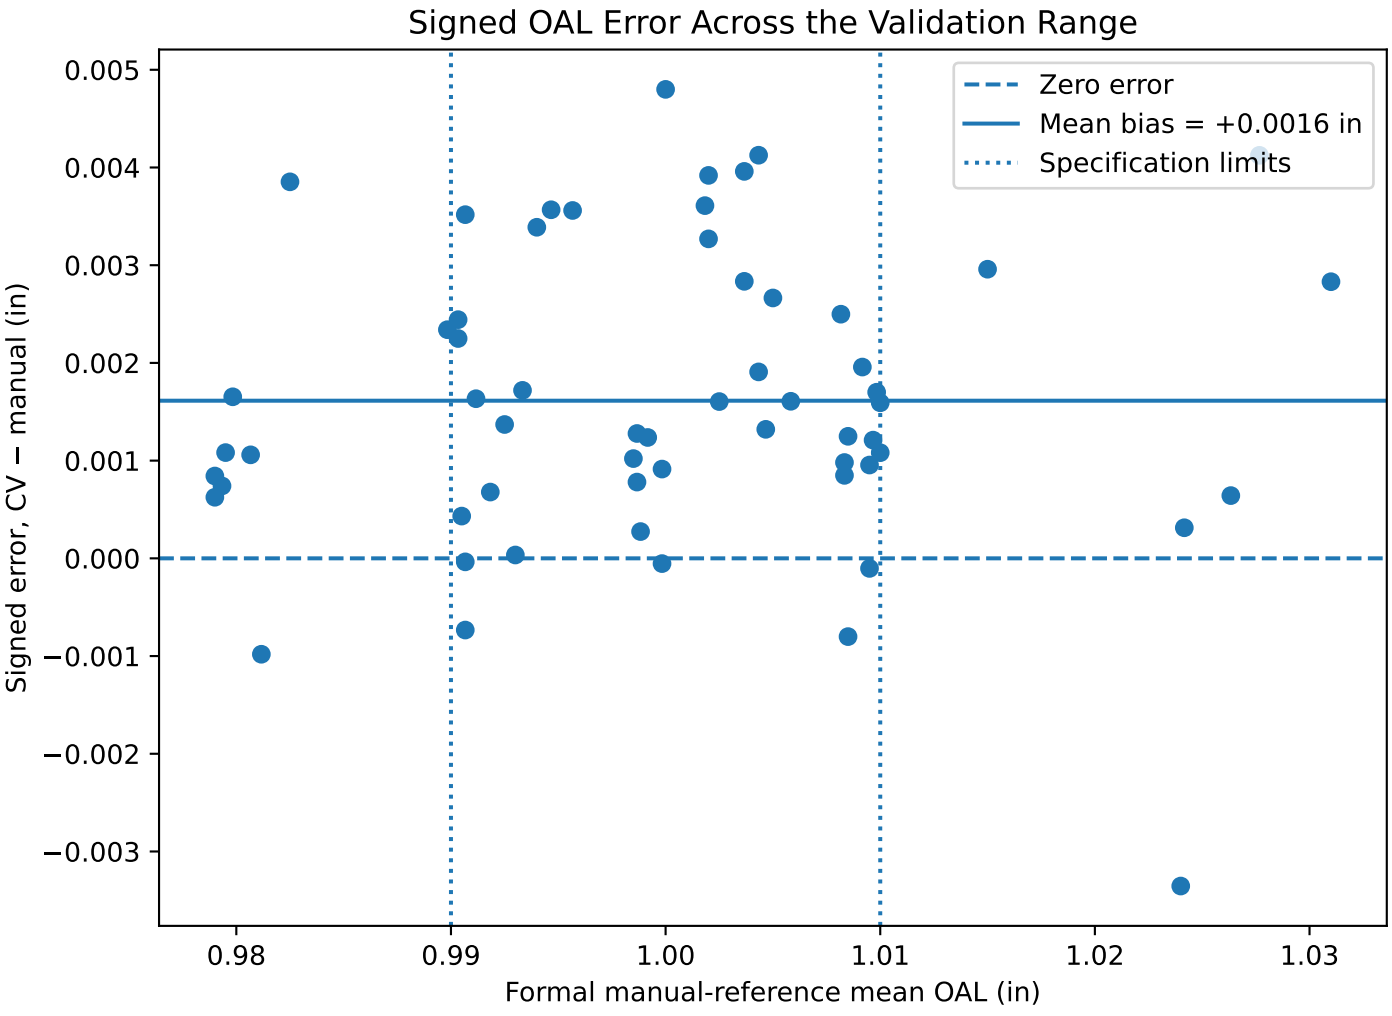
Signed OAL Error Across the Validation Range
Zero error
Mean bias = +0.0016 in
Specification limits
Signed error, CV − manual (in)
0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0.000
−0.001
−0.002
−0.003
0.98
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
Formal manual-reference mean OAL (in)