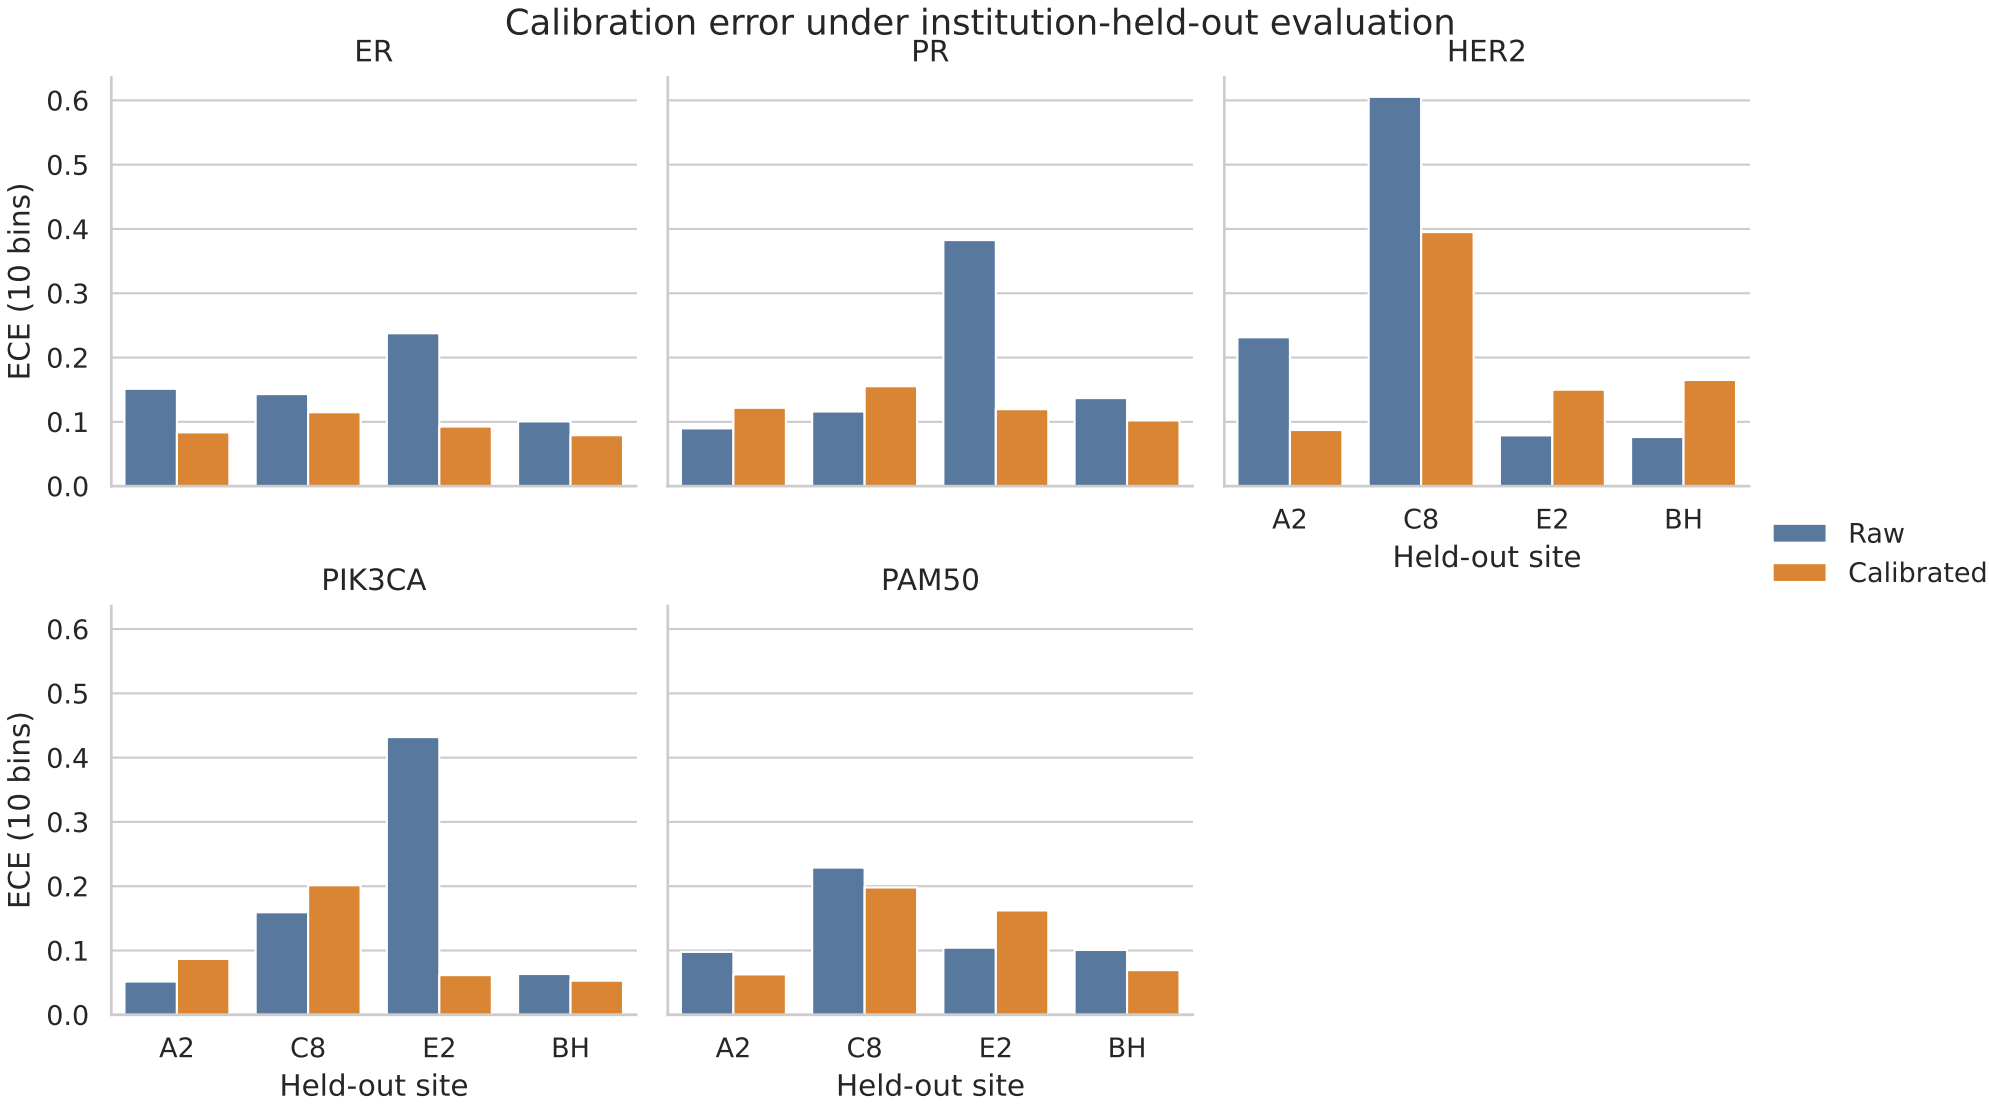
Calibration error under institution-held-out evaluation
ER
PR
HER2
PIK3CA
PAM50
ECE (10 bins)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
A2
C8
E2
BH
Held-out site
Raw
Calibrated