



Налаштування роботи проектора
для проведення круглих столів

Тренер Гриценко П.В.


Ввімкніть проектор

- Підключить проектор до електромережі та натисніть кнопку Power, свтлоідод біля кнопки засвітиться синім кольором.



Ввімкніть проектор


- В меню проектора оберіть WiFi Display

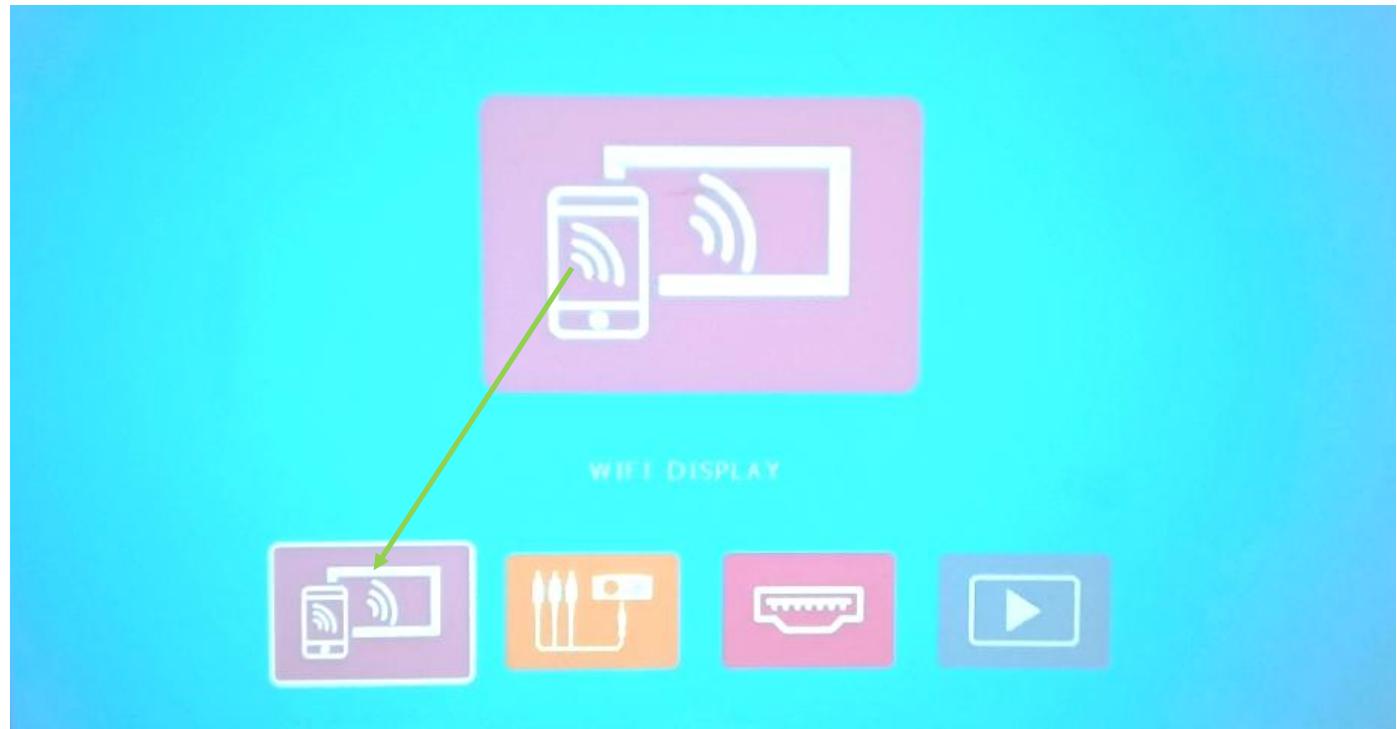

Робота з планшетом

з'єднання з проектором


- Зробіть свайп по екрану планшета з гори в низ щоб відкрити меню налаштувань
- Оберіть «Налаштування WiFi»

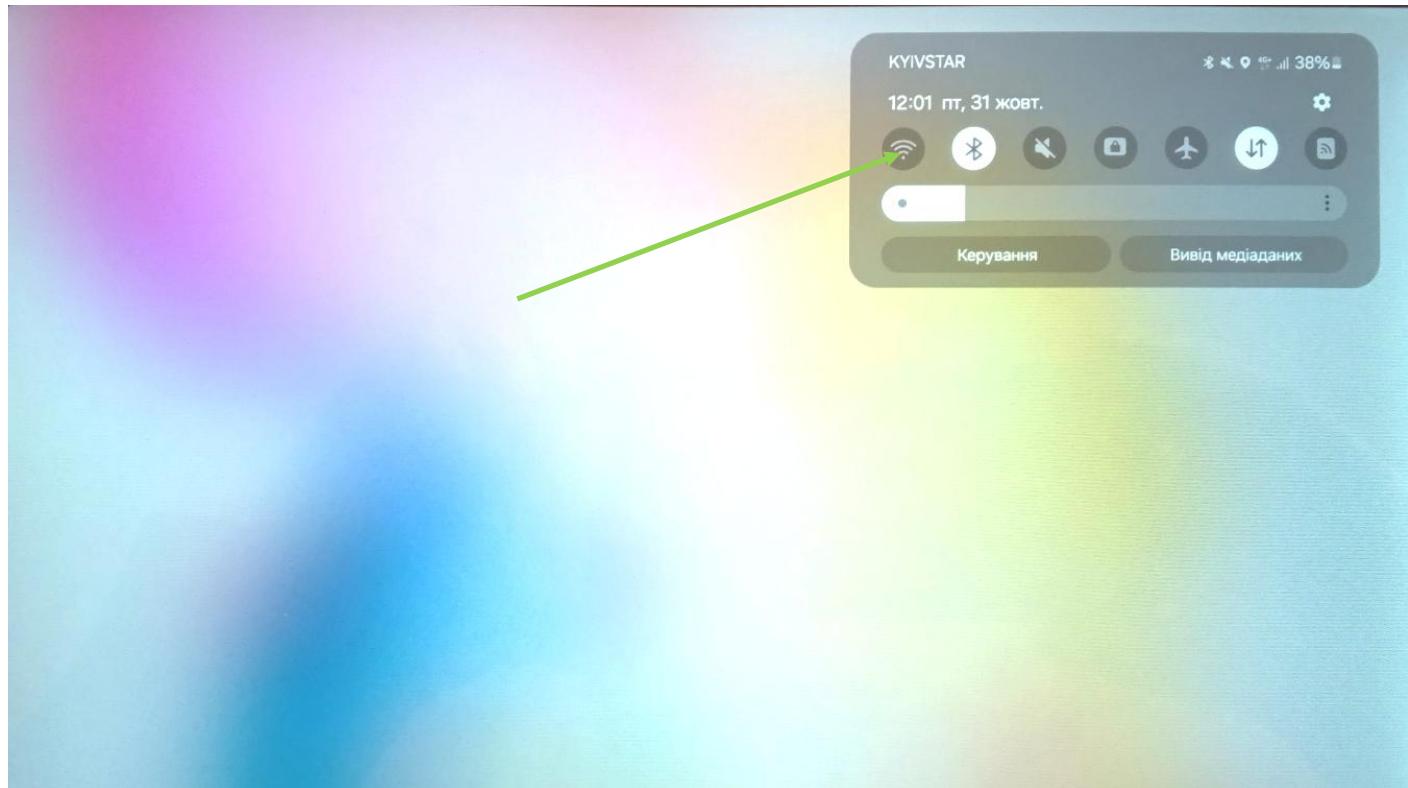

Робота з планшетом

з'єднання з проектором


- Пересуньте важіль у положення «увімкнено» та оберіть мережу

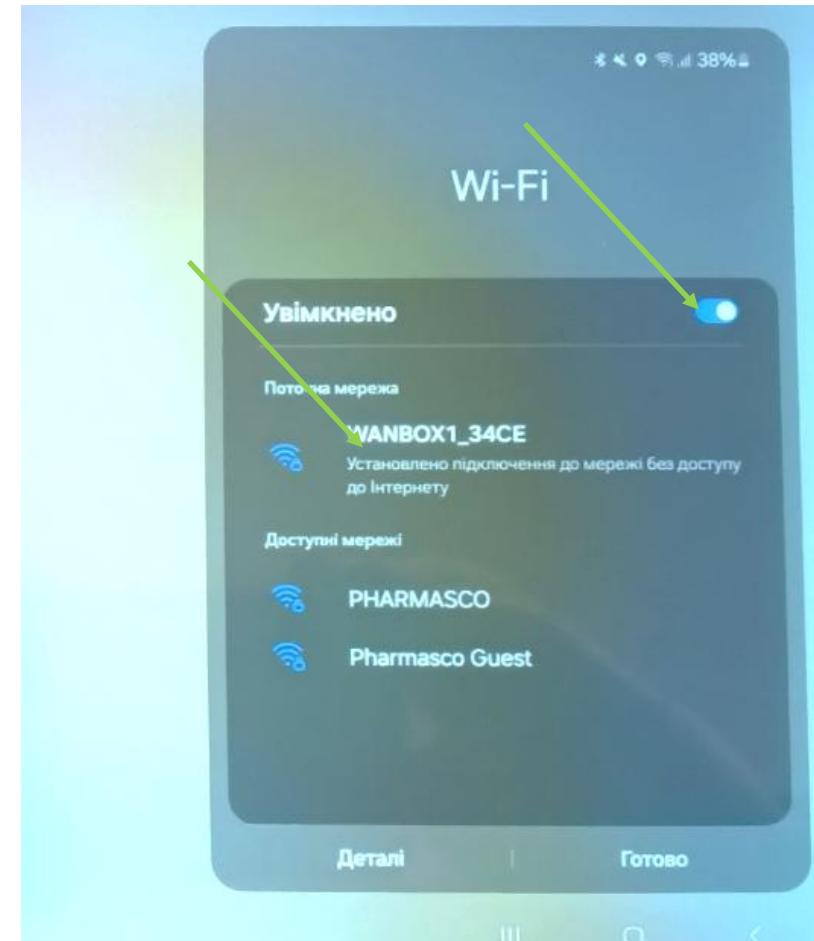

Робота з планшетом

з'єднання з проектором


- Введіть пароль
12345678
- Почекайте кілька
секунд поки
встановиться
з'єднання натисніть
кнопку «ГОТОВО»

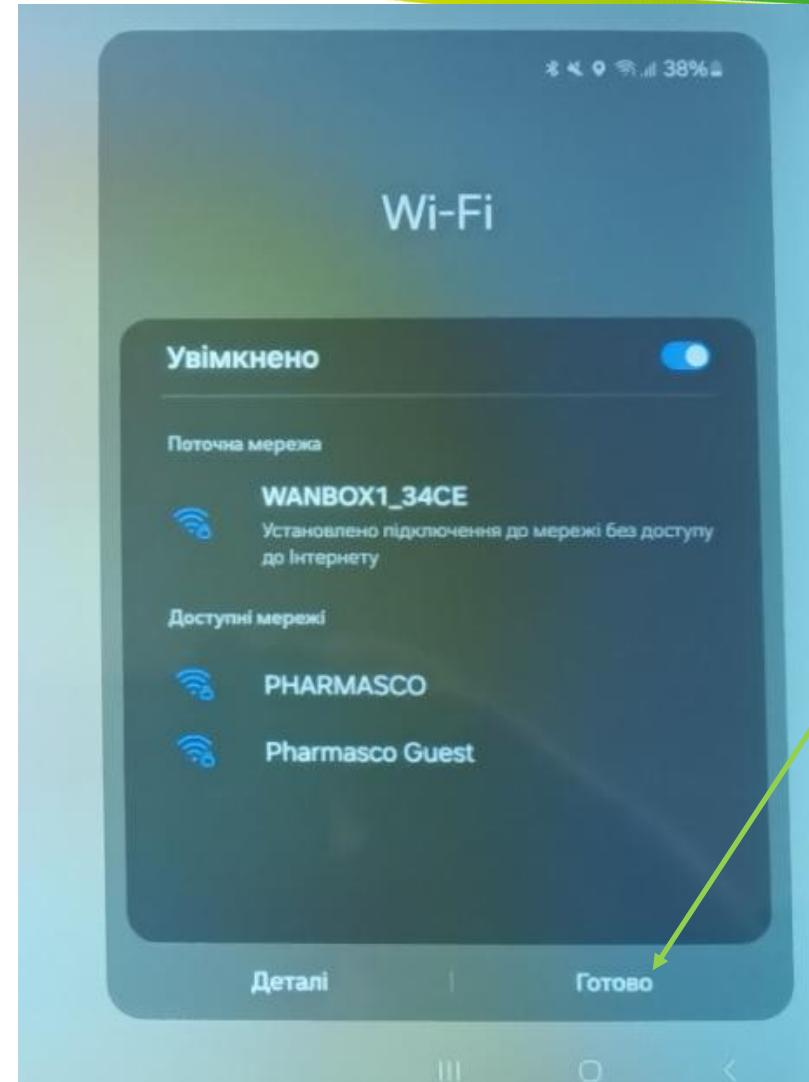

Робота з планшетом

з'єднання з проектором


- Натисніть на шестерню для переходу в меню налаштувань

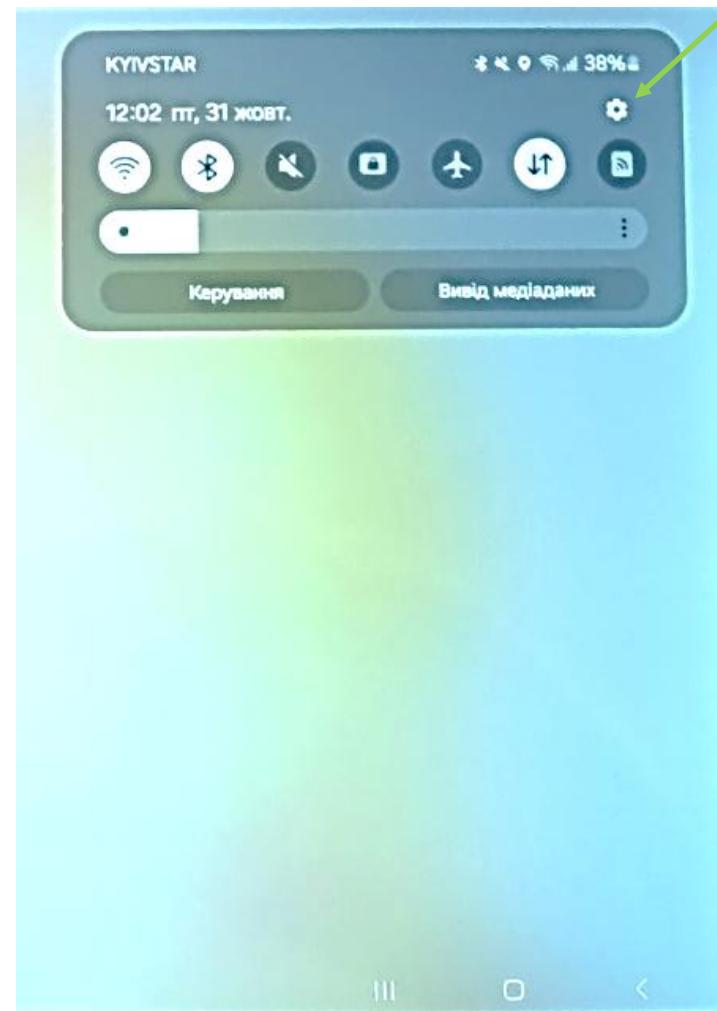

Робота з планшетом

з'єднання з проектором


- Оберіть «Підключені пристрой»
- «Smart View»

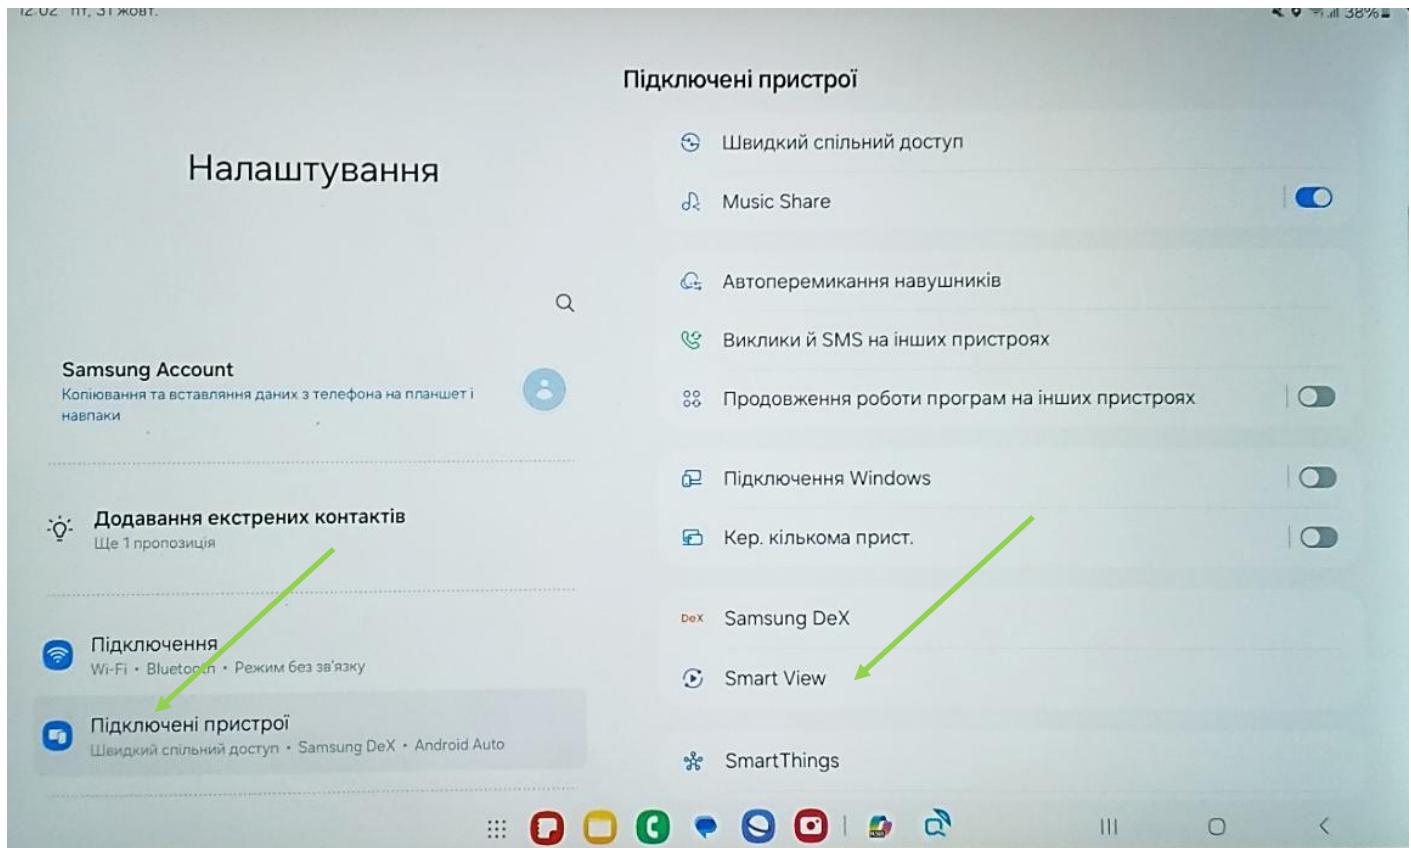

Робота з планшетом

з'єднання з проектором


- Оберіть пристрій
- Далі ви побачите зображення екрану планшету на екрані проектора

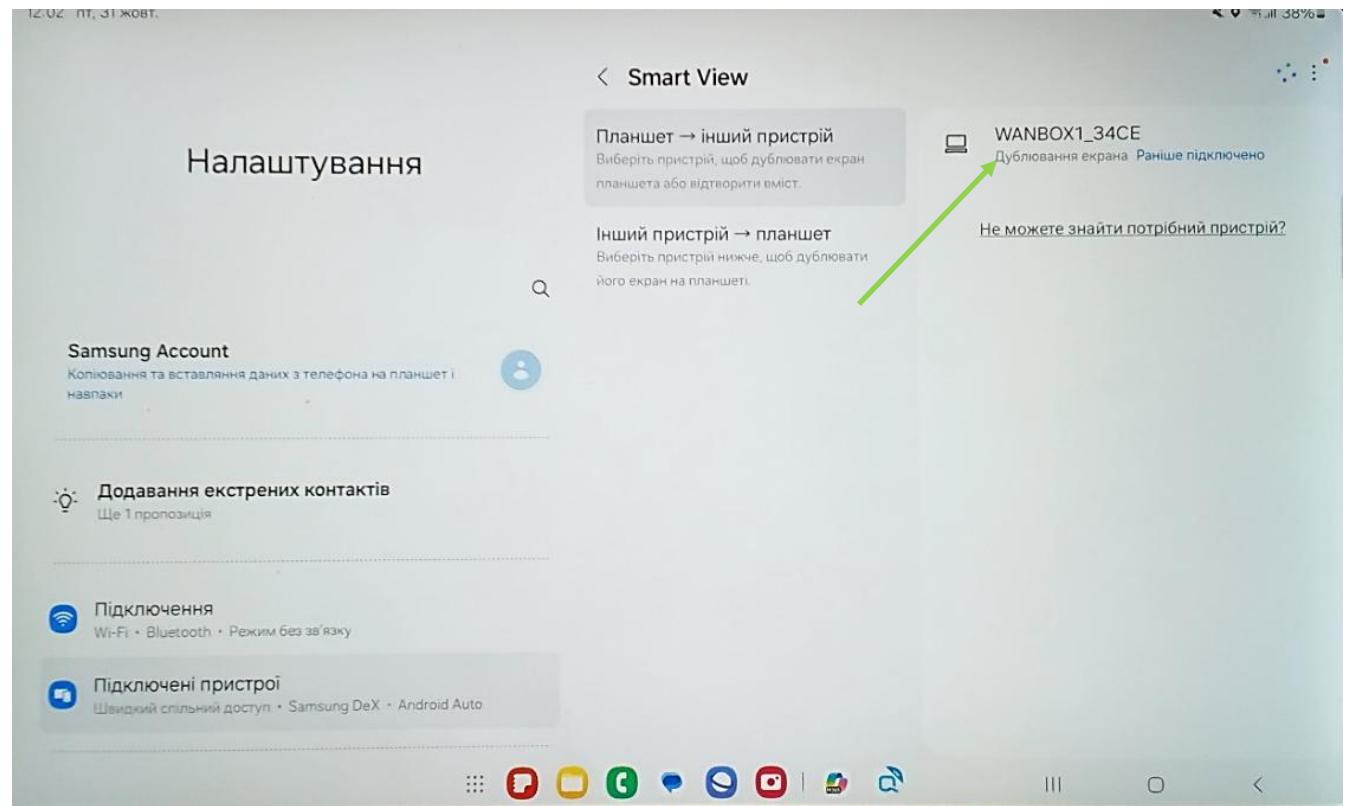

Робота з планшетом

Робота з CRM

Зайдіть в CRM в
розділ «документи»

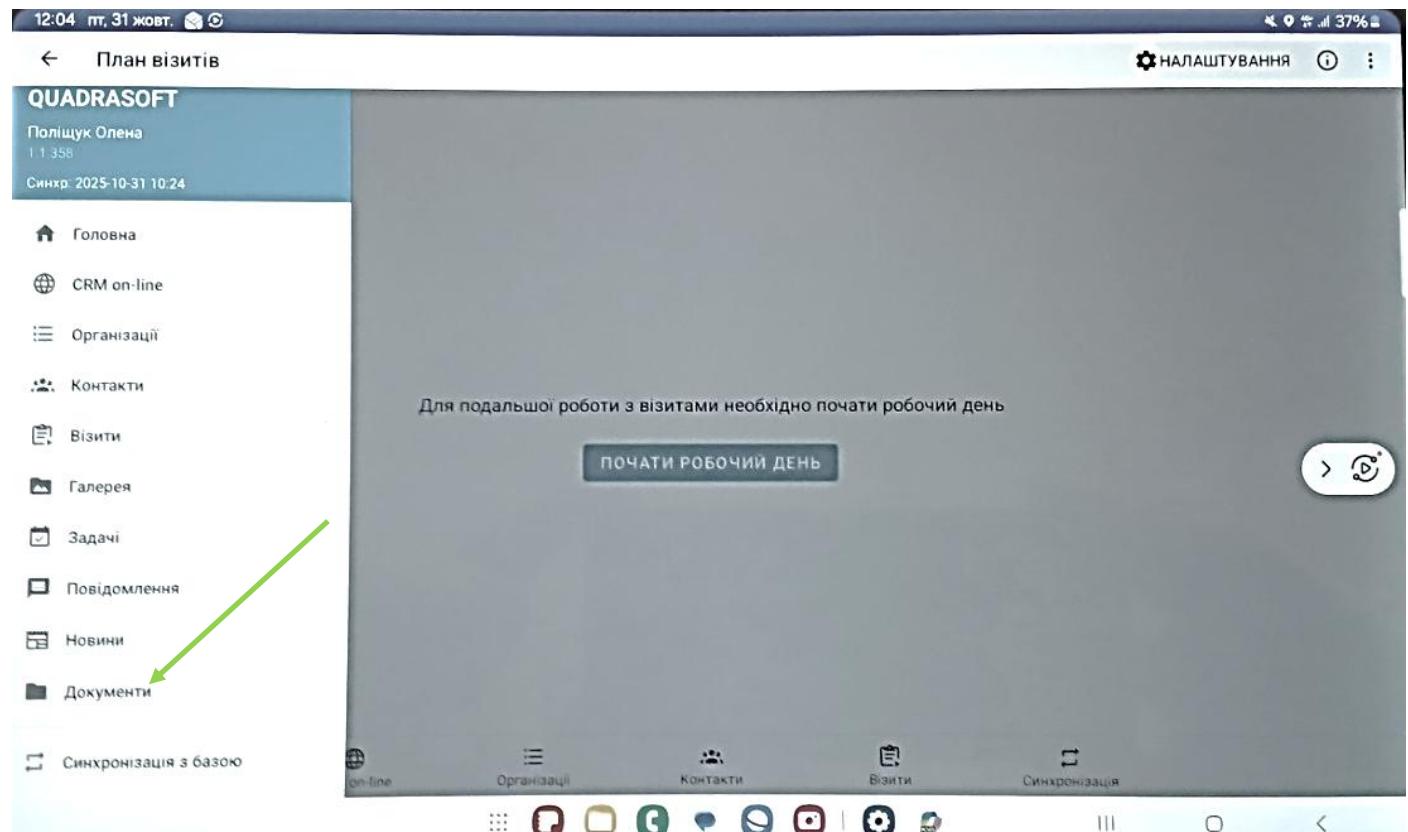


Робота з планшетом

Робота з CRM

В розділ «документи»
оберіть папку
«презентації на
візити»

А в папці оберіть
необхідну
презентацію.

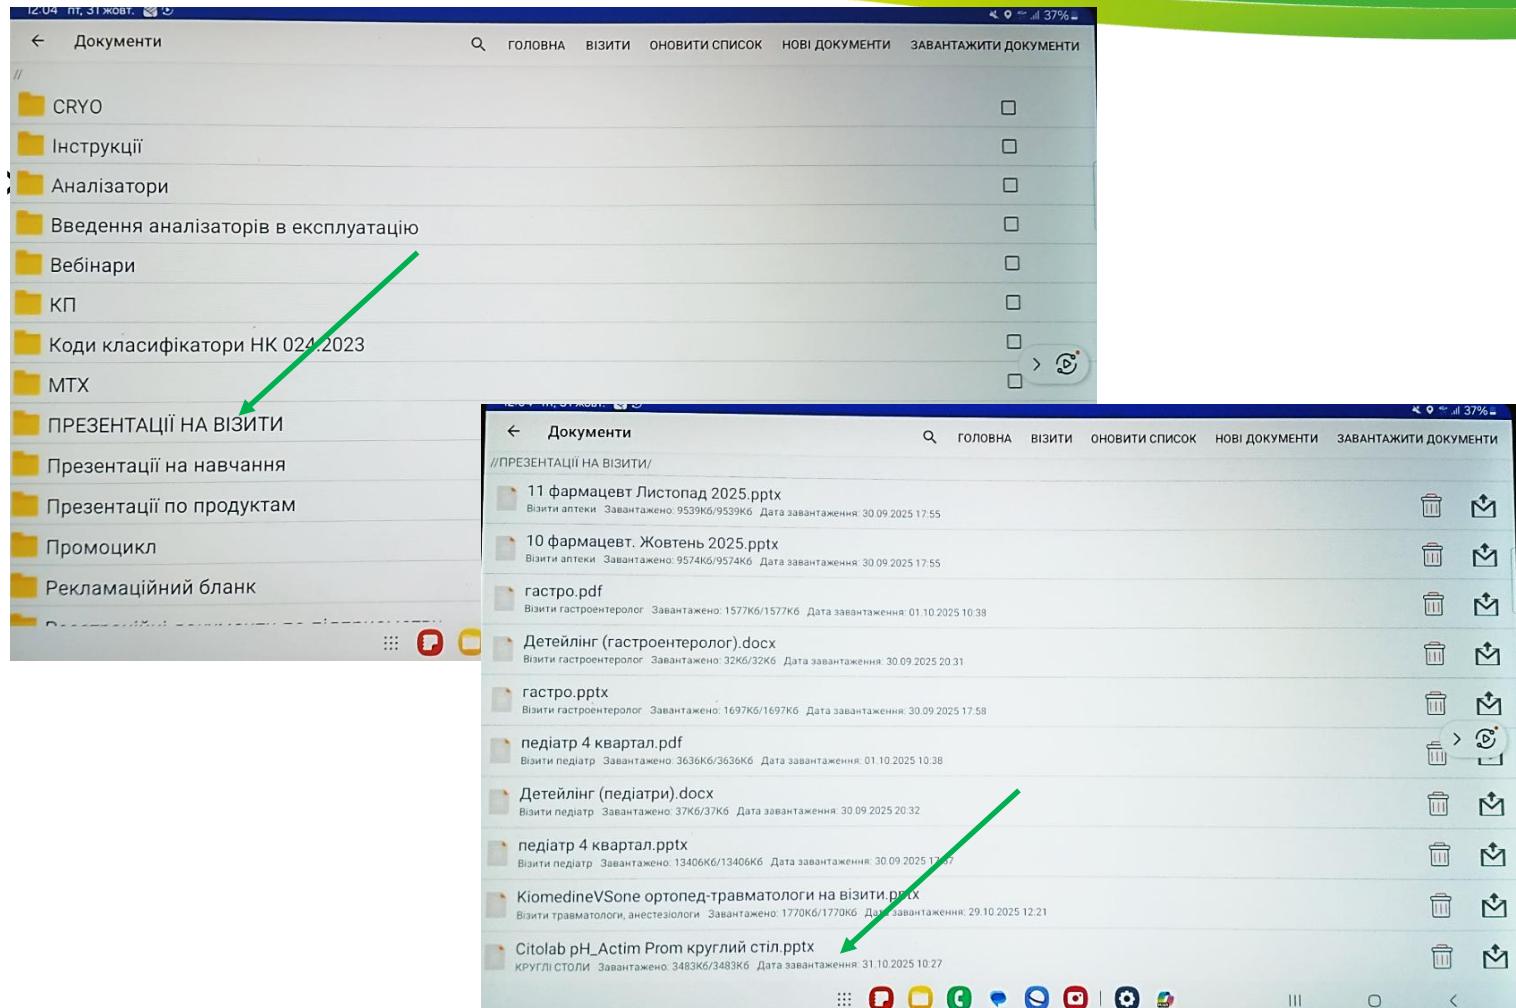

Робота з планшетом

Робота з CRM

В меню, що з'явилось натисніть «продовжити показ» і демонструйте презентацію.

Візит не розпочатий.
Натисніть кнопку 'Почати візит', щоб показ Документа був закріплений за Врачем або Аптекою.

ПОВЕРНУТИСЯ І ПОЧАТИ ВІЗИТ ПРОДОВЖИТИ ПОКАЗ

Дата завантаження: 30.09.2025 17:55
77К6/1577К6 Дата завантаження: 01.10.2025 10:38
.docx
<6/32К6
97К6/169
5КБ Дата завантаження: 01.10.2025 10:38

Pharmasco[®] ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

CITOLAB[™] pH тест

ІДВ ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВІДНОСИЧЕННЯ pH ВАГІНАЛЬНИХ ВІДЛЕДІВ

Процедура тестування

- Провести збор зразку вагінального секрету за допомогою ватної палички.
- Нанести зразок на кольорову зону тест-смужки.
- Через 20 с (c)** оцінити результат, порівнюючи з кольоровою шкалою.

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

ІДВ ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

ВАГІНАЛЬНИЙ pH тест

25 тест-смужок

ІДВ ТЕСТ-СМУЖКА ДЛЯ ВІДНОСИЧЕННЯ pH ВАГІНАЛЬНИХ ВІДЛЕДІВ

ІДВ

3132S

www.pharmasco.com

CITOLAB[™] pH

Pharmasco[®]

швидка допомога при діагностиці збудників вагінальних інфекцій у жінок з АВВ

Pharmasco®

ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ



Бажаю успіху в проведенні круглих столів!