

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN ADDRESS	FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS
ORDEN TRABAJO WORK ORDER	CG6924747767
REMISION REMISSION	SSCC: 1530107
FECHA DE EMISIÓN EMISSION DATE	09/07/2024
DENOMINACIÓN DENOMINATION	TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO
FABRICANTE MANUFACTURER	KESLLER
N° DE PARTE PART N°	ASTM 7C-86
N° DE SERIE SERIAL N°	607410
RANGO RANGE	-2 °C a +300 °C
RESOLUCIÓN RESOLUTION	1 °C
CÓDIGO FACH FACH CODE	-----
N° CONTROL ENAER ENAER CONTROL N°	FA-1707

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	BAÑO DE CALIBRACIÓN	FIELD METROLOGY WELL
Fabricante / Manufacturer	FLUKE	FLUKE
Modelo / Model	7341	9144
N° de Serie / Serial number	B61654	B44608
Certificado N° / Certificate N°	140224ST0289	031023ST0267
Fecha de Calibración / Calibrated Date	14 de febrero 2024	08 de febrero 2024
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	14 de agosto 2024	08 de agosto 2024
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	DTS	DTS

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN CALIBRATION RESULTS

Patrón <i>Standard</i>	Equipo bajo Ensayo (1) <i>Equipment under Test</i>	Error (2) <i>Error</i>	Incertidumbre de la Medición (k=2) Uncertainty Measurement (k=2)
-0,08 °C	0,0 °C	0,08 °C	0,07 °C
50,02 °C	50,0 °C	-0,02 °C	0,10 °C
100,01 °C	100,0 °C	-0,01 °C	0,10 °C
150,01 °C	150,0 °C	-0,01 °C	0,11 °C
199,98 °C	200,0 °C	0,02 °C	0,12 °C
254,94 °C	255,0 °C	0,06 °C	0,13 °C
299,89 °C	300,0 °C	0,11 °C	0,14 °C

NOTAS:

- (1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.
(2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.


Procedimiento de Calibración <i>Calibration procedure</i>	PTE-311 ASTM E1
Lugar de Calibración <i>Calibration place</i>	Laboratorio de Metrología
Ambiente <i>Environment</i>	22 °C +/- 2 °C (32 +/- 5) % H.R.

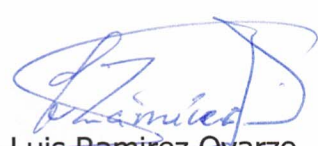
Observación / Observation:

- Termómetro de inmersión total

Fecha de Calibración/Calibration Date: 08 de julio 2024

Fecha de Vencimiento/Due Date: 08 de julio 2025


Soraya Pacheco C.
Técnico / Technician


Luis Ramirez Oyarzo
Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory