

INFORME TECNICO

USUARIO	: FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCION	: FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
N° REMISION	: SSCC: 1742708
N° ORDEN DE TRABAJO	: CG6925760164
DENOMINACION	: RADAR ALIGMENT
CODIGO FACH	: S/C
N° DE CONTROL ENAER	: FA-0483
MARCA	: RADOM
N° DE PARTE/MODELO	: 19010
N° DE SERIE	: 001
RANGO	: ----
EXACTITUD	: (+/- 0,03) mm
FECHA INICIO DE CONTROL	: 19 de mayo de 2006
FECHA ULTIMA CALIBRACION	: 24 de septiembre de 2024
FECHA DE REVISION	: 19 de diciembre de 2025

CONDICIÓN DE RECEPCION

- ☐ En tolerancia
☐ Fuera de tolerancia
☐ Reparable
☒ Otro (inoperativo)

CONDICION DE ENTREGA

- ☐ Servible
☒ Reparable
☐ Inservible
☐ Otro

1.- Observaciones/Discrepancias:

Calibre Radar Aligment presenta defectos en puntos de contacto que son utilizados de referencia, afectando la confiabilidad del proceso de ajuste y calibración.



Imagen 1 muestra los puntos de contacto

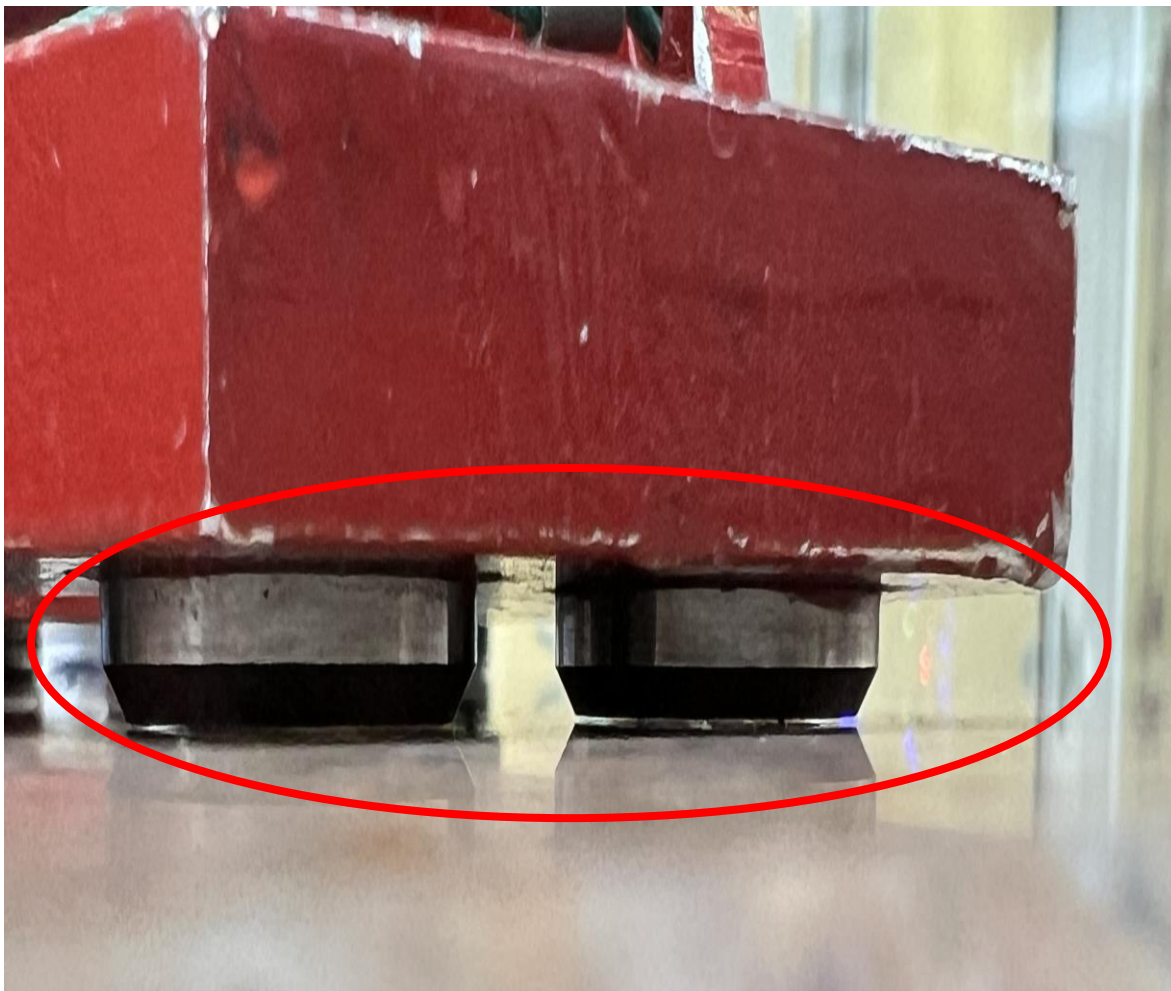


Imagen 2 muestra defecto observado.

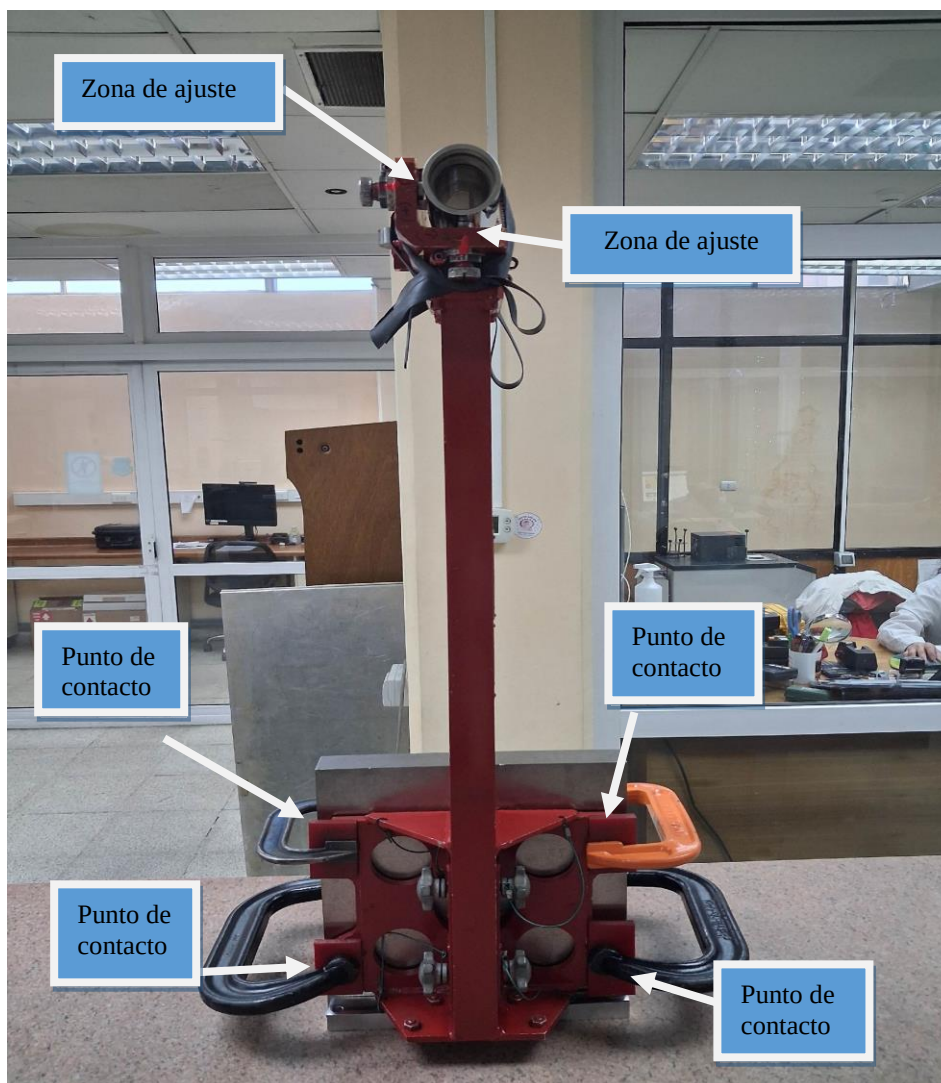


Imagen 3 calibre instalado en la escuadra.

Impacto: Defecto observado afecta la correcta alineación que se debe realizar en zona de medición del instrumental óptico.

Fecha emisión: 19 de diciembre de 2025.

**Ivan Valdebenito
Rojas**

Técnico Calibrador


Digitally signed by Ivan Valdebenito Rojas
DN: cn=Ivan Valdebenito Rojas, o=ENAER,
ou=Gerencia Garantía de Calidad,
email=ivan.valdebenito@enaer.cl, c=CL
Date: 2025.12.29 17:14:38 -03'00'

**Marcial
Espinoza
Marchant**

Jefe Laboratorio Metrología

Firmado digitalmente por Marcial
Espinoza Marchant
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=Marcial Espinoza Marchant,
o=ENAER, ou=Gerencia de Garantía de
Calidad,
email=marcial.espinoza@enaer.cl, c=CL
Fecha: 2025.12.30 10:54:22 -03'00'

ANEXO 1

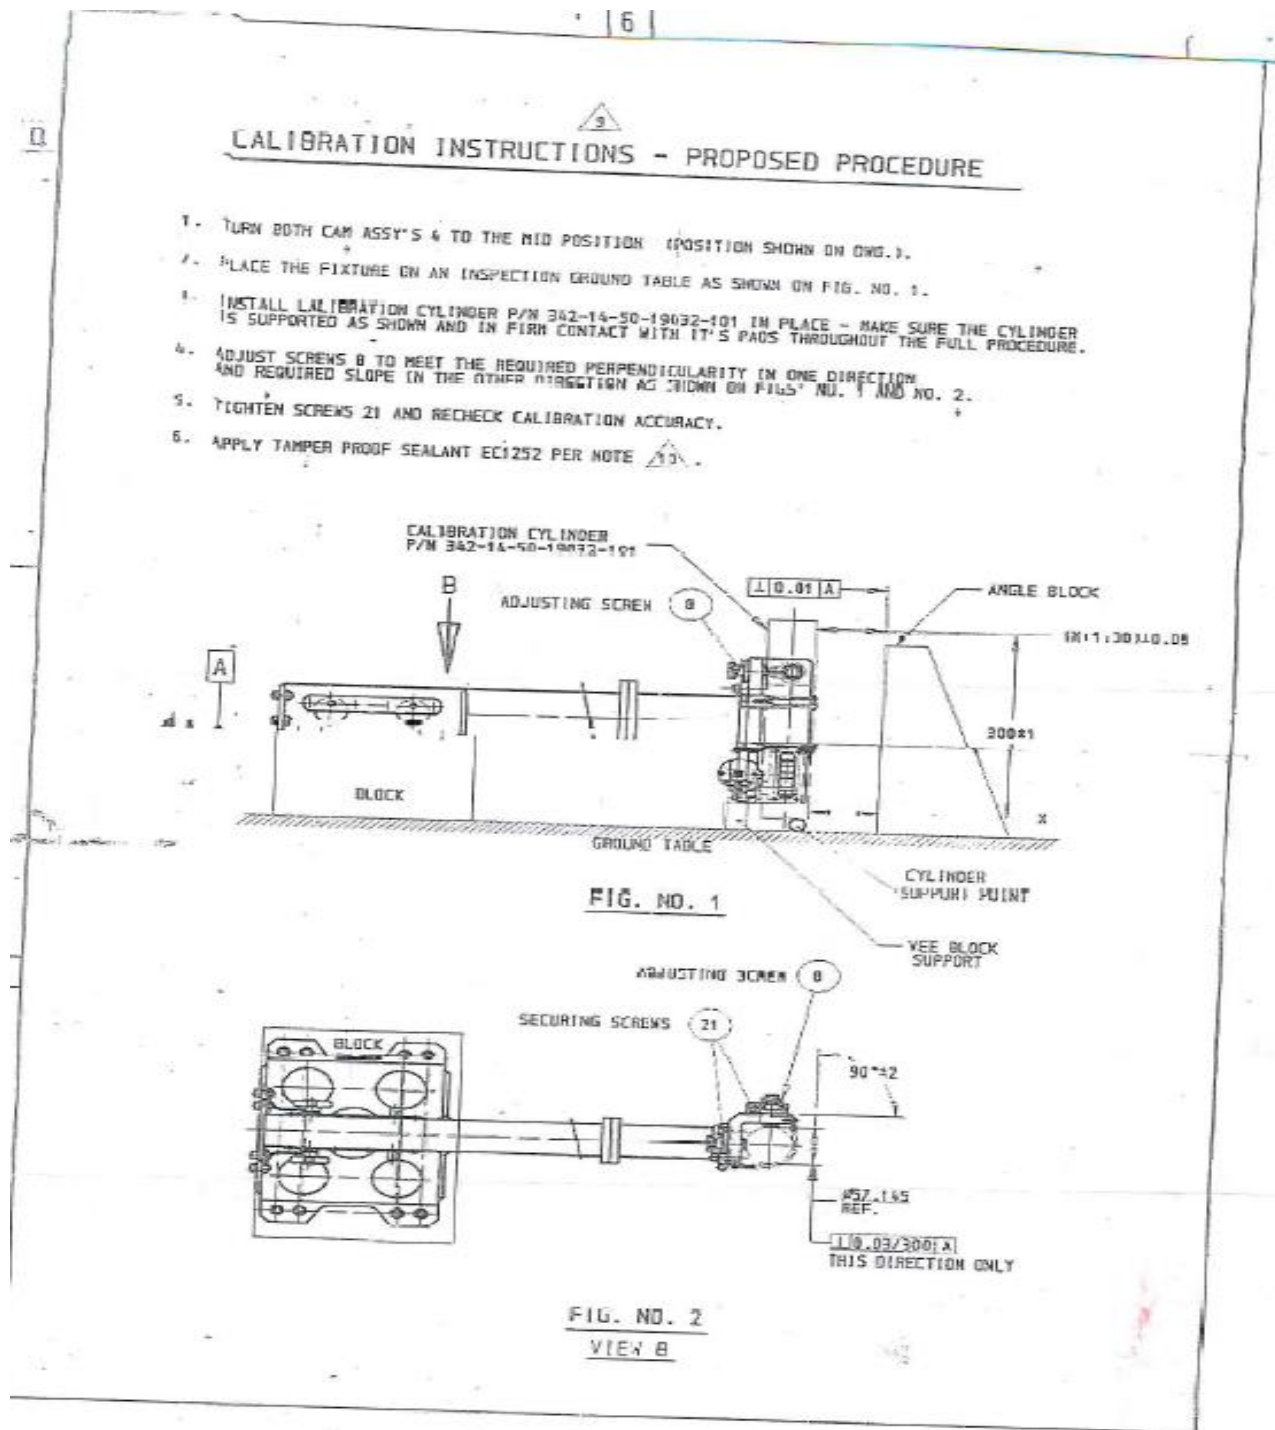

ANEXO 2

NOTES:

1. MANUFACTURER: CARR LANE, U.S.A.
2. PRESS BUSHING 7 IN ITEM 5 UP TO SHOULDER LEVEL, IN ORIENTATION AS SHOWN ON DWG.
3. DRILL FOUR HOLES Ø5.56 THRU PILOT HOLES Ø3.0 IN ITEMS 5 AND 15 FOR PINS 33 AND 34.
4. DRILL THRU FOUR PILOT HOLES IN ITEM 6 AND INSTALL RIVETS 32 PER P.S.070200.
5. TAKE CARE TO INSTALL THE TWO CAN ASSY'S 4 ONLY IN ORIENTATION AS SHOWN ON DWG.
6. SECURE NOTED SCREWS WITH LOCTITE NO. 241 PER P.S.373100.
7. SWAGE FERRULES 40, USING CRIMPING TOOL OR EQUIVALENT, AND TEST LANYARD FOR PULLING FORCE OF 30 KG.
8. ENTER NAMEPLATE DATA BY ENGRAVING OR STEEL STAMPING.
9. ADJUST TWO SCREWS 8 TO MEET NOTED CALIBRATION REQUIREMENTS RELATIVE TO DATUM A. CALIBRATION MAY BE PERFORMED AS PER THE PROCEDURE PROPOSED IN SEPARATE BOX ON THIS DWG.
10. AFTER CALIBRATION, TIGHTEN SCREWS 21 AND APPLY TAMPER PROOF SEALANT ECI 252 ON THEIR HEADS AND ON THREAD OF SCREWS 8.
11. THE FIXTURE SHALL BE PACKED IN CONTAINER WITH SOFT LININGS.