

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

Cliente / Customer : Fuerza Aérea de Chile
Dirección / Address : IV.^a Brigada Aérea, Punta Arenas
Orden de Trabajo / Work Order : CG6924748174
No. Remisión / Remission Number : SSCC: 1528616
Fecha de Emisión / Emission Date : 30 de julio de 2024

Objeto / Object : Reloj Comparador
Fabricante / Manufacturer : Starrett
No. de Parte / Part Number : 81-141
No. de Serie / Serial Number : P72754
Rango / Range : 0 in – 0,250 in
Resolución / Resolution : 0,001 in
Código FACH : CPWA30417-7
No. de Control ENAER : FA-0304
Procedimiento / Procedure : T. O. 33K6-4-889-1

Trazabilidad / Traceability

Patrón / Standard : Dial Indicator Tester
Fabricante / Manufacturer : Starrett
Modelo / Model : 469MH
No. Control / Control Number : ST-0095
No. Serie / Serial Number : 02194753
No. Certificado / Certificate Number : 7085058
Vencimiento / Due : 17 de febrero de 2025
Emisor / Origin : Starrett
Trazabilidad / Traceability : Starrett

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

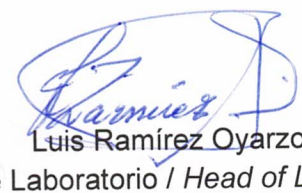
Lectura del Estándar $\bar{x}$ (in)	Lectura del Equipo en Ensayo (in)	Error $\bar{x}$ (in)
0,0000	0,000	0,0000
0,0102	0,010	-0,0002
0,0202	0,020	-0,0002
0,0301	0,030	-0,0001
0,0402	0,040	-0,0002
0,0502	0,050	-0,0002
0,0600	0,060	0,0000
0,0699	0,070	0,0001
0,0800	0,080	0,0000
0,0898	0,090	0,0002
0,0999	0,100	0,0001
0,1300	0,130	0,0000
0,1500	0,150	0,0000
0,1749	0,175	0,0001
0,2001	0,200	-0,0001

Observaciones / Observations:

Fecha de Calibración / Calibration Date: 30 de julio de 2024
 Fecha de Vencimiento / Due Date: 30 de julio de 2025

U. Total $k=2$	0,001 in
Exactitud del Fabricante / Manufacturer Accuracy	$\pm 0,001$ in
Lugar de Calibración / Calibration Place	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Ambiente / Environment	20,2 °C $\pm$ 0,1 °C 53,4 % H. R. $\pm$ 0,3 % H. R.


 José Guerrero Araya
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory