

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE FUERZA AEREA DE CHILE
CUSTOMER
DIRECCIÓN FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENAS
ADDRESS
ORDEN TRABAJO CG6922728910
WORK ORDER
REMISION SSCC: 1112310 IV B.A.
REMISSION
FECHA DE EMISIÓN 11/07/2022
EMISSION DATE
DENOMINACIÓN TERMÓMETRO DE LÍQUIDO EN VIDRIO CON MERCURIO
DENOMINATION
FABRICANTE LSW
MANUFACTURER
N° DE PARTE ASTM 9C/IP 15C
PART N°
N° DE SERIE 3367
SERIAL N°
RANGO -5 °C a +110 °C
RANGE
RESOLUCIÓN 0.5 °C
RESOLUTION
CÓDIGO FACH N/A
FACH CODE
N° CONTROL ENAER FA-1737
ENAER CONTROL N°

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	Digital Multimeter	Termómetro de Resistencia de Platino
Fabricante / Manufacturer	Fluke	Hart Scientific
Modelo / Model	8842A	CTR5000
N° de Serie / Serial number	5715266	556745
Certificado N° / Certificate N°	041221MS0060	04251D-K-15091-02-00
Fecha de Calibración / Calibrated Date	04 de Diciembre de 2021	30 de Noviembre de 2021
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	04 de Diciembre de 2022	30 de Noviembre de 2022
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	DTS	BIONETICS

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

Página / Page 1 of 2

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN CALIBRATION RESULTS

Patrón Standard	Equipo bajo Ensayo (1) Equipment under Test	Error (2) Error	Incertidumbre de la Medición (k=2) Uncertainty Measurement (k=2)
0,00 °C	0,0 °C	0,00 °C	0,25 °C
34,99 °C	35,0 °C	0,01 °C	0,24 °C
74,99 °C	75,00 °C	0,01 °C	0,24 °C
105,00 °C	105,0 °C	0,00 °C	0,24 °C

NOTAS:

- (1) Valores informados son un promedio de los valores obtenidos bajo ensayo.
 (2) Errores indicados fueron aproximadas con dos cifras significativas.

Procedimiento de Calibración Calibration procedure	PTE-311 ASTM E1
--	--------------------

Lugar de Calibración Calibration place	Laboratorio de Metrología
--	---------------------------

Ambiente Environment	22 °C +/- 2 °C
--------------------------------	----------------

Observación / Observation:


- Termómetro de inmersión parcial, 57 mm.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 11 de julio 2022

Fecha de Vencimiento/Due Date: 11 de julio 2023



José Piña Muñoz
 Técnico / Technician

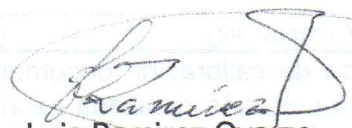

Luis Ramirez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory