

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS	FACH, IVta. B. A., PUNTA ARENAS
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	CG6925760189
N° REMISION / REMISSION N°	SSCC: 1742708
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE	26/11/2025

OBJETO OBJECT	DIAL BORE GAGE
FABRICANTE MANUFACTURER	MITUTOYO
N° DE PARTE PART N°	511-902
N° DE SERIE SERIAL N°	604812
RANGO RANGE	0 mm – 1 mm
RESOLUCION RESOLUTION	0,001 mm
CODIGO FACH	S/C
N° DE CONTROL ENAER	FA-0292
PROCEDIMIENTO / PROCEDURE	T.O. 33K6-4-889-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MAQ. DE MED. UNIVERSAL
Fabricante / Manufacturer	MAHR
Modelo / Model	828 PC
N° de Serie / Serial number	1176/05
Certificado N° / Certificate N°	110825SP0001
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	11/08/2026
Emisor / Origin	ENAER
Trazabilidad / Traceability	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACION

CALIBRATION RESULTS

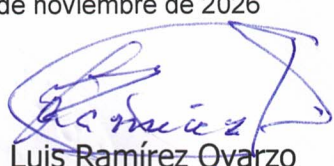
LECTURA DEL ESTANDAR mm	LECTURA DEL EQUIPO - EN ENSAYO $\times$ mm	ERROR mm
0,0000	0,000	0
0,0103	0,010	-0,0003
0,0202	0,020	-0,0002
0,0304	0,030	-0,0004
0,0403	0,040	-0,0003
0,0503	0,050	-0,0003
0,0604	0,060	-0,0004
0,0702	0,070	-0,0002
0,0803	0,080	-0,0003
0,0904	0,090	-0,0004
0,1004	0,100	-0,0004
0,1302	0,130	-0,0002
0,1598	0,160	0,0002
0,2000	0,200	0
0,4000	0,400	0
0,5301	0,530	-0,0001
0,7010	0,700	-0,0010
0,9013	0,900	-0,0013

U. TOTAL k=2	0,003 mm
Lugar de Calibración <i>Calibration Place</i>	Laboratorio de Metrología - Área Longitud
Exactitud entregada por el fabricante	$\pm 0,006$ mm
Ambiente / <i>Environment</i>	19,6 °C $\pm$ 1 °C (44,8 $\pm$ 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date: 26 de noviembre de 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date: 26 de noviembre de 2026


 Iván Valdebenito Rojas
 Técnico / Technician


 Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory