

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0213 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : AUTOMATIC ReFLEX BATTERY CHARGER / ANALYZER

Fabricante : CHRISTIE

Modelo / Número de Parte : RF80-M (123020-001) **Número de Serie** : 6554

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 24-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 24-mar-27

Lugar de Calibración : TALLER BATERIAS

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 19,3 °C **Humedad Relativa** : 33%

Procedimiento : OPERATING MANUAL (May 8, 2012 Rev. A)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 **MESES**

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HP	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
SHUNT	EWPRO	NO TIENE	11	NO TIENE	29-ene-27	DTS	NIST
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87V	28960058	111967	27-jun-26	DTS	NIST
DIGITAL STOPWATCH	R.S. PRO	8111814	1347544/391	NO TIENE	16-sept-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0213

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
BATTERY VOLTAGE METERING CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
		27,58	27,60	27,60	0,02	0,48
CELL VOLTAGE METERING CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
		1,50	1,50	1,50	0,00	0,03
BATTERY CURRENT METERING CALIBRATION						
		A	A	A	A	A
DISCHARGE MODE		-29,71	-30,00	-30,00	-0,29	0,60
DISCHARGE TERMINATION CALIBRATION						
		V	V	V	V	V
DISCHARGE MODE (-2,0 A)		27,03	27,10	27,10	0,07	0,50
TIMER ACCURACY CALIBRATION						
		S	S	S	S	S
CHARGE MODE (2,0 A)		120,77	120,00	120,00	-0,77	2,00

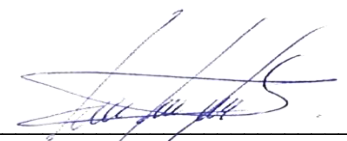


FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración