

UBICACIONES SUCEсивAS, OPERACIONALES DE MANTENIMIENTO MENOR Y MAYOR OVERHAUL

[illegible]

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER: FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS: IV° BRIGADA AEREA PUNTA ARENAS
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO / OBJECT: LINE OF SIGHT TELESCOPE
FABRICANTE / MANUFACTURER: CUBIC PRECISION
N° DE PARTE / PART N°: 71-2062
N° DE SERIE / SERIAL N°: 412664
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER: CG6925760159 SSCC .1742982 IV B.A.
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE /
CUSTOMER ID: FA-0982
RANGO CALIBRADO /
CALIBRATED RANGE: 4 [ft]-100 [ft]

CONDICIÓN DE RECEPCIÓN /
CONDITION AT ARRIVAL:

RECIBIDO RECEIVED	ENTREGADO RETURNED	CONFORMIDAD CONFORMITY
EN TOLERANCIA	EN TOLERANCIA	MANUAL DEL FABRICANTE

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN /
CALIBRATION PROCEDURE: 33 K6 -4-568-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

PATRÓN / STANDARD:	Line of Sight Collimator	Variable Wedge	Coincidence Striding Level
FABRICANTE / MANUFACTURER:	BRUNSON	CUBIC PRECISION	BRUNSON
N° DE SERIE / SERIAL NUMBER:	413979	416565	66796
FECHA DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION DATE:	18 de jun. de 2024	20 de jun. de 2024	24 de nov. de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO / CALIBRATION DUE:	18 de jun. de 2027	20 de jun. de 2027	24 de nov. de 2027
N° CERTIFICADO / CERTIFICATE N°:	112091-1-1	20062024MS0078	24112025OP0028
EMISOR / ORIGIN:	BRUNSON	ENAER	ENAER
TRAZABILIDAD / TRACEABILITY:	NIST-USA	NIST-USA	NIST-USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, en que se realizan las unidades de la medición de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI). El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the system of units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
 CALIBRATION CERTIFICATE

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION RESULTS

REDONDEZ DIÁMETRO EXTERIOR:	CONFORME
MEDIDA DEL DIÁMETRO EXTERIOR:	CONFORME
COMPROBACIÓN MOVIMIENTO PARALELO:	CONFORME
COMPROBACIÓN DEL CENTRO DE LA DIANA:	CONFORME

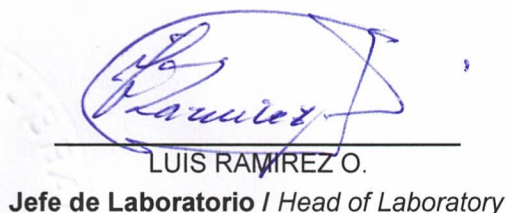
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA K=2 / EXPANDED UNCERTAINTY K=2

RETÍCULO OBSERVADO [ft]	POSICIÓN	Error [arc seg]	U k=2 [arc seg]
4	HORIZONTAL	0,45	2,7
	VERTICAL	0,30	2,8
10	HORIZONTAL	0,55	2,2
	VERTICAL	0,25	2,1
25	HORIZONTAL	0,45	3,5
	VERTICAL	0,70	3,5
50	HORIZONTAL	0,15	3,0
	VERTICAL	0,39	3,5
100	HORIZONTAL	1,10	2,8
	VERTICAL	0,25	2,7

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION CONDITIONS

LUGAR DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION FACILITY:	LABORATORIO DE ÓPTICA, ENAER
AMBIENTE / ENVIRONMENT:	(20 ± 5) ° C (50 ± 20)% H.R.
OBSERVACIONES / OBSERVATIONS:	NO SE EFECTUARON AJUSTES EN EL EQUIPO BAJO CALIBRACIÓN
FECHA DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION DATE:	27 DE NOVIEMBRE DE 2025


 GUSTAVO PREDES C.
 Técnico / Technician


 LUIS RAMIREZ O.
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory