

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0130 FECHA DE EMISION: 28-mar-25 Página 1 de 2

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE IV BRIGADA AEREA, PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : CONTROLLER EGT TESTER

Fabricante : NORTHROP SPEC

Modelo / Número de Parte : H239-11 Número de Serie : 140V

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 24-mar-25 Fecha de Vencimiento : 24-mar-26

Lugar de Calibración : BANDADA DE ELECTRÓNICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 25,5 °C Humedad Relativa : 25%

Procedimiento : 33D4-6-465-1

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	11-abr-25	DTS	NIST
TRUE RMS MULTIMETER	FLUKE	87V	92010032	105951	26-ene-26	DTS	NIST
RESISTANCE STANDARD	ESI	RS925D	812002	102394	22-jul-25	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	A6031000	TEMP-003	N/A	06-ene-26	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 25-FS-44-0130

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
INDICATOR TEMPERATURE		°C	°C	°C	°C	1°
		0,0	0	0	0	1
		100,0	100	100	0	1
		200,0	200	200	0	1
		300,0	301	301	1	1
		400,0	400	400	0	1
		500,0	500	500	0	1
		600,0	600	600	0	1
		700,0	700	700	0	1
		800,0	801	801	1	1
		900,0	900	900	0	1
		1000	1001	1001	1	1
		1240	1241	1241	1	1
		1350	1351	1351	1	1
THERMOCOUPLE RESISTANCE CIRCUIT		Ω	Ω	Ω	Ω	
		20,22	22,00	22,00	1,78	0,01
INSULATION RESISTANCE						
		OPEN	∞	∞	N/A	N/A
x 100		SHORT	0,00	0,00	N/A	N/A
x1000		SHORT	0,00	0,00	N/A	N/A
PROBE CONTROL	105950	°C	°C	°C	°C	10
		200	199	199	-1	LAMP BLINKING
	SET 600°C	600	599	599	-1	LAMP BLINKING

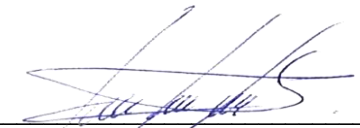


FÉLPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración