

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0169 FECHA DE EMISION: 02-abr-26 Página 1 de 2

Descripción del ítem

Ciente : FUERZA AEREA DE CHILE - IV BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : ALIMENTATION STABILISEE

Fabricante : SODILEC

Modelo / Número de Parte : SDR 4010 Número de Serie : 375308

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 19-mar-26 Fecha de Vencimiento : 19-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : Temperatura : 20,3°C Humedad Relativa : 40%

Procedimiento : 33K1-4-2382-1, 30 JANUARY 2014 (DCS-40-25)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	02-feb-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0169

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACION VOLTAJE DE SALIDA						
		V	V	V	V	V
		9,88	10,00	10,00	0,12	0,50
		19,89	20,00	20,00	0,11	0,50
		30,46	30,00	30,00	-0,46	0,50
		40,30	40,00	40,00	-0,30	0,50
CALIBRACION DE CORRIENTE DE SALIDA						
		A	A	A	A	A
		2,00	2,00	2,00	0,00	0,35
		3,90	4,00	4,00	0,10	0,35
		6,07	6,00	6,00	-0,07	0,35
		8,12	8,00	8,00	-0,12	0,35
		10,24	10,00	10,00	-0,24	0,35
RIPPLE		18,4 mVrms	30V / 10A	N/A	N/A	

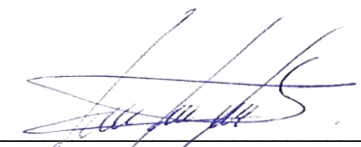


FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración