

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0162 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 2**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : DC POWER SUPPLY

Fabricante : HEWLETT - PACKARD

Modelo / Número de Parte : 6024A **Número de Serie** : 1152A01131

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 18-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 18-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 24,8°C **Humedad Relativa** : 34%

Procedimiento : 33K1-4-1923-1, 30 MAY 2013

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MULTIMETER	HEWLETT PACKARD	34401A	3146A25229	104639	06-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGROMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	NO TIENE	30-ene-27	DTS	NIST
MULTIPLE CURRENT SHUNT	GUILDLINE INSTRUMENTS LIMITED	9211A	55,963	105392	02-feb-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración


N° de Certificado : 26-FS-44-0162

Página 2 de 2

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		V	V	V	V	V
0 - 60V		10,14	10,00	10,00	-0,14	2,10
		20,06	20,00	20,00	-0,06	2,10
		30,13	30,00	30,00	-0,13	2,10
		40,13	40,00	40,00	-0,13	2,10
		50,90	50,00	50,00	-0,90	2,10
		60,10	60,00	60,00	-0,10	2,10
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		A	A	A	A	A
0 - 10A		2,052	2,000	2,000	-0,052	0,360
		4,026	4,000	4,000	-0,026	0,360
		6,018	6,000	6,000	-0,018	0,360
		8,05	8,00	8,00	-0,05	0,36
		9,92	10,00	10,00	0,08	0,36
CALIBRACIÓN DE RIPPLE						
		mVrms	mVrms	mVrms	mVrms	mVrms
10V/9A		0,44	0,80	0,80	N/A	10,61

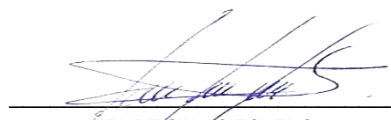


FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración