

CERTIFICADO DE CALIBRACION
CERTIFICATE OF CALIBRATION

CLIENTE
CUSTOMER
DIRECCION
ADDRESS
FECHA EMISION
EMISSION DATE
ORDEN DE TRABAJO
REMISION
OBJETO
OBJECT
FABRICANTE
MANUFACTURER
N° DE PARTE
PART N°
N° DE SERIE
SERIAL NUMBER
RANGO
RANGE
LUUGAR DE
CALIBRACION

FUERZA AEREA DE CHILE IV BRIGADA AEREA
IV BRIGADA AEREA
27 NOVIEMBRE 2025
CG6925760160
SSCC:1742982
COLIMADOR
KEUFFEL & ESSER
71-4010
412167
0.0 m - INFINITO
LABORATORIO DE OPTICA ENAER

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	TELESCOPIO ALINEACION	CUÑA OPTICA
Modelo / Model	71-2024	71-7020
N° Serie/ Serial number	409124	416565
Certificado N° / Certificate N°	14102025OP0005	112091-2-1
Fabricante / Manufacture	KEUFFEL-ESSER	BRUNSON INSTRUMENT
Vencimiento / Due	14 DE OCTUBRE 2025	20 DE JUNIO 2027
Emisor / Origin	ENAER	BRUNSON INSTRUMENT
Trazabilidad / Traceability	NIST USA	NIST - USA

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de medición realizadas están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the objet recalibrate at appropriate intervals.

1. COMPROBACION DE LA ORIENTACION DE LS ESCALAS DE LOS BLANCOS ANTERIOR Y DE INFINITO DEL COLIMADOR OPTICO .-

ACEPTADO

2. COMPROBAR QUE EL BLANCO DEL INFINITO DEL COLIMADOR (eje Óptico) ES PARALELO AL EJE DEL CILINDRO.-

Pos.Colimador	0°	90°	180°	270°
Desviación en Segundos de Arco.				
Desviación	0	0,5	-0,75	-1
	0	0,25	-0,25	-0,75
	0	0,5	-1	-0,5
	0	0,75	-0,25	-0,5
Desv. Promedio	0,0	0,5	-0,6	-0,7
$(0^{\circ}-180^{\circ})/2 = 0,3$ $(90^{\circ}-270^{\circ})/2 = 0,8$				

LA TOLERANCIA ADMISIBLE PARA ESTA PRUEBA ES 3 SEGUNDOS DE ARCO

ACEPTADO

3. COMPROBAR QUE EL CENTRO DEL BLANCO ANTERIOR DEL COLIMADOR ESTA SITUADO EN EL EJE DEL CILINDRO .-

Pos.Colimador	0°	90°	180°	270°
Lectura con Micrometro Optico Desviación en mm				
Desviación	0,000	0,001	0,002	0,001
	0,000	0,001	0,002	0,001
	0,000	0,001	0,002	0,001
	0,001	0,001	0,002	0,001
Desv. Promedio	0,0003	0,001	0,002	0,001
	$(0^{\circ}-180^{\circ})/2 = -0,001$		$(90^{\circ}-270^{\circ})/2 = 0,000$	

LA TOLERANCIA ADMISIBLE PARA ESTA PRUEBA ES DE 0,008 mm

ACEPTADO

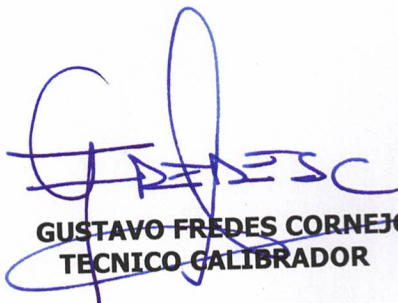
4. COMPROBAR QUE LA BURBUJA DEL NIVEL TRANVERSAL DEL COLIMADOR ESTA CENTRADA CUANDO LA ESCALA DE DESPLAZAMIENTO VERTICAL DEL BLANCO ANTERIOR ESTA HORIZONTAL.-

NO APLICABLE A ESTE MODELO ,ACEPTADO

Condiciones ambientales :

Temperatura : 20 **Humedad** : 50.4 % HR.

FECHA DE CALIBRACION 27 NOVIEMBRE 2025 **FECHA DE VENCIMIENTO** 27 NOVIEMBRE 2026
PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION : OT.33K6-4-429


GUSTAVO FREDES CORNEJO
TECNICO GALIBRADOR


LUIS RAMIREZ OYARZO
JEFE LAB.METROLOGIA